

**PENGUJIAN KESELAMATAN DARI PAPARAN RADIASI
SINAR-X DI UNIT RADIOLOGI RSUD KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

RISKA YULIAMDANI
60400115051

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar” yang disusun oleh Riska Yuliamdani, Nim : 60400115051 Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M, bertepatan dengan 30 Jumadil-Akhirah 1441 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.

Makassar, 24 Februari 2020 M
30 Jumadil-Akhirah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.d.	(<u>Sjamsiah</u>)
Sekretaris	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(<u>Rahmaniah</u>)
Munaqisy I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(<u>Ihsan</u>)
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag.	(<u>Abdullah</u>)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(<u>Sahara</u>)
Pembimbing II	: Nurul Fuadi, S.Si., M.Si	(<u>Nurul Fuadi</u>)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhi Hafifah Mustami, M.Pd
NIP.19711402 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Yuliamdani
NIM : 60400115051
Tempat/Tgl. Lahir : Lapai, 16 Juli 1997
Jurusan : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Griya Prima Tonasa D3/7
Judul Skripsi : Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 23 Maret 2020

Penulis,



RISKA YULIAMDANI

60400115051

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur tak henti-hentinya tercurahkan dari lisan kita kepada Allah swt atas segala nikmat berupa rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Akhirnya skripsi dengan judul **“Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Saya mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tuaku, **Ambo Sengngeng** dan **Sitti Mardani** beserta saudaraku yang sangat aku sayangi yaitu **Muhammad Nasir** sebagai sumber penyemangat dan inspirasiku.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala hambatan dan tantangan, namun berkat pertolongan dari Allah swt, kerja keras, doa dan segala bantuan dari berbagai pihak baik bantuan secara langsung, materi dan motivasi. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak **Prof. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 dan Bapak **Prof. H Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2019-2023.

2. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 dan Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. **Ibu Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku ketua jurusan Fisika periode 2015-2019 sekaligus pembimbing satu dan **Ibu Nurul Fuadi, S.Si., M.Si** selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
4. **Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris jurusan Fisika periode 2015-2019, dan ketua jurusan Fisika periode 2019-2023 sekaligus selaku dosen penguji 1 dan **Bapak Muh. Said L. S.Si. M.Pd.**, selaku sekertaris jurusan Fisika periode 2019-2023.
5. **Bapak Dr. Abdullah, M.Ag** selaku Penguji agama yang telah memberikan arahan dan saran dalam penelitian dan penulisan skripsi.
6. **Pak Ikbal** selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dan saran dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. **Bapak dan Ibu dosen** serta **Staf Laboran** Fisika yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
8. **Segenap Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas semua bantuannya dalam pengurusan administrasi.
9. Commo'cs Waje, Firda, Fate, Fahira, Fitri, Yanti, Lia, Umma dan Dilla yang selalu memberikan masukan, nasehat dan motifasi.

10. Rainbow Mita, Indri, Hadria dan Wati yang selalu memberikan motivasi.
11. Teman teman Asrama Piba, terima kasih untuk dukungan dan arahan-arrahannya selama ini.
12. Teman teman Ara, Linda, Anti yang selalu memberikan saya motivasi.
13. Teman-teman angkatan 2015 (Res15tor) terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
14. Teman-teman KKN angkatan 60 Posko 17 sapanang Nurul, Fira, Ampel, Lolica, Ukhti isra, kiki, dedy, alif dan pian semoga pertemanan kita tetap terjalin.
15. Seluruh keluarga besar mahasiswa jurusan Fisika baik senior maupun junior terima kasih banyak untuk doa dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari berbagai instansi terkait, serta khususnya tim penguji untuk kesempurnaan skripsi ini.

Samata-Gowa, 19 Februari 2020

Penulis,

RISKA YULIAMDANI
NIM: 60400115051

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1. Sinar-X	7
2.1.1. Sinar Alfa	10
2.1.2. Sinar Beta	11
2.1.3. Sinar Gamma	12
2.2. Prinsip Kerja Sinar-X	13
2.3. Sifat-sifat Sinar-X	14
2.4. Radiasi	19
2.5. Efek Biologis dari Radiasi	23
2.6. Efek Kesehatan dari Radiasi	24
2.7. Alat-alat yang dipakai untuk mencatat dosis	27

2.8. Alat Pengukuran Radiasi	27
2.9. Dosimeter Radiasi	29
2.10. Proteksi Radiasi	30
2.11. Satuan-satuan Radiasi	34
2.1.2 Nilai Batas yang diizinkan	37
2.13. Phantom	37
2.14. Instalasi Radiologi	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.2. Alat dan Bahan	39
3.3. Prosedur Kerja	39
3.4. Tabel penelitian	41
3.5 Bagan Alir Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Paparan radiasi pesawat sinar-X konvensional	47
4.2. Dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi	54
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP	60



ALAUDDIN

 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Efek radiasi terhadap organ manusia	24
Tabel 2.2 Dosis Maksimum yang dikenakan bagi pekerja radiasi	32
Tabel 2.3 Batas dosis Maksimum yang dikenakan bagi masyarakat	32
Tabel 2.4 Dosis serap kira-kira untuk jaringan per Roentgen pemaparan	35
Tabel 2.5 Faktor kualitas berbagai jenis radiasi	46
Tabel 3.1 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,05 detik	41
Tabel 3.2 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,1 detik	41
Tabel 3.3 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,16 detik	42
Tabel 3.4 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,2 detik	42
Tabel 3.5 Pengambilan data mentah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja	43
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,05 detik	47
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,1 detik	48
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,16 detik	49
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,2 detik	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peluruhan sinar alfa	10
Gambar 2.2. Peluruhan sinar beta.....	11
Gambar 2.3. Peluruhan sinar gamma	12
Gambar 2.4. prinsip kerja sinar X	13
Gambar 2.5. Radiasi Pengion	20
Gambar 2.6. Efek Deterministik Radiasi	25
Gambar 2.7. Efek Stokastik Radiasi	26
Gambar 2.8. Phantom Air	38
Gambar 2.9. Denah ruangan radiologi di RSUD kota makassar	39

ABSTRAK

Nama : Riska Yuliamdani

Nim : 60400115051

Judul : Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jarak dan waktu dari sumber radiasi dan untuk mengetahui berapa besar paparan radiasi hambur yang diterima oleh pekerja atau operator di dalam ruang radiologi RSUD Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pesawat sinar-X, surveymeter, meteran, dan phantom. Dalam pengukuran dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama mengukur paparan dosis radiasi terhadap jarak hasil penelitian yang dilakukan pada pengujian keselamatan dari paparan radiasi sinar-X di unit radiologi RSUD kota makassar, maka diperoleh hasil sebagai berikut berdasarkan parameter jarak dan waktu dari sumber radiasi berpengaruh besar terhadap dosis paparan radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber radiasi maka dosis yang diterima semakin kecil. Sedangkan pengaruh besarnya waktu terhadap paparan sinar radiasi yaitu semakin lama waktu penyinaran maka semakin besar pula dosis radiasi yang diperoleh. Nilai paparan radiasi hambur yang diterima oleh pekerja radiasi ruang radiologi RSUD Kota Makassar yaitu dosis radiasi yang diterima oleh pekerja dengan lama waktu pemakaian radiasi yang terbesar diterima oleh operator XIII yaitu sebesar 0.1769 mSv/h sedangkan nilai dosis yang terkecil diterima oleh operator XI sebesar 0.0593 mSv/h dan dosis rata-rata yang diterima oleh operator 0.1570 mSv/h.

Kata kunci : Keselamatan, Paparan radiasi, Sinar-X, Radiologi, Jarak dan Waktu.

ABSTRACT

Name : Riska Yuliamdani

Nim : 60400115051

Title : Safety Testing of X- Ray Radiation Exposure in Radiology Unit of Makassar City Hospital

Has conducted research that aims to determine the effect of exposure to a dose of radiation to the distance and time from the source of radiation and to determine how large exposure to radiation scattering which is received by a worker or operator in the space radiology Hospital Makassar. This research uses X-ray aircraft, Surveymeter, meter, and phantom. In measurements carried out two stages namely stage first measure exposure dose of radiation to the distance the results of the research that is done on testing the safety of exposure to radiation rays -X in units of radiology Hospital cities of Makassar , then obtained a conclusion as follows based on parameters of distance and time from the source of radiation effect large against dose of radiation exposure . more far distance from the source of radiation the dose that is received by increasingly smaller. While the influence of the amount of time of the exposure beam of radiation that is increasingly long time irradiation then getting big too doses of radiation are obtained. Value exposure to radiation scattering which is received by the worker radiation chamber radiology Hospital of Makassar is the dose of radiation that is received by workers with long time use of radiation were the biggest received by operators XIII which amounted to 0.1769 mSv/h, while the value of the dose which is the smallest received by the operator XI of 0.0593 mSv/h and the average dose received by the operator is 0.1570 mSv/h.

Words key : Safety, exposure to radiation , rays -X, Radiology , distance and time

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penemuan sinar merupakan suatu revolusi dalam dunia kedokteran karena ternyata dengan hasil ini dapat mendiagnosa penyakit dalam tubuh manusia. Sinar-X pertama kali ditemukan oleh Wilhem Conrad Rontgen pada tahun 1895. Berkat penemuan Rontgen dunia medis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pemeriksaan menggunakan sinar-X ini merupakan salah satu pemeriksaan dengan memanfaatkan sinar-X yang menghasilkan citra atau gambar untuk menegakkan diagnose suatu penyakit di bidang kedokteran. Penggunaan sinar-X yang optimal akan mengurangi timbulnya efek negatif dan sinar-X yaitu pesawat sianr-X *General Purpose* atau pesawat sinar-X konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik untuk menghasilkan kualitas radiografi yang optimal. Untuk mendapatkan kualitas radiografi yang baik maka diperlukan manajemen terhadap seluruh komponen terkait.

Secara umum instalasi radiologi yang terdapat di rumah sakit membutuhkan ruang utama yaitu: ruang pemeriksaan, ruang operator, kamar gelap, ruang sanitasi, ruang baca film, dan ruang perencanaan dosis. Ruang pemeriksaan yang baik adalah yang memenuhi syarat proteksi radiasi dengan ukuran ruang pemeriksaan yang sesuai

dengan ketentuan, untuk peralatan rontgen dengan dinding ruang yang harus dapat dipertanggung jawabkan untuk menjamin keamanan pasien, karyawan, dan masyarakat pada umumnya (Novita, 2016).

Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi (terbentuknya ion positif dan ion negatif) apabila berinteraksi dengan materi, jenis radiasi pengion adalah sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar-X dan neutron. Setiap jenis radiasi memiliki karakteristik khusus (Diana, 2010).

Radiodiagnostik merupakan salah satu cabang ilmu radiologi yang menggunakan pencitraan yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan pemanfaatan radiasi pengion. Salah satu alat radiagnostik yaitu pesawat sinar-X konvensional. Pemanfaatan radiasi pengion berupa sinar-X selain memberikan manfaat bagi dunia kedokteran, juga berpotensi memberikan efek merugikan bagi pekerja, pasien dan masyarakat. Proteksi radiasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengendalian efek yang merugikan orang lain (Candra, dkk 2016).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 3 Tahun 2013, keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pasien, pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Proteksi radiasi yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi, menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan keselamatan radiasi. Nilai Batas Dosis (NBD) untuk pekerja radiasi tidak boleh melampaui 30

mVs (millisievert) per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut dan 50 mVs dalam 1 tahun tertentu, sedangkan NBD untuk anggota masyarakat tidak boleh melampaui 1 mVs dalam 1 tahun. Pemantauan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi dilakukan dengan menggunakan film badge atau Thermoluminescence Dosimeter (TLD).

Menurut BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, pekerja radiasi tidak boleh menerima dosis radiasi melebihi 50 mSv pertahun dan rata-rata pertahun tidak boleh menerima lebih dari 1 mSv pertahun. Karena bagaimanapun radiasi akan memiliki efek biologi yang meliputi efek non stokastik dan stokastik (Muh. Zakky, dkk 2016).

Uswatun Hasanah (2016) telah melakukan penelitian tentang kajian keselamatan paparan radiasi dental X-ray di laboratorium klinik parahita diagnostik center makassar dengan tujuan untuk mengetahui daerah aman untuk pekerja radiasi, dengan melakukan pengukuran radiasi hambur pada jarak 0 cm, 10 cm, 50 cm, dan 200 cm dengan variasi waktu sesuai yang diperlukan pada pemotretan gigi (0,50 detik, 0,64 detik, dan 0,74 detik) dari hasil penelitian menyatakan bahwa 0,50 detik adalah waktu yang paling baik.

Ada pula penelitian tentang uji keselamatan paparan radiasi dental sinar-X dilakukan oleh Muh. Rusli (2017) di ruang Radiologi Atro Muhammadiyah Makassar. Yang bertujuan untuk menentukan pengaruh paparan radiasi terhadap jarak, arah dan

waktu, serta tingkat proteksi radiasi terhadap petugas radiologi dan masyarakat umum. Dalam penelitian dilakukan pengukuran radiasi pada tegangan 70 kV dan 8 mA dengan variasi jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Pada variasi waktu masing-masing 0,31 detik, 0,17 detik, 0,21 detik dan 0,25 detik serta variasi arah yaitu arah depan, kiri, kanan, belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak 3 meter dengan waktu 0.71 detik pada arah belakang diperoleh akurasi dosis 0,89 ($\mu\text{Sv/h}$) adalah yang paling baik.

Salah satu cara untuk mengetahui paparan radiasi sinar-X ketika penyinaran terjadi pada pasien dan daerah ruang pesawat sinar-X konvensional adalah dengan menggunakan surveymeter yang diletakkan dengan jarak, arah, dan waktu bervariasi dan sumber sinar-X tetap. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian dilakukan, berdasarkan hubungan penyinaran dengan jarak antar pekerja terhadap sumber radiasi sinar-X. Oleh karena itu perlu adanya proteksi radiasi untuk keselamatan kerja, salah satunya yaitu mengetahui paparan dosis radiasi. Maka dilakukan penelitian tentang **“Pengujian Keselamatan Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar”** sehingga masyarakat umum dan pekerja atau operator radiasi dapat mengetahui kelayakan keselamatan kerja di ruang radiologi di RSUD kota Makassar.

1.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jarak dan waktu terhadap paparan dosis radiasi ?

2. Berapa besar paparan radiasi hambur yang diterima oleh pekerja atau operator di dalam ruang radiologi di RSUD kota Makassar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh jarak dan waktu terhadap paparan dosis radiasi.
2. Mengetahui besar paparan radiasi hambur yang diterima oleh pekerja atau operator di dalam ruang radiologi di RSUD kota Makassar.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di bagian Radiologi RSUD kota Makassar.
2. Radiografi yang digunakan adalah pesawat sinar-X konvensional.
3. Penelitian ini mengukur paparan radiasi dari sisi depan.
4. Penelitian ini bervariasi jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter dari dinding.
5. Penelitian ini bervariasi waktu ekspose 0,05 detik, 0,1 detik, 0,16 detik, 0,2 detik.
6. Penelitian ini menggunakan phantom sebagai pengganti manusia.
7. Penelitian ini menggunakan pengukuran berulang sebanyak empat kali.

1.5. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proteksi radiasi di RSUD kota makassar kepada pasien, pekerja, serta masyarakat umum yang berada disekitar ruangan radiologi diagnostik di rumah sakit sehingga masyarakat, pasien peserta pekerja radiasi mendapatkan radiasi serendah mungkin dan mengetahui. Hal ini juga diharapkan dapat memberi informasi serta manfaat kepada masyarakat akademik kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta dapat memberikan masukan dan kajian pustaka yang berguna bagi peneliti dan bagi akademisi khususnya di bidang Fisika Radiasi dalam lingkup analisis dosis paparan radiasi sinar-X di instalasi RSUD Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Sinar-X

Pada tahun 1895, W.C. Roentgen (1845-1923) menemukan bahwa ketika elektron dipercepat dengan tegangan tinggi pada tabung hampa udara dan dibiarkan menumbuk permukaan kaca (atau logam) di dalam tabung, mineral fluoresen dengan jarak tertentu darinya akan bersinar, dan film fotografi akan terkena cahaya. Roentgen menghubungkan efek ini ke suatu jenis radiasi baru (berbeda dari sinar katoda). Efek ini diberi nama sinar-X dari simbol aljabar x , yang berarti besaran yang tidak diketahui. Ia segera menemukan bahwa sinar-X menembus beberapa materi dengan lebih baik dari yang lainnya, dan dalam beberapa minggu ia mempresentasikan foto sinar-X yang pertama (foto tangan istrinya) (Giancoli,2001).

Menurut Ahmadi Ruslan Hani (2010), sinar-X merupakan sinar katoda dan termasuk gelombang elektromagnetis. Timbulnya sinar-X oleh karena ada perbedaan potensial arus searah yang besar di antara kedua elektroda (katoda dan anoda) dalam sebuah tabung hampa. Berkas elektron akan dipancarkan dari katoda menuju anoda, pancaran elektron-elektron ini disebut sinar katoda atau sinar-X. Sejak ditemukan sinar-X oleh W.C.Roentgen (Sarjana fisika dari Universitas Wurzg Jerman) banyak

serjana melakukan penelitian terhadap karakteristik sinar-X. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik sinar-X adalah.

- a. Menghitamkan plat potret (film)
- b. Mengionisasi gas
- c. Menembus berbagai zat
- d. Menimbulkan fluoresensi
- e. Merusak jaringan

Sinar-X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet dan memiliki panjang gelombang yang cenderung sangat pendek 10^{-8} m sampai dengan 10^{-11} m, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Kemampuan sinar-X menembus bahan sering kali dimanfaatkan pada bidang medis salah satunya ranah radioagnostik. Pemanfaatan sinar-X telah diatur dengan standar nasional yaitu IAEA dan BAPETEN yang meliputi asas-asas proteksi radiasi dan penerimaan dosis radiasi untuk mengutamakan aspek keselamatan terhadap individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi, maupun pekerja radiasi selain tersebut di atas. Masyarakat (publik) adalah manusia bukan pekerja radiasi yang ada di luar kawasan instalasi radiologi (Muh.Zakky, dkk 2016).

Pemanfaatan pesawat sinar-X radiologi diagnostik di Indonesia terus berkembang. Radiologi ini memanfaatkan sinar-X untuk keperluan diagnostik baik


radiologi diagnostik maupun radiologi intervensional (perka BAPETEN No 8, 2011). Kegiatan radiologi harus memperhatikan aspek keselamatan kerja radiasi. Sinar-X merupakan jenis radiasi pengion yang dapat memberikan manfaat (diagnosa) dengan radiasi suatu penyakit atau kelainan organ tubuh dapat lebih awal dan lebih teliti dideteksi. Untuk memastikan pesawat sinar-X memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan memberikan informasi diagnosa maka diperlukan uji fungsi atau uji kesesuaian sebagai bentuk penerapan proteksi radiasi agar dosis yang diterima serendah mungkin. Kesesuaian ini kesesuaian terhadap peraturan perundangan keselamatan radiasi dan peraturan pelaksanaannya untuk peralatan pesawat sinar-X (Tri,dkk 2017).

Resiko bahaya yang mungkin terjadi pada pekerja radiasi yaitu efek deterministik dan efek stokastik. Pengaruh sinar-X dapat menyebabkan kerusakan haemopoetik (kelainan darah) seperti anemia, leukemia. Selain itu efek deterministik yang dapat menimbulkan pada organ reproduksi atau gonad adalah sterilitas atau kemandulan serta menyebabkan menopause dini sebagai akibat dari gangguan hormonal sistem reproduksi (Tri,dkk 2017).

Ahmadi Ruslan hani (2010), becquerel pada tahun 1896 menemukan senyawa Uranium yang memancarkan sinar tak tampak yang dapat menembus bahan tidak tembus cahaya serta mempengaruhi emulsi fotografi. Pada tahun 1896 Marie Curie menunjukkan bahwa inti uranium dan banyak unsur lain bersifat memancarkan salah

satu partikel alfa, beta dan gamma. Unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan sinar-sinar alfa, beta dan gamma disebut inti radioaktif.

2.1.1 Sinar Alfa (α)




Gambar 2.1. Peluruhan sinar alfa
sumber : Wikipedia.com 2019

Radiasi alfa adalah radiasi berupa partikel yang terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Pada dasarnya, radiasi alfa dan inti helium yang bersimbol ${}^4_2\text{He}$. Radionuklida yang meluruh dengan memancarkan radiasi alfa akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron, serta membentuk nuklida baru (Eri, 2015).

Sinar alfa mempunyai daya tembus sangat kecil sehingga pemakaiannya sangat terbatas dalam radioterapi. Daya tembus sinar alfa dalam udara sejauh 4 cm, terhadap materi yang lebih padat daya tembusnya semakin kecil. Energi sinar alfa sebesar 5,3 MeV, apabila terjadi tumbukan dengan elektron sinar alfa akan kehilangan sebesar 100 MeV. Energi Partikel alfa tidak mengalami pembelokan, hal ini disebabkan massa partikel alfa lebih besar dibandingkan dengan massa elektron.

Elektron-elektron akan terpenyal pada waktu terjadi tumbukan pada partikel alfa (Ahmadi, 2010).

2.1.2 Sinar Beta (β)




Gambar 2.2. Peluruhan sinar beta
sumber : Wikipedia.com 2019

Radiasi beta berupa partikel, yang dapat bermuatan negatif atau bermuatan positif. Partikel beta bermuatan negatif identik dengan elektron, sedangkan partikel yang bermuatan positif disebut positron, identik dengan elektron yang bermuatan positif. Dalam proses peluruhan radiasi beta negatif (elektron), terjadi perubahan neutron menjadi proton di dalam inti atom. Sedangkan dalam proses peluruhan radiasi beta positif (positron), terjadi perubahan proton menjadi neutron di dalam inti atom. Seperti elektron, nukleon juga bisa tereksitasi jika menerima radiasi. Ketika nukleon tereksitasi kembali ke tingkat energi asal, terjadi pancaran foton (gelombang elektromagnetik) yang energinya sama dengan perbedaan energi antara tingkat energi eksitasi dengan tingkat energi asal. Foton yang terpancar ini disebut sinar gamma atau radiasi gamma (Eri, 2015).

Sinar beta atau partikel beta merupakan partikel yang dilepas atau terbentuk pada suatu nukleon inti. Partikel beta ini dapat berupa elektron yang bermuatan negatif (negatron), elektron bermuatan positif (positron) atau elektron capture (penangkapan elektron). Besar energi partikel beta berkisar antara 0.01 MeV sampai 3 MeV. Jarak tembus partikel alfa kurang lebih seratus kali lebih jauh dari pada partikel beta. Partikel beta 1 MeV dapat menembus air 0,4 cm (Ahmadi, 2010).

2.1.3 Sinar Gamma (γ)




Gambar 2.3. Peluruhan sinar gamma
sumber : Wikipedia.com 2019

Radiasi gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun nomor massa, karena radiasi gamma merupakan foton (gelombang elektromagnetik), yang tidak bermuatan dan tidak bermassa. Peluruhan ini terjadi karena energi inti atom tidak berada pada tingkat tereksitasi (isomer). Pada umumnya, peluruhan gamma ini terjadi setelah peristiwa peluruh alfa atau beta (Eri, 2015).

2.2. Prinsip kerja sinar-X

Sinar-X terjadi apabila satu berkas elektron bebas berenergi kinetik tinggi mengenai logam. Biasanya permukaan logam dengan nomor atom Z yang tinggi. Tempat dimana bekas elektron itu menumbuk logam akan merupakan sumber sinar dengan daya tembus yang besar. Secara skematis pembangkitan sinar-X dapat dilihat pada Gambar 2.4.

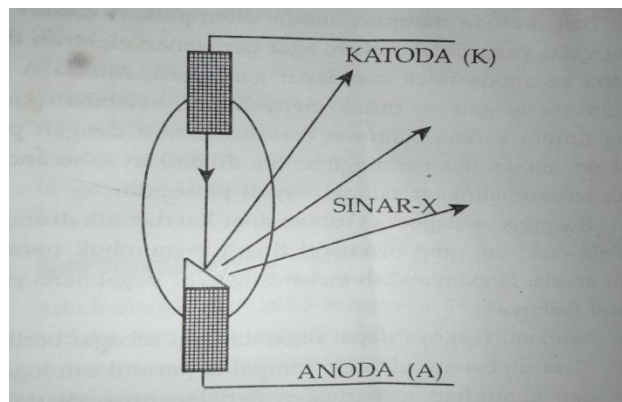

Gambar 2.4. Prinsip kerja sinar X
Sumber : Yusman Wiyatmo 2003

K adalah katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan tinggi. Katoda dipanaskan dengan menggunakan filamen agar lebih mudah memancarkan elektron. A merupakan anoda yang terbuat dari logam berat. Anoda dihubungkan dengan kutub positif tinggi tegangan tinggi. Beda potensial yang tinggi (beberapa kilovolt sampai dengan seratus kilo volt), menyebabkan sampainya di Anoda, elektron yang dipancarkan oleh katoda memiliki energi kinetik yang sangat besar.

Elektron-elektron inilah yang dalam tumbukannya dengan anoda menimbulkan pancaran sinar-X oleh anoda.

Baik katoda maupun anoda ditempatkan dalam tabung gelas yang divakumkan, agar perjalanan electron dari katoda ke anoda tidak mendapat gangguan. Anoda A didinginkan dengan air untuk menyalurkan kelebihan kalor yang timbul karena benturan berkas elektron dengan permukaan anoda. Jika pendinginan tak dilakukan suhu anoda akan terus meningkat sampai terjadi peleburan (Yusman,2003).

2.3. Sifat-sifat sinar-X

Menurut Iwan Ekayuda (2005), sinar-X mempunyai beberapa sifat fisik, yaitu: daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, pendar fluor (fluoresensi), ionisasi, dan efek biologik.

a. Daya tembus

Daya X dapat menembus bahan, dengan daya tembus sangat besar dan digunakan dalam radiografi. Makin tinggi tegangan tabung (besarnya KV) yang digunakan, makin besar daya tembusnya. Makin rendah berat atom atau kepadatan suatu benda, makin besar daya tembus sinarnya.

b. Pertebaran

Apabila berkas sinar-X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke segala jurusan menimbulkan radiasi sekunder (radiasi hambur) pada bahan atau zat yang dilaluinya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya

gambar radiograf dan pada film akan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh. Untuk mengurangi akibat radiasi hambur ini, maka di antara subjek dengan film rontgen diletakkan grid. Grid terdiri atas potongan-potongan timah tipis yang letaknya sejajar, masing-masing dipisahkan oleh bahan tembus sinar.

c. Penyerapan

Sinar-X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya, makin besar penyerapannya.

d. Efek fotografik

Sinar-X dapat menghitamkan emulsi film (emulsi perak-bromida) setelah diproses secara kimiawi (dibangkitkan) di kamar gelap.

e. Pendar fluor (fluoresensi)

Sinar-X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium-tungstat atau Zink-sulfid memancarkan cahaya (luminisensi), bila bahan tertentu dikenai radiasi sinar. Luminisensi ada 2 jenis yaitu :

1. Fluoresensi yaitu akan memancarkan cahaya sewaktu ada radiasi sinar-X saja.
2. Fosforisensi yaitu memancarkan cahaya akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar-X sudah dimatikan (after-glow).

f. Ionisasi

Efek primer sinar-X apabila mengenai suatu bahan zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan zat tersebut.

g. Efek biologik

Sinar-X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologik pada jaringan. Efek biologik ini dipergunakan dalam pengobatan radioterapi.

Radiasi dijelaskan berdasarkan firman Allah Swt dalam surah An-Nuur/24:35, yang berbunyi :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾

Terjemahnya :

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi...”(Kementrian Agama, 2013: 354).

Ia adalah cahaya yang darinya tiang-tiang langit dan bumi, juga sistemnya. Cahaya itulah yang memberikan inti keberadaannya. Ia menyimpan di dalamnya hukum-hukumnya. Pada akhirnya manusia dapat mengetahui sedikit dari hakikat besar itu dengan ilmu mereka. Setelah revolusi ilmiah membuat mereka mampu membelah atom menjadi molekul-molekul yang tidak bertopang kecuali kepada cahaya. Ia tidak memiliki materi lain kecuali cahaya. Atom itu terdiri elektron-elektron yang terlepas dengan kekuatan penopangnya adalah cahaya.

Ayat yang sangat menakjubkan ini, timbul bersama dengan cahaya yang tenang dan memancarkan, sehingga tersebar keseluruh alam. Ia juga tersebar ke seluruh perasaan dan anggota badan. Ia mengalir ke seluruh sisi dan aspek kehidupan.

Sehingga, seluruh alam semesta bertasbih dalam lautan cahaya yang sangat terang disebabkan karena Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala, maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan dan lain-lain yang dirasakan dengan mata hati.

Cahaya memiliki manfaat yang sangat besar sebagai pemberi cahaya kepada langit dan bumi dimana ayat tersebut menjelaskan bagaimana mereka mampu membelah atom menjadi molekul-molekul yang tidak bertopang kecuali kepada cahaya yaitu atom itu terdiri elektron-elektron yang terlepas dengan kekuatan penopangnya adalah cahaya baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala, maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan serta timbul bersama dengan cahaya yang tenang dan mencerahkan, sehingga terbesar keseluruhan alam. Ia juga terbesar ke seluruh perasaan dan anggota-anggota badan. Sedangkan radiasi yaitu gelombang elektromagnetik tanpa melalui medium yang terdiri dari atom atau elektron-elektron yang dimana cahaya atau radiasinya yang dipancarkan keseluruhan tubuh dapat mendiagnosa adanya suatu penyakit dalam bentuk gambaran tubuh.

Manfaat radiasi dijelaskan dalam firman Allah swt QS al-Baqarah/2:20.

يَكَادُ الْبَرْقُ تَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ^ط كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا^ج وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

”Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (Kementerian Agama, 2013: 4).

Di dalam *Al-Quran* di jelaskan bahwa ayat ini menggambarkan orang-orang kafir yang diumpamakan seperti orang yang terjebak dalam situasi yang gelap gulita. Seseekali muncul kilatan cahaya petir yang membuat mereka bisa melihat jalan, mereka akan berjalan. Ketika cahaya itu telah hilang sama sekali, mereka berhenti berjalan karena tidak bisa melihat apa-apa. Mata mereka bisa melihat jalan karena ada kilatan cahaya petir. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia mutlak membutuhkan cahaya untuk dapat melihat sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah menciptakan cahaya agar manusia dapat melihat sesuatu dalam gelapan, namun ketika cahaya itu dihilangkan maka manusia tidak dapat melihat apa-apa, hingga cahaya sangat bermanfaat bagi manusia begitupula radiasi yang diciptakan oleh Allah yaitu dalam bentuk cahaya yang dimana radiasi yang dipancarkan ke dalam tubuh manusia yang menderita suatu penyakit maka dapat mendiagnosa penyakit tersebut, namun jika tidak dipergunakan


sebaik maka Allah akan mengambilnya kembali dan tidak dapat berguna lagi bagi manusia.

2.4. Radiasi

Secara definisi radiasi merupakan salah satu cara perambatan energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium atau bahan pengantar tertentu. Radiasi ini memiliki dua sifat khas yakni tidak dapat dirasakan oleh panca indra manusia dan beberapa jenis radiasi dapat menembus bahan tertentu. Radiasi ini terbagi menjadi dua jenis yakni radiasi pengion dan radiasi non pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom atau materi yang dilaluinya. Karena terjadi proses ionisasi maka pada materi yang dilalui radiasi akan terbentuk pasangan ion positif dan ion negatif. Dalam radiasi pengion terdapat radiasi elektromagnetik dan radiasi elektromagnetik ini terdiri dari berbagai macam jenis membentuk spektrum elektromagnetik. Kelompok radiasi elektromagnetik ini adalah gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, sinar infra merah, cahaya tampak, sinar ultra violet, sinar X, dan sinar gamma (Candra, dkk 2016).

Menurut Mayerni, dkk (2013) Radiasi adalah energi yang luas pengertiannya. Berdasarkan watak penghantarnya ada dua jenis radiasi , yaitu radiasi gelombang elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi gelombang elektromagnetik adalah pancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, termasuk didalamnya radiasi energi matahari yang kita terima sehari-hari di permukaan bumi. Sedangkan

radiasi partikel adalah pancaran energi dalam bentuk energi kinetik yang dibawa oleh partikel bermassa seperti elektron yang disebut sinar-X.



Gambar 2.5 Radiasi Pengion
Sumber Diana Barsasella 2010

Pemanfaatan radiasi pengion dalam bidang Radiodiagnostik untuk berbagai keperluan medik perlu memperhatikan dua aspek yaitu resiko dan manfaat yang dicapai salah satu resiko yang dihasilkan oleh radiasi pengion adalah menimbulkan efek biologis pada bahan yang dilaluinya. Efek-efek tersebut dapat berupa efek stokastis, deterministik, maupun genetik yang mampu merusak sel-sel hidup (Novita,2016).

Sinar matahari dapat menimbulkan radiasi matahari yang energi radiasi matahari yaitu energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik yang dapat menghasilkan gelombang pendek yaitu sinar-X, radiasi pada cahaya matahari ini juga di bahas dalam QS Yunus/10:5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. Yunus).

Pada kata “*dhiya*”, dipahami oleh ulama masa lalu sebagai cahaya yang sangat terang karena menurut mereka ayat ini menggunakan kata tersebut untuk matahari dan menggunakan kata *nur* untuk bulan, sedangkan cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari. Hanafi Ahmad, yang menulis tafsir tentang ayat-ayat *kauniyah*, membuktikan bahwa Al-Qur’an menggunakan kata *dhiya*’ dalam berbagai bentuknya untuk benda-benda yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri. Penggunaannya pada ayat ini untuk matahari membuktikan bahwa Al-Qur’an menginformasikan bahwa cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, bukan pantulan dari cahaya lain. Ini berbeda dengan bulan yang sinarnya dilukiskan dengan kata *nur* untuk mengisyaratkan bahwa sinar bulan bukan dari dirinya tetapi pantulan dari cahaya matahari.

Asy-Sya’rawi menulis bahwa ayat ini mengenai sinar matahari (*dhiya*) karena cahayanya menghasilkan panas atau kehangatan. Sedangkan kata *nur* memberi

cahaya yang tidak terlalu besar dan tidak menghasilkan kehangatan, sinar matahari bersumber dari dirinya sendiri dan cahaya bulan adalah pantulan (Quraish Shihab, 2009).

Sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dan Tafsir al-Muntakhab dikemukakan antara lain bahwa ayat ini menjelaskan perbedaan antara cahaya dan sinar yaitu matahari yang bersinar dan bulan bercahaya , matahari membakar dan dengan itu mengeluarkan sinar matahari dapat menimbulkan radiasi matahari yaitu energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang pendek yaitu sinar-X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet.

Hal ini di dasarkan pada QS Shad/38:27.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”

Menurut Ibnu Katsi, Allah Ta’ala memberikan bahwa dia tidak menciptakan makhluk-Nya dengan sia-sia. Akan tetapi Dia menciptakan mereka untuk beribadah

kepada-Nya dan mengesahkan-Nya. Kemudian Dia akan menghimpun mereka pada hari kiamat, di mana orang yang taat akan diberikan pahala dan orang yang kafir akan disiksa. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia dengan keadilan dan kebijaksanaan-Nya tidak akan menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir.

Dimana tafsir diatas halnya bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, seperti halnya radiasi. Radiasi bermanfaat untuk kesehatan yaitu dapat mendiagnosa adanya suatu penyakit dalam tubuh baik berupa kanker maupunumor, namun dari berbagai manfaat yang dimiliki juga dapat merusak kesehatan manusia yang disebabkan pengaruh radiasi melebihi batas ambang yang ditentukan hingga dapat menyebabkan kecacatan.

2.5. Efek Biologi dari Radiasi

Dampak radiasi umumnya tidak langsung terdeteksi, tetapi setelah melalui beberapa waktu, karena sel biologi umumnya berusaha akan memperbaiki sendiri bersama sistem kekebalan tubuh. Walaupun demikian, gejala pertama yang dapat dirasakan adalah rasa demam dan sakit kepala, akibat adanya perpindahan panas (efek determinis), dan terdapat kemungkinan timbulnya kanker (efek non determinis).

Didalam sel terjadi dua proses yang utama yaitu ionisasi dan proses biokimia. Pada proses ionisasi, akan terjadi pancaran ikatan kimia (pembentukan ion) dari struktur kimia sel, sehingga sel akan menjadi rusak. Pada proses biokimia ionisasi

tidak langsung mengenai sel, melainkan bereaksi dengan air, yang akan mengakibatkan pancaran air menjadi H^+ dan OH^- dalam bentuk radikal yang sangat reaktif (Diana, 2010).

Tabel 2.1 Efek radiasi terhadap organ manusia

Organ dan efek	Dosis ambang (Sv)	
	Akut	Kronis (per tahun)
Testis		
Steril permanent	6	2
Steril sementara	0,1-1	0,5
Ovarium		
Steril	6-12	>0,2
Lensa mata		
Katarak	1	>0,1
Genetik	10	>0,15

(Diana, 2010).


2.6. Efek Kesehatan Radiasi

Interaksi radiasi pengion dengan tubuh manusia akan mengakibatkan terjadinya efek kesehatan. Efek kesehatan ini, yang dimulai dengan peristiwa yang terjadi pada tingkat molekuler, akan berkembang menjadi gejala klinis. Sifat dan keparahan gejala, dan juga waktu kemunculannya, sangat bergantung pada jumlah dosis radiasi yang diserap dan laju penerimaannya.

a. Efek Deterministik

Efek deterministik terjadi akibat adanya kematian sel sebagai akibat pajanan radiasi sejujur maupun lokal. Efek ini terjadi bila dosis radiasi yang di terima tubuh

melebihi nilai dosis ambang untuk terjadinya efek ini (lihat Gambar 2.6). Efek ini juga terjadi pada individu yang terpajan dalam waktu yang tidak lama setelah pajanan terjadi, dan tingkat keparahannya akan meningkat jika dosis yang diterimanya juga makin besar. Adapun organ yang dapat mengalami efek deterministik yaitu kulit, mata, paru, organ reproduksi, tiroid, janin.



Gambar 2.6 Efek Deterministik Radiasi
Sumber : Eri Hiswara 2015

Menurut Muh Rusli (2017) ada empat ciri khas mengenai efek deterministik ini adalah

1. Mempunyai dosis ambang.
 2. Umumnya timbul beberapa saat setelah penerimaan dosis radoasi.
 3. Dapat dilakukan penyembuhan spontan bergantung pada tingkat keparahannya; serta
 4. Keparahan efek deterministic spontan bergantung pada dosis radiasi yang diterima.
- b. Efek Stokastik

Berbeda dengan efek deterministik, efek stokastik tidak mengenal dosis ambang. Sesederhana apa pun dosis radiasi yang diterima, selalu ada peluang untuk terjadinya perubahan pada sistem biologik baik pada tingkat molekuler maupun seluler (lihat Gambar 2.7). Dalam hal ini yang terjadi bukan kematian sel namun perubahan sel dengan fungsi yang berbeda.



Gambar 2.7 Efek Stokastik Radiasi
Sumber : Eri Hiswara 2015

Bila sel yang mengalami perubahan adalah sel stomatik, maka sel tersebut dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan pengaruh dari bahan toksis lainnya, akan tumbuh dan berkembang menjadi kanker. Periode laten untuk terjadinya induksi leukemia, salah satu jenis kanker, diperkirakan sekitar 8 tahun, dan dua atau tiga kali lebih panjang untuk kanker solid (padat) seperti kanker payudara atau kanker tulang.

Kanker akibat radiasi pada dasarnya tidak berbeda dengan kanker akibat mekanisme lain. Karena itu, kebolehjadian induksi kanker hanya dapat dilihat secara epidemiologi berdasar kejadian berlebih secara statistic di atas kejadian alamiah atau spontan (Eri, 2015).

Menurut Muh Rusli (2017) ada empat ciri efek stokastik :

1. Tidak mengenal dosis ambang.
2. Timbulnya efek setelah melalui masa tunda yang lama.
3. Keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi.
4. Tidak ada penyembuhan spontan.

2.7. Alat-alat yang dipakai untuk mencatat dosis personil

Menurut Iwan Ekayuda (2005), alat-alat yang dipakai untuk mencatat dosis personil yaitu :

a. Dosimeter saku

Dosimeter saku adalah pengukuran dosis yang mempunyai respon (reaksi) terhadap radiasi seimbang dengan jumlah pasangan ion yang dihasilkan selama perjalanannya melalui elemen pendeteksian. Pada dasarnya dosimeter saku lebih teliti dari pada film badge. Bentuk dosimeter ini serupa ballpoint, yang berisi gas yang dapat terionisasi oleh radiasi.

b. Film badge

Fungsi film badge ialah untuk mencatat dosis radiasi yang diterima oleh personil (petugas) yang terkena berbagai jenis radiasi. Oleh sebab itu film badge yang dipakai harus cukup mampu untuk mencatat dosis radiasi yang berasal dari sumber radiasi yang berlainan kualitas.

2.8. Alat pengukur radiasi

1. Surveymeter

Menurut Iwan Ekayuda (2005), di Indonesia biasanya digunakan alat Geiger-Muller Survey meter yang bacaannya langsung dalam mR/jam (milli Roentgen per jam) atau count per menit. Pengaturan Geiger-Muller Surveymeter di bagian radiodiagnostik, ialah :

- a. Mengukur laju paparan di tempat-tempat : personil bekerja, dinding-dinding luar ruang sinar X, pintu-pintu, jendela kaca Pb.
- b. Memeriksa apakah alat-alat proteksi memenuhi syarat-syarat proteksi.

Menurut Hasmawati (2016), faktor kalibrasi dapat di hitung dengan persamaan berikut :

$$Fk = \frac{Ds}{Du} \quad (2.1)$$

Dengan :

Fk = Faktor kalibrasi alat ukur

Ds = Nilai dosis standar

Du = Nilai dosis bacaan alat ukur

2. Thermoluminisence Dosimeter (TLD)

Pembacaan TLD yang dipakai oleh pekerja radiasi IRM dilakukan oleh Pusat Teknologi Radioaktif (PRLR). Jenis TLD yang dipakai ialah jenis TLD HP(10) berkemampuan merekam radiasi β dan γ dengan daya tembus yang sinar γ setebal 10

mm dari permukaan kulit. TLD adalah alat ukur dosis personal yang bekerja berdasarkan adanya proses lumenisensi. Prinsip kerjanya seperti efek fotolistrik (Astuti, 2018).

2.9.Dosimetri Radiasi

Dosimetri merupakan cabang salah satu cabang ilmu yang secara kuantitatif berupaya untuk menentukan jumlah energi yang mengendap pada suatu bahan tertentu oleh radiasi pengion. Sejumlah besaran dan satuan dengan demikian perlu didefinisikan untuk menguraikan proses pengendapan energi tersebut (Eri Hiswara,2015). Ionisasi dalam jaringan dapat juga dihasilkan oleh radiasi selain foton, seperti alfa, beta, neutron, dan proton. Oleh sebab itu perlu suatu satuan yang tidak bergantung kepada macam radiasi, energi dan sifat bahan penyerap, tetapi hanya bergantung pada jumlah energi yang terserap per satuan massa bahan yang disinari. Satuan tersebut disebut dosis serap. Dosis serap, D , didefinisikan sebagai jumlah energi yang diserahkan oleh radiasi atau banyaknya energi yang diserap oleh suatu bahan per satuan massa bahan (Diana, 2010).

a. Besaran fisik

Besaran fisik yang penting adalah kerma dan dosis serap. Kerma adalah singkatan dari kinetik energi released per unit mass, atau energi kinetik yang dilepaskan per satuan massa. Besaran ini merupakan besaran yang berlaku untuk radiasi tak langsung seperti foton dan neutron, dan mengkuantifikasi jumlah energi

rata-rata yang dialihkan dari radiasi tak langsung ke radiasi langsung tanpa memedulikan apa yang terjadi setelah pengalihan berlangsung. (Eri Hiswara,2015).

b. Besaran proteksi

Besaran proteksi adalah besaran yang digunakan untuk tujuan penentuan nilai batas dosis, dan terdiri atas dosis serap, dosis ekivalen dan dosis efektif (Eri Hiswara, 2015).

a. Dosis serap

Besaran dosis serap yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi dari radiasi pengion yang diserap oleh medium (Milda,dkk 2014).

b. Dosis Ekivalen

Dosis ekivalen merupakan besaran dosimetri yang berhubungan langsung dengan efek biologi, yang didapatkan dari perkalian dosis serap dengan faktor bobotnya (Milda,dkk 2014).

c. Dosis Efektif

Dosis efektif diperlukan untuk menunjukkan keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ (Milda,dkk 2014).

2.10. Proteksi Radiasi

Proteksi radiasi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknik yang membahas tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pemberian

perlindungan terhadap seseorang atau sekelompok orang dari kemungkinan akibat negatif dari radiasi pengion.

Tujuan proteksi radiasi adalah membatasi peluang terjadinya resiko stokastik dan mencegah terjadinya efek non stokastik. Misalkan karakter pada lensa mata, dan kerusakan sel kelamin yang mengakibatkan kemandulan merupakan efek non stokastik, sedangkan efek genetik dianggap sebagai efek stokastik (Diana, 2010).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh International Commission on Radiological Protection (ICRP) untuk menghindari bahaya radiasi maka ditentukan suatu suatu dosis maksimum yang dapat diperkenankan sebagai pedoman dalam proteksi radiasi, yaitu Maximum Permissible Dose (MPD). Nilai MPD ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Oleh karena proteksi radiasi tidak saja ditinjau dari sudut efek somatik saja, tetapi juga efek genetik (Ahmadi, 2010).

Dosis maksimum yang dikenakan bagi pekerja radiasi berbeda dengan masyarakat umum. Bagi masyarakat umum tidak lagi memakai MPD, akan tetapi diganti dengan dosis limit (batas dosis). Maksud dari pemakaian dosis limit ini untuk memperoleh standarisasi dalam pelaksanaan proteksi pada pemakaian sumber-sumber radiasi sehingga masyarakat tidak mungkin mendapatkan radiasi yang membahayakan. Nilai batas dosis untuk masyarakat ialah $1/10$ dari pada MPD bagi pekerja radiasi (Ahmadi, 2010)

Tabel 2.2 Dosis Maksimum yang diperkenankan bagi pekerja radiasi.

Pekerja radiasi	MPD
Seluruh tubuh, sumsum tulang, kelenjar kelamin.	5 rem dalam 1 tahun atau 3 rem dalam 3 bulan. Dosis seluruhnya tidak melebihi 5 rem (N-18) rem. N= umur.
Kulit,tulang, dan kelenjar thyroid	30 rem dalam 1 tahun
Tangan, lengan bagian bawa dan pangkal kaki	75 rem dalam 1 tahun
Bagian lain dari tubuh	15 rem dalam 1 tahun

Tabel 2.3 Batas dosis Maksimum yang diperkenankan bagi masyarakat.

Pekerja radiasi	MPD
Seluruh tubuh, sumsum tulang, kelenjar kelamin.	0,5 rem dalam 1 tahun atau 0,3 rem dalam 3 bulan
Kulit,tulang, dan kelenjar thyroid	3 rem dalam 1 tahun
Tangan, lengan bagian bawa dan pangkal kaki	75 rem dalam 1 tahun, anak-anak dibawah umur 16 tahun : 1,5
Bagian lain dari tubuh	15 rem dalam 1 tahun

(Ahmadi, 2010).

Menurut Candra Ancila dan Eko Hidayanto (2016) ada tiga langkah yang harus selalu di perhatikan dalam proteksi radiasi eksternal adalah sebagai berikut :

1. Jarak

Menjaga jarak sejauh mungkin dari sumber radiasi. Intensitas radiasi akan berkurang dengan penambahan jarak mengikuti hukum kuadrat terbalik (*inverse square law*).

2. Waktu

Apabila harus berada di dekat sumber radiasi maka usahakan hanya dalam selang waktu sesingkat-singkatnya. Jumlah dosis yang terserap tubuh manusia akan berbanding lurus dengan selang terpaparasi radiasi.

3. Panahan Radiasi

Penggunaan bahan penahan radiasi dapat mengurangi paparan radiasi secara eksponensial. Jenis bahan harus disesuaikan dengan jenis radiasinya khususnya perbedaan antara radiasi foton dan rasiasi neutron.

Menurut Iwan Ekayuda (2005), tiga cara pengendalian tingkatan pemaparan radiasi :

1. Jarak, ternyata cara ini efektif karena intensitas radiasi dipengaruhi oleh hukum kuadrat terbalik.
2. Waktu, pemaparan dapat diatur dengan waktu melalui berbagai jalan, yaitu :
 - a. Membatasi waktu generator dihidupkan.

- b. Pembatasan waktu berkas diarahkan ke ruang tertentu.
- c. Pembatasan waktu ruang dipakai.

Bila ternyata dengan jarak dan waktu tidak mencukupi, maka dipakai cara tiga dibawa ini.

3. Perisai, perisai ini di buat dari timbal atau beton. Ada 2 jenis partikel, yaitu :
 - a. Perisai primer, memberi proteksi terhadap radiasi primer (berkas sinar guna). Tempat tabung sinar X dan kaca timbal pada tabir fluoroskopi merupakan perisai primer.
 - b. Perisai sekunder, memberi proteksi terhadap radiasi sekunder, kursi fluoroskopi dan perisai yang dapat dipindah-pindahkan, merupakan perisai sekunder.

2.11. Satuan-satuan radiasi

1. Roentgen

Roentgen ialah satuan pemaparan radiasi yang memberikan muatan $2,58 \times 10^{-4}$ coulomb per kg udara.

2. Rad

Rad ialah satuan dosis serap. Satu rad adalah radiasi yang diperlukan untuk melepaskan tenaga 100 erg dalam 1 gram bahan yang disinari (1 rad = 100 erg/gram).

Rad tidak bergantung pada komponen bahan yang disinari dan tenaga radiasi, akan tetapi jumlah rad per R pemaparan berbeda dengan tenaga berkas sinar dan komposisi bahan serap.

3. Gray (Gy)

$$1 \text{ Gray} = 100 \text{ rad}$$

Tabel 2.4 : Dosis serap kira-kira untuk jaringan per Roentgen pemaparan

Jaringan	Rad per Roentgen	Pemaparan
	50 KVp	1 MeV
Jaringan lunak	0,95	0,95
Tulang	5	0,9

4. Rem

Rem ialah satuan dosis ekuivalen. Rem adalah sama dengan dosis serap dikalikan dengan vaktor kualitas (Q F).

$$\text{Rem} = \text{rad} \times \text{Faktor Kualitas}$$

Rem merupakan ukuran efek biologis akibat radiasi. Karena factor kualitas untuk sinar X dan gamma adalah satu, maka dapat dianggap :

$$1 \text{ Roentgen} = 1 \text{ Rad} = 1 \text{ Rem}$$

Karena tenaga yang dilepaskan ke dalam jaringan lunak oleh 1 Roentgen pemaparan hanya 5 % lebih besar dari 1 Rad.

5. Sievert (Sv)

$$1 \text{ Sievert (Sv)} = 100 \text{ Rem}$$

Tabel 2.5 : Faktor kualitas berbagai jenis radiasi

Jenis radiasi	Faktor kualitas
Sinar X	1
Sinar gamma	1
Partikel beta	1
Proton	5

Neutron lambat	3
Neutron cepat	10
Partikel alfa	20


2.12. Nilai batas yang diizinkan

Nilai batas yang diizinkan untuk perorangan ialah dosis yang terakumulasi selama jangka waktu panjang atau hasil dari penyinaran tunggal, yang menurut pengetahuan dewasa ini, mengandung kemungkinan kerusakan somatic atau genetik yang dapat diabaikan, selain itu, besar dosis adalah sedemikian, yaitu setiap efek yang sering terjadi terbatas pada akibat yang ringan, sehingga tidak akan dianggap tidak dapat diterima oleh seseorang yang tersinari dan oleh instansi yang berwenang dalam bidang medis (Iwan, 2005).

2.13. Phantom

Phantom merupakan salah satu bentuk pemodelan dari objek manusia yang digunakan dalam bidang radiagnostik maupun radioterapi untuk evaluasi kualitas gambar radiograf secara realistis. Phantom yang banyak digunakan yaitu phantom yang terbuat dari akrilik karena mempunyai rapat massa yang hampir sama dengan


kerapatan air yakni $0,994 \text{ gr/cm}^3$. Hal ini dilakukan karena manusia terdiri dari 75 % molekul air (Astuti, 2018).



Gambar 2.8. Phantom Air

2.14. Instalasi Radiologi

Instalasi radiologi merupakan bagian dari pelayanan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan. Radiologi dalam bidang diagnostik ini menggunakan alat alat yang memancarkan energi radiasi pengion maupun bukan pengion. Pesawat atau alat yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi disebut pesawat sinar-X (Tri Dianasari, 2017: 177).

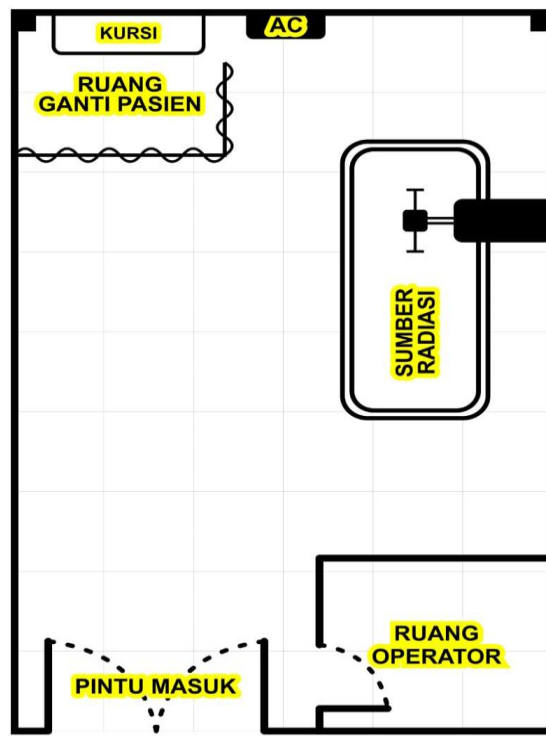

Gambar 2.8. Denah ruangan Pesawat sinar-X di RSUD Kota Makassar

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Agustus - Desember 2019 di Instalasi Radiologi Rumah Sakit RSUD Kota Makassar.

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pesawat sinar-X berfungsi sebagai sumber radiasi.
2. Surveymeter berfungsi untuk mengukur paparan radiasi.
3. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak sumber ke titik pengukuran.
4. Phantom berfungsi sebagai pengganti manusia.
5. Lembar tabel pengambilan data sebagai bahan yang akan diisikan dengan hasil pengamatan.

3.3. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.

2. Mengkaji studi literatur tentang pesawat sinar-X, radiasi, serta proteksinya.
3. Mengukur radiasi di seluruh bagian dalam ruangan sebelum menyalakan pesawat sinar-X.
4. Mengukur dosis yang dihasilkan pada pesawat sinar-X pada arah depan pesawat sinar-X dengan waktu dan jarak yang berbeda dengan tabel 3.1 pada waktu 0,05 detik yang ditetapkan dengan ketinggian surveymeter 50 cm dari lantai dan mencatatnya pada tabel 3.1 dengan melakukan kegiatan berikut.
 - a. Mengukur jarak dari tabung ke surveymeter sebesar 1 m (begitupula pada jarak 2 m, 3 m, 4 m, 5 m).
 - b. Mengukur ketinggian lantai terhadap surveymeter sebesar 50 cm.
 - c. Mengatur surveymeter ke keadaan semula (mengulangi kegiatan ini setiap pengambilan data).
 - d. Meninggalkan ruangan dan berada di ruangan pekerja radiasi untuk melakukan ekspos.
 - e. Sebelum ekspos dilakukan pertama-tama mengukur tegangan sebesar 70 kV dan kuat arus sebesar 100 mA.
 - f. Mencatat data yang didapatkan pada surveymeter pada lembar tabel yang telah disediakan.

5. Mengambil hasil data mentah dosis radiasi yang telah diterima oleh operator dan mencatat data tersebut pada tabel 3.5.

3.4. Tabel Penelitian

Adapun tabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,05 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,05	1	
	2	
	3	
	4	

Tabel 3.2 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,1 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,1	1	
	2	

	3	
	4	
	5	

Tabel 3.3 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,16 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,16	1	
	2	
	3	
	4	
	5	


Tabel 3.4 Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,2 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,2	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

Tabel 3.5. Pengambilan data mentah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja

NO	Pegawai/Operator	Radiasi yang diterima
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

3.5 Bagan Alir Penelitian

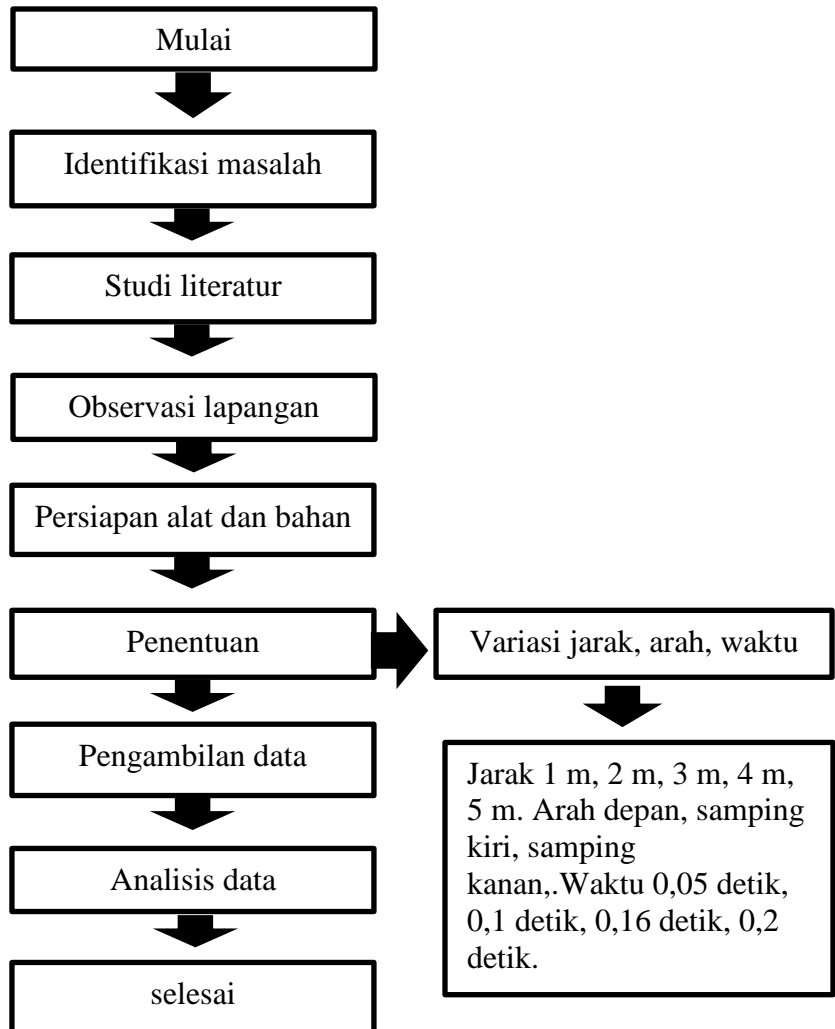

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesawat sinar-X yang digunakan dalam penelitian ini adalah pesawat sinar-X konvensional dengan merek SHIMADZU dengan tipe 06/1 2PI8DE-85 yang berada di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran besar paparan dosis radiasi pada pemeriksaan pesawat sinar-X konvensional dengan menggunakan faktor eksposisi sebesar 70 kV, 100 mA dengan waktu ekspos yang berbeda yakni sebesar 0,05 detik, 0,1 detik, 0,16 detik, 0,2 detik, pada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter dengan arah depan dengan waktu eksposi yang berbeda pada setiap objek sesuai ketentuan yang ada di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar, pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali setiap objek dari jarak dan arah menggunakan phantom. Adapun hasil pengukuran paparan dosis radiasi secara langsung dengan menggunakan alat ukur Surveymeter.

4.1. Paparan radiasi pesawat sinar-X Konvensional


Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan pesawat sinar-X konvensional diperoleh hasil paparan dosis radiasi dari arah dan berbagai jarak pada tabel berikut :

Tabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 4.1 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,05 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,05	1	243
	2	50,0
	3	25,9
	4	0

Dari tabel 4.1 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X pada waktu 0,05 detik dapat dibuat dalam grafik berikut :

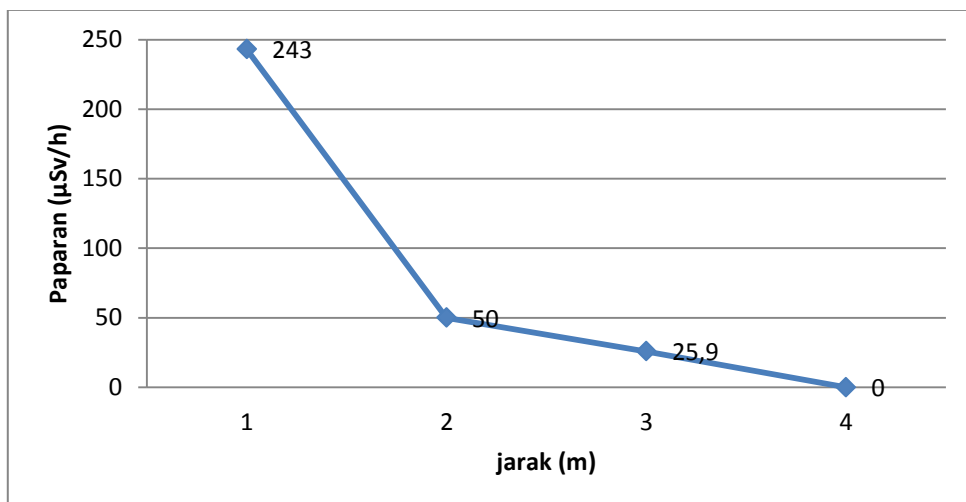


Gambar 4.1 : Grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,05 detik

Berdasarkan gambar 4.1 grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,05 detik. Radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada jarak 1 meter sebesar 243 $\mu\text{Sv/h}$ sedangkan radiasi yang terbaca kecil terdapat pada jarak 4 meter sebesar 0 $\mu\text{Sv/h}$. Nilai radiasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jarak 1 meter memiliki nilai dosis radiasi yang tinggi dibandingkan jarak 4 meter, hal ini disebabkan jarak terhadap sumber radiasi.

Tabel 4.2 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,1 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,1	1	572
	2	153
	3	31,9
	4	21,8
	5	0

Dari tabel 4.2 hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X pada waktu 0,1 detik dapat dibuat dalam grafik berikut :

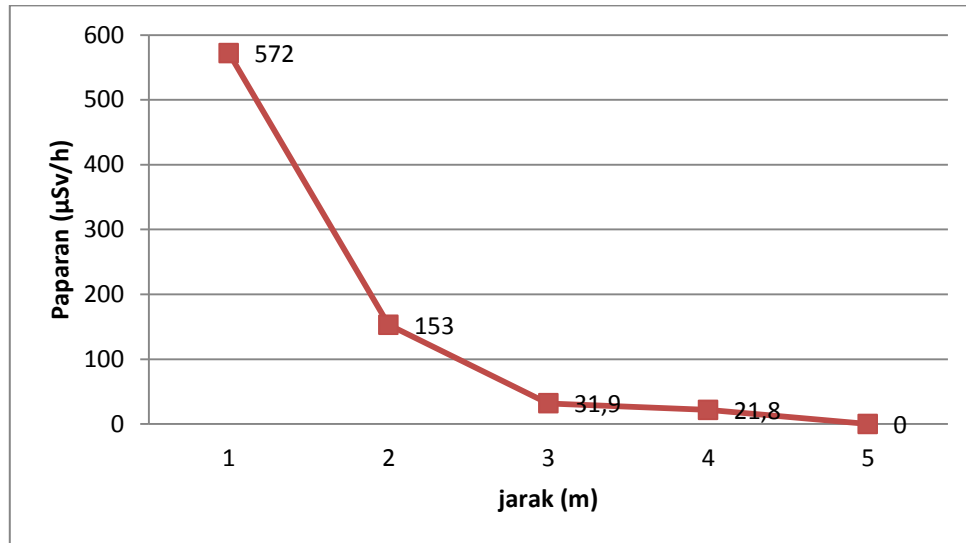

Gambar 4.2 : Grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,1 detik


Berdasarkan gambar 4.2 grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,1 detik. Radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada jarak 1 meter sebesar 572 $\mu\text{Sv/h}$ sedangkan radiasi yang terbaca kecil terdapat pada jarak 5 meter sebesar 0 $\mu\text{Sv/h}$. Nilai radiasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jarak 1 meter memiliki nilai dosis radiasi yang tinggi dibandingkan jarak 5 meter, hal ini disebabkan jarak terhadap sumber radiasi.

Tabel 4.3 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,16 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,16	1	1110
	2	312

	3	94,7
	4	13,9
	5	0

Dari tabel 4.3 hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X pada waktu 0,16 detik dapat dibuat dalam grafik berikut :

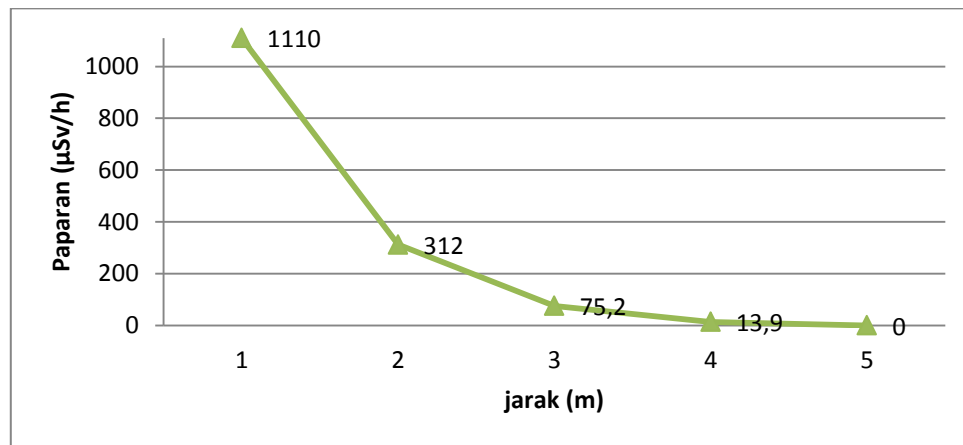


Gambar 4.3 : Grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,16 detik

Berdasarkan gambar 4.3 grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,16 detik. Radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada jarak 1 meter sebesar $1110 \mu\text{Sv/h}$ sedangkan radiasi yang terbaca kecil terdapat pada jarak 5 meter sebesar $0 \mu\text{Sv/h}$. Nilai radiasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jarak 1 meter memiliki nilai dosis radiasi yang tinggi dibandingkan jarak 5 meter, hal ini disebabkan jarak terhadap sumber radiasi.

Tabel 4.4 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,2 detik

Waktu (ms)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,2	1 meter	1430
	2 meter	414
	3 meter	75,2
	4 meter	22,7
	5 meter	0


Dari tabel 4.4 Hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X pada waktu 0,05 detik dapat dibuat dalam grafik berikut :

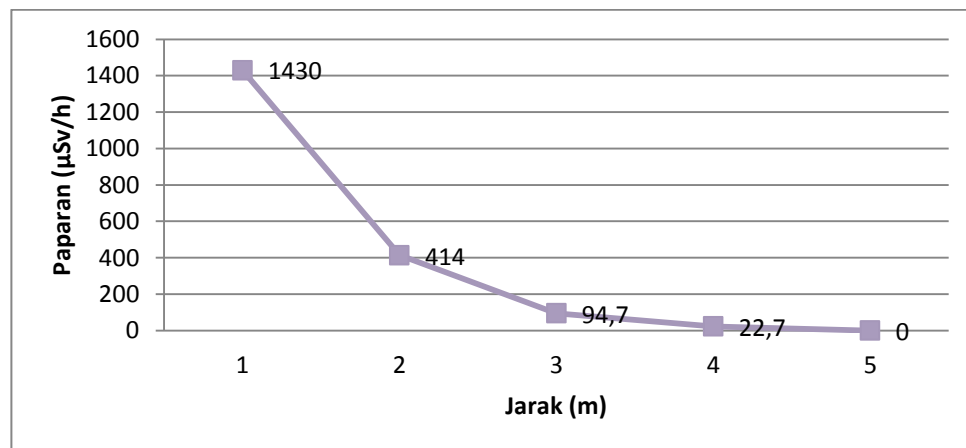

Gambar 4.4 : Grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,2 detik

Berdasarkan gambar 4.4 grafik hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,2 detik. Radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada jarak 1 meter sebesar 1430 $\mu\text{Sv/h}$ sedangkan radiasi yang terbaca kecil terdapat pada jarak 5 meter

sebesar 0 $\mu\text{Sv/h}$. Nilai radiasi yang didapatkan menunjukkan bahwa jarak 1 meter memiliki nilai dosis radiasi yang tinggi dibandingkan jarak 5 meter, hal ini disebabkan jarak terhadap sumber radiasi.

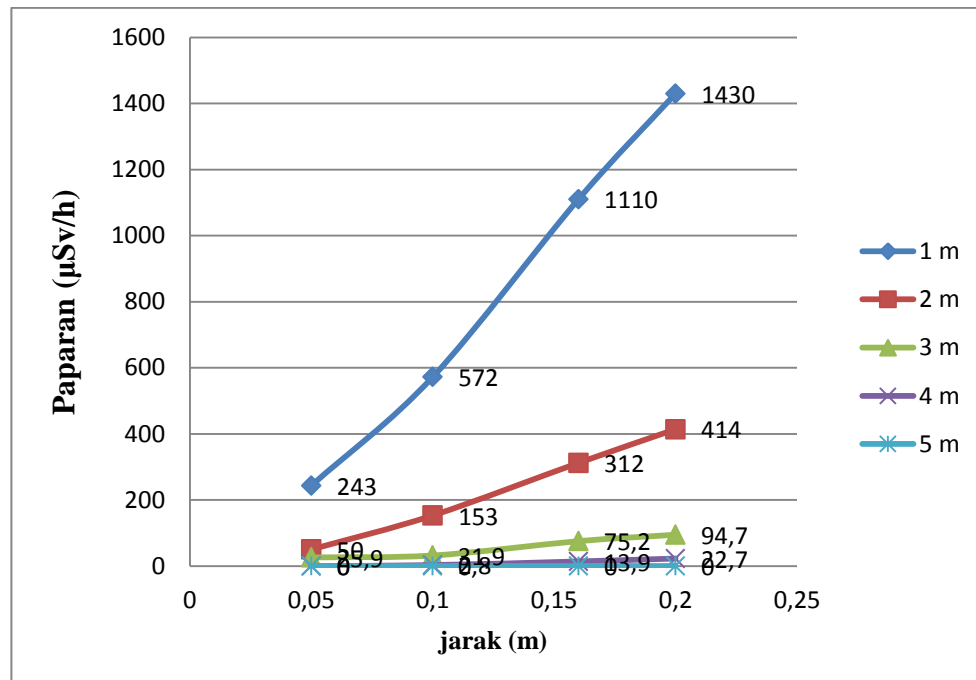

Gambar 4.5 Grafik pengaruh waktu paparan terhadap nilai dosis paparan radiasi

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan nilai radiasi yang dihasilkan pada jarak 1m, 2m, 3m, 4m, dan 5m dengan nilai waktu paparan yang berbeda yaitu 0,05 detik, 0,1 detik, 0,16 detik dan 0,2 detik. Radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada jarak 1 m dengan waktu paparan berbeda yaitu 0,05 detik sebesar 243 $\mu\text{Sv/h}$, 0,1 detik sebesar 572 $\mu\text{Sv/h}$, 0,16 detik sebesar 1110 $\mu\text{Sv/h}$, dan 0,2 detik sebesar 1430 $\mu\text{Sv/h}$ dan nilai radiasi yang terbaca kecil terdapat pada jarak 5 m sebesar 0 $\mu\text{Sv/h}$

pada keempat waktu yang berbeda yaitu 0,05 detik, 0,1 detik, 0,16 detik, dan 0,2 detik. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin jauh jarak terhadap sumber radiasi maka nilai paparan yang didapatkan akan semakin kecil sedangkan berdasarkan waktu paparan yakni semakin lama waktu yang digunakan maka nilai paparan radiasi yang didapatkan akan semakin besar hal ini dapat dilihat dari data hasil penelitian pada jarak 1 m dengan waktu paparan yang berbeda yakni yang terbesar terdapat pada 0,2 detik dengan nilai paparan sebesar 1430 $\mu\text{Sv/h}$ sedangkan nilai terendah terdapat pada 0,05 detik. Kesimpulan dari seluruh data yang didapatkan bahwa nilai dosis radiasi yang terbaca dipengaruhi oleh jarak, tegangan, arus, dan waktu.

Berdasarkan data hasil penelitian dimana waktu terbaik pada penelitian ini adalah 0,05 detik sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uswatun Hasanah tahun 2016 di laboratorium klinik parahita diagnostik center makassar dengan melakukan pengukuran radiasi hambur pada jarak 0 cm, 10 cm, 50 cm, dan 200 cm dengan variasi waktu sesuai yang diperlukan pada pemotretan gigi (0,50 detik, 0,64 detik, dan 0,74 detik) dari hasil penelitian menyatakan bahwa 0,50 detik adalah waktu yang paling baik. Dari hasil tersebut kita dapat melihat bahwa waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar dosis radiasi. Semakin kecil waktu paparan yang diberikan maka semakin kecil pula dosis radiasi paparan yang didapatkan, selain waktu jarak juga sangat mempengaruhi dosis radiasi paparan yang diterima dimana pada penelitian ini semakin jauh jarak yang diberikan maka semakin

kecil dosis radiasi yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak berbanding terbalik dengan dosis paparan sedangkan waktu berbanding lurus dengan dosis paparan.

4.2. Dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi

Data ini diperoleh langsung dari badan pengaman fasilitas kesehatan yaitu data mentah pembacaan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Pembacaan alat ini dilakukan 1 kali selama 3 bulan sehingga dapat dilihat seberapa besar radiasi yang diterima oleh pekerja.

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dosis radiasi yang diterima oleh pekerja dengan lama waktu pemakaian radiasi yang terbesar diterima oleh operator XIII yaitu sebesar 0.1769 mSv/h sedangkan nilai dosis yang terkecil diterima oleh operator XI sebesar 0.0593 mSv/h dan dosis rata-rata yang diterima oleh operator 0.1570mSv/h. hal ini sesuai dengan Perka BAPETEN No.4 Tahun 2013 yang diperoleh untuk pekerja yaitu sebesar 20 mSv/th.

Hal-hal yang mempengaruhi dosis yang di terima oleh pekerja atau operator yaitu :

1. Wilayah kerja terbagi-bagi
2. Tingkat kontaminasi radiasi
3. Penggunaan TLD

Tabel 4.5. Pengambilan data mentah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja/3 bulan.

No	Pegawai/Operator	Radiasi yang diterima mSv/h
1	Wahidah	0.1765
2	Yuliati	0.16
3	Roslina Andariskar	0.1705
4	Suhaerna	0.1626
5	Adima nur, S.Si	0.164
6	dr.St. Nasrah azis, Sp.Rad	0.1702
7	Sri Rahayu Sutiasih	0.1617
8	Yarlanti	0.1573
9	dr. Andarias Tambolang,Sp..Rad	0.1657
10	dr. Andi Rompengading. Sp.Rad., M.Kes	0.1617
11	Erli marlina	0.0593
12	Muhammad Ainullah	0.1553
13	Kartini	0.1769

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengujian keselamatan dari paparan radiasi sinar-X di unit radiologi RSUD kota makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan parameter jarak dan waktu dari sumber radiasi berpengaruh besar terhadap dosis paparan radiasi, karena semakin jauh jarak dari sumber radiasi maka dosis yang diterima semakin kecil. Sedangkan pengaruh besarnya waktu terhadap paparan sinar radiasi yaitu semakin lama waktu penyinaran maka semakin besar pula dosis radiasi yang diperoleh.
2. Nilai paparan radiasi hambur yang diterima oleh pekerja radiasi ruang radiologi RSUD Kota Makassar yaitu dosis radiasi yang diterima oleh pekerja dengan lama waktu pemakaian radiasi yang terbesar diterima oleh operator XIII yaitu sebesar 0.1769 mSv/h sedangkan nilai dosis yang terkecil diterima oleh operator XI sebesar 0.0593 mSv/h dan dosis rata-rata yang diterima oleh operator 0.1570mSv/h.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini diharapkan petugas radiasi memperhatikan jarak, waktu, serta kondisi alat yang digunakan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan tegangan yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda pula untuk melihat perbandingan yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancila, Candra dan Eko hidayanto. 2016. “Analisis Dosis Paparan Radiasi Pada Instalasi Radiologi Dental Panoramik”. Vol. 5, No 4, Oktober 2016, Hal. 441-450. ISSN : 2302-7371. (Diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- Arial, Muh Zakky, dkk. 2016. “Analisis Radiasi Hambur di Luar Ruang klinik Radiologi Medical Check Up (MPU)”. Jurnal ilmiah GIGA Volume 19 (1) Juni 2016, ISSN 1410-8682. (Diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- BAPATEN, 2013. “Surat Keputusan Kepala Bapaten Nomor 4 Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir”. Jakarta. (Diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- Barsasella, Diana. 2010. “Fisika Untuk Fisika Kesehatan”. CV. Trans Info Media: Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan terjemahannya. Diponegoro: Jakarta.. h 211.*
- Dianasari, Tri dan Herry Koesyanto. 2017. “Penerapan manajemen Keselamatan Radiasi Instalasi Radiologi Rumah Sakit”. Unnes Journal of Public Health 6 (3) (2017).
- Ekayuda, Iwan. 2005. “Radiologi Diagnostik Edisi Kedua”. Balai Penerbit FKUI: Jakarta.
- Giancoli, Douglas C. 2001. “Fisika Edisi Kelima Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.
- Hani, Ahmadi Ruslan. 2010. “Teori dan Aplikasi Fisika Kesehatan”. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Hasana, Uswatun. 2016. “Kajian Keselamatan Dari Paparan Radiasi Dental X-Ray di Laboratorium klinik Parahita Diagnostic Center Makassar”. Universitas Hasanuddin: Makassar. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2019).
- Hiswara, Eri. 2015. Buku Pintar Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Rumah Sakit. Batan Press: Batan. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2019).

- M, Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran, volume 5. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Mayerni, dkk. 2013. “Dampak Radiasi Terhadap Kesehatan Pekerja Radiasi di RSUD Arifin Achmad, RS Santa dan RS Awal Bros Pekanbaru”. (Diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- Rosyida, Novita. 2016. “Pengukuran Dosis Paparan di Area Ruang CT Scan dan Fluoroskopi RSUD DR. Saiful Anwar Malang”. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2019).
- Rusli, Muh. 2017. “Uji Keselamatan Paparan Radiasi Dental Sinar-X di Radiologi Atro Muhammadiyah Makassar”. Universitas Hasanuddin: Makassar. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2019).
- Utari, Milda, dkk. 2014. “Analisis Dosis Radiasi Terhadap Radioterapis Menggunakan Pocket Dosemeter, TLD Badge dan TLD-100 di Instalasi Radioterapi RSUD DR. M. Djamil Padang Studi Kasus (Mei-Oktober)2014”.
- Wiyatmo, Yusman. 2003. “Fiska Modern”. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

LAMPIRAN I
DATA HASIL PENELITIAN

Tabel 1.1 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,05 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,05	1	243
	2	50,0
	3	25,9
	4	0

Tabel 1.2 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,1 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,1	1	572
	2	153
	3	31,9
	4	21,8
	5	0

Tabel 1.3 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,16 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,16	1	1110
	2	312
	3	94,7
	4	13,9
	5	0

Tabel 1.4 Hasil Pengukuran paparan radiasi sinar X waktu 0,2 detik

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,2	1	1430
	2	414

	3	75,2
	4	22,7
	5	0

Tabel 1.5. Pengambilan data mentah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja per 3 bulan.

No	Pegawai/Operator	Radiasi yang diterima mSv/h
1	Wahidah	0.1765 (\pm 0.038)
2	Yuliati	0.16 (\pm 0.034)
3	Roslina Andariskar	0.1705 (\pm 0.036)
4	Suhaerna	0.1626 (\pm 0.035)
5	Adima nur, S.Si	0.164 (\pm 0.035)
6	dr.St. Nasrah azis, Sp.Rad	0.1702 (\pm 0.036)
7	Sri Rahayu Sutiasih	0.1617 (\pm 0.034)
8	Yarlanti	0.1573 (\pm 0.033)
9	dr. Andarias Tambolang, Sp..Rad	0.1657 (\pm 0.035)
10	dr. Andi Rompengading. Sp.Rad., M.Kes	0.1617 (\pm 0.034)

11	Erli marlina	0.0593 (\pm 0.034)
12	Muhammad Ainullah	0.1553 (\pm 0.033)
13	Kartini	0.1769 (\pm 0.038)

LAMPIRAN II
ANALISIS DATA

Analisis data radiasi dengan menggunakan persamaan (2.1)

$$Fk = \frac{Ds}{Du} \quad \text{atau} \quad Ds = Fk \times Du$$

Dengan

Fk = Faktor kalibrasi alat ukur (surveymeter)

Ds = Nilai dosis standar

Du = Nilai dosis bacaan alat ukur

2.1. Analisis hasil pengukuran dengan pesawat sinar-X konvensional diperoleh dari hasil paparan radiasi dari berbagai jarak dan arah pengukuran paparan

A. Analisis hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,05 detik

$$Fk = 1,00$$

$$Du = 243 \mu\text{Sv/h}$$

$$Ds = 1,00 \times 243 \mu\text{Sv/h}$$

$$Ds = 243 \mu\text{Sv/h}$$

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,05	1	243
	2	50,0

	3	25,9
	4	0

B. Analisis hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,1 detik

$$F_k = 1,00$$

$$D_u = 572 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 1,00 \times 572 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 572 \mu\text{Sv/h}$$

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,1	1	572
	2	153
	3	31,9
	4	21,8
	5	0

C. Analisis hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,16 detik

$$F_k = 1,00$$

$$D_u = 1110 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 1,00 \times 1110 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 1110 \mu\text{Sv/h}$$

Waktu (detik)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,16	1	1110
	2	312
	3	94,7
	4	13,9
	5	0

D. Analisis hasil pengukuran paparan radiasi sinar-X waktu 0,2 detik

$$F_k = 1,00$$

$$D_u = 1430 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 1,00 \times 1430 \mu\text{Sv/h}$$

$$D_s = 1430 \mu\text{Sv/h}$$

Waktu (0,2)	Jarak (meter)	Paparan ($\mu\text{Sv/h}$)
0,2	1	1430
	2	414
	3	75,2
	4	22,7
	5	0

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI















 **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar

UJI KESESUAIAN

Merk : SHIMADZU
Model/Type : 06/19-2PI8DE-85
S/N Tabung : RM6F3B059014

No. Reg: 38.002.17.40063 Tanggal: 02 Mei 2017



LAMPIRAN IV

PERSURATAN



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 3028 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **RISKA YULIAMDANI, NIM: 60400115051**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Sekertaris : Nurman Najib, S.Ag., M.M.
Penguji 1 : Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Penguji 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji 3 : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.
Pelaksana : Agusdin, S.Sos.
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 November 2019

Dekan
Kuasa Nomor : B.4293/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2019
Tanggal 11 November 2019





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1627 TAHUN 2019
TENTANG**

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Riska Yuliamdani NIM 60400115051 tertanggal 30 Juli 2019, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Rahmaniah, S.Si.,M.Si
Sekretaris : Hernawati, S.Pd.,M.Pfif
Pembimbing 1 : Sahara,S.Si., M.Sc.,Ph.D.
Pembimbing 2 : Nurul Faudi, S.Si., M.Si.
Penguji 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si
Penguji 2 : Dr. Abdullah, M.Ag
Pelaksana : Ariesty Susanti, SKM

- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 30 Juli 2019
 Dekan

Kuasa Nomor : B.2464/Un.06/FST/KP.07.6/11/2019
 Tanggal 30 Juli 2019



Dr. M. Thahir Maloko, M.HI
 Nip. 19631231 199503 1 006



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 123 TAHUN 2020**

TENTANG

**DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL SKRIPSI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan : **Riska Yuliamdani**
Nim : **60400115051**
Tanggal : **23 Januari 2020**
Jurusan : **Fisika**
Untuk melaksanakan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian yang berjudul :
Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar
- Menimbang** :
- a. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Skripsi.
 - b. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil Skripsi maka dipandang perlu menetapkan Dewan penguji dan pelaksana dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN 'Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf	Paraf

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL SKRIPSI**
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji dan Pelaksana Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Rahmaniah, S.Si., M.Si.**
Sekretaris : Hernawati, S.Pd., M.Pfis
Pembimbing1 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Pembimbing 2 : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.
Penguji 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 2 : Dr. Abdullah, M.Ag.
Pelaksana : Hadiningsih, S.E.
- KEDUA : Tugas Dewan Penguji Hasil Penelitian dan Pelaksana Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi:
- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
 - b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
 - c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian
 - d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
 - e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil;
- KETIGA : Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi dilaksanakan **pada hari dan tanggal : Kamis, 30 Januari 2020, Jam 09.00 - 10.00 Wita. Bertempat di Ruang Jurusan Fisika.**
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 23 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :351 TAHUN 2020**

TENTANG


**DEWAN MUNAQISY DAN PELAKSANA UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Membaca : Surat permohonan : **Riska Yuliamdani**
NIM : **60400115051**
Tanggal : **17 Februari 2020**
Jurusan : **FISIKA**

Untuk Melaksanakan Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul
"Penguji Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar X di Unit
Radiologi RSUD Kota Makassar"

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi (Munaqasyah).
b. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan ujian Skripsi (Munaqasyah) perlu menetapkan Dewan Munaqisy dan pelaksana dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf :	Paraf : 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN MUNAQISY DAN PELAKSANA UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH).
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji dan Pelaksana Ujian Skripsi (Munaqasyah). Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.d
 Sekretaris : Rahmaniah, S. Si., M.Si
 Pembimbing 1 : Sahara, S.Si., M.Sc.Ph.D.
 Pembimbing 2 : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.
 Penguji 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
 Penguji 2 : Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag.
 Pelaksana : Hadiningsih, S.E.
- KEDUA : Tugas Dewan Munaqisy dan Pelaksana :
- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian munaqasyah
 - b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
 - c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian
 - d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Munaqasyah
 - e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Munaqasyah;
- KETIGA : Ujian Skripsi (Munaqasyah) dilaksanakan pada hari dan tanggal: **Senin, 24 Februari 2020, Jam 08.00 - 09. 00 Wita. Bertempat di Ruang Jurusan Fisika.**
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Gowa
 Pada tanggal : 17 Februari 2020

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Kuasa Nomor : B.339/Un.06/F ST/KP.07.6/2/2020
 Tanggal 14 Februari 2020
 Wakil Dekan Bidang Akademik



SJAMSIAH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~2742~~ Un.6/FST/PP.00.9/08/2019

Makassar, 09 Agustus 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Peminjaman Alat Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Riska Yuliamdani
NIM	: 60400115051
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D 2. Nurul Fuadi, S.Si., M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "Penguji Keselamatan Dari Paparan Radiasi Sinar -X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Peminjaman Alat Penelitian yaitu, **Surveymeter**

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Dekan
Kuaa : No.2742/Un.06/FST/Kp.07.6/08/2019
Tanggal, 07 Agustus 2019

Dr. Andi Suarda, M.Si
Np. 19630324 199403 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar 90245 | Tlp./Fax : 0411 - 582345/588199
 website : www.bpfkmakassar.go.id | e-mail : admin@bpfkmakassar.go.id

Nomor : DM.03.01/3/2019/2019

15 Agustus 2019

Perihal : Izin Peminjaman Alat Penelitian

Kepada Yth.

Dekan FSAINS & Teknologi UIN Alauddin Makassar

di-

Makassar

Sehubungan dengan surat nomor 2783/Un.6/FST/PP.00.9/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, perihal izin peminjaman alat penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa(i) FSAINS & Teknologi UIN Alauddin Makassar. Pada dasarnya kami bersedia untuk menerima mahasiswa(i) :

Nama : Riska Yuliamdani
 Program Studi / Instansi : S.1 Fisika UIN Alauddin Makassar
 Judul Penelitian : Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sina-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar
 Pembimbing : Ikkal, S.Si

Untuk memberikan izin peminjaman alat penelitian kepada mahasiswa(i) tersebut sepanjang tidak mengganggu kelancaran kegiatan perkantoran di BPFK Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Seksi Tata Operasional BPFK Makassar.
2. Menyerahkan 1(satu) rangkap copy hasil penelitian ke seksi Tata Operasional.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,
 Kepala Seksi Tata Operasional

Hasanudin, SE
 Nip. 196606121991031002



CERT NO : 13-1-0276
 ISO 9001 : 2008



Komite Akreditasi Nasional
 Lab. Penga. LP-439-104
 Lab. Kalibrasi LA-146-104



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 ☎ 0411-513127 – 510016 Fax. 0411 – 587256 Makassar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 237 /YM-RSUD-MKS/VIII/2019

DASAR		Tanggal 09 Agustus 2019
Radiologi	1. Surat Permohonan Penelitian	
	2. Surat Rekomendasi Nomor 070/3180-II/BPKP/VIII/2019	
	3. Surat Persetujuan dari KOMITE ETIK	Tanggal
	


MENGIZINKAN

NAMA/NIM : Riska Yuliamdani /60400115051
 INSTITUSI/LEMBAGA : UIN Alauddin
 ALAMAT : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar
 TELP. :
 UNTUK : MELAKSANAKAN PENELITIAN DI RSUD KOTA
 MAKASSAR DENGAN KETERANGAN SEBAGAI
 BERIKUT;

- a. Judul Penelitian : ***“PENGUJIAN KESELAMATAN DARI PAPARAN RADIASI SINAR-X DI UNIT RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR”***
- b. Jenis Penelitian :
- c. Lama Penelitian : 08 Agustus s/d 07 September 2019

Izin Penelitian ini berlaku selama Penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 14 Agustus 2019


 Hasanuddin, S. Kep. Ns. M. Kes. Ph.D.
 Pangkat/Gol : Penata/III.c
 Nip. 198308282009011912



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
JURUSAN FISIKA

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp/Fax (0411) 8221400

Hal : **Permohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Di-
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riska Yuliamdani
 NIM : 60400115051
 Semester : VIII
 Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
 Jurusan : Fisika
 Pembimbing : 1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
 2. Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "**Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar**".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dibuatkan surat izin Penelitian dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk penelitian di;

1. RSUD Kota Makassar

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Samata, 29 Juli 2019
 Ketua Jurusan Fisika

Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D
 NIP.19810927 200604 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : **2633**/Un.06/FST/PP.00.9/07/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**

Samata Gowa, 30 Juli 2019

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Riska Yuliamdani**
NIM : 60400115051
Jurusan : **FISIKA**
Judul Skripsi : "Pengujian Keselamatan dari Paparan Radiasi Sinar X di Unit Radiologi RSUD Kota Makassar"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : **Senin / 05 Agustus 2019**
Waktu : **09.00 - 10.00 Wita**
Tempat : **Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar**

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Kuasa Nomor ; **B.2464/Un.06/FST/KP.07.6/11/2019**
Tanggal **30** Juli 2019



Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
Nip. 19631231 199503 1 006

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 08 Agustus 2019

K e p a d a

Nomor : 070 /3180 -II/BKBP/VIII/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. DIR. RSUD DAYA KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 21084/S.01/PTSP/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :


Nama : RISK A YULIAMDANI
NIM / Jurusan : 60400115051 / Fisika
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar
Judul : *"PENGUJIAN KESELAMATAN DARI PAPARAN RADIASI SINAR-X DI UNIT RADIOLOGI RSUD KOTA MAKASSAR"*

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal *08 Agustus s/d 07 September 2019*.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN;


Ir. H. JAMALING, M.Sc
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19601231 198003 1 064

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Sanis & Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21084/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor : 2466/Un.6/FST/PP.00.9/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISKA YULIAMDANI**
 Nomor Pokok : 60400115051
 Program Studi : Fisika
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Stt Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGUJIAN KESELAMATAN DARI PAPARAN RADIASI SINAR-X DI UNIT RADIOLOGI RSUD KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Agustus s/d 07 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 02 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar,
 2. Peringatan.



RIWAYAT HIDUP



Riska Yuliamdani yang sering di panggil Riska, anak pertama dari dua bersaudara. lahir di lapai pada tanggal 16 Juli 1997 tepatnya di Desa Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia lahir dari pasangan suami istri Ambo Sengeng dan Sitti Mardani. Riwayat pendidikan beliau yaitu pernah bersekolah di TK Gersamata Lapai, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Lapai. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ngapa, hingga melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pakue. Kemudian melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Program Studi S-1 Fisika Reguler Fakultas Sains dan Teknologi. Sampai pada biografi ini di tulis, penulis menjalani semester 9. Pengalaman organisasi di kampus yaitu anggota HMJ-Fisika (Devisi Dana dan Usaha).