

**ANALISIS PERBANDINGAN DOSIS SERAP RADIASI
FOTO THORAX PADA PASIEN DENGAN BERBAGAI
TINGKATAN UMUR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ANDI MUSFIRA

NIM: 60400111006

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, { Oktober 2016

Penyusun



ANDI MUSFIRA
NIM: 60400111006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Dengan Berbagai Tingkatan Umur**” yang disusun oleh Andi Musfira, NIM: 60400111006, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqassyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 M yang bertepatan dengan 03 Dzul-Hijjah 1437 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 3 Oktober 2016 M

2 Muharram 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sabri AR., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Said I., S.Si., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc. Ph.D	(.....)

Diketahui Oleh

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**



Prof/Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satu pun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Dengan Berbagai Tingkatan Umur**” ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh Karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Alm. Andi Muhyddin**, Ibunda **Indo Tang**, kakak-kakak dan suamiku **Imat** tercinta yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih

saying serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak **Muh. Said. L, S.Si., M.Pd** selaku pembimbing I dan kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph. D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini berperan besar selama masa studi kami.

4. Bapak **Ihsan, S.Pd.,M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi selaku penguji I yang selama ini membantu kami selama masa studi dan memberikan motivasi serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Ria Rezki Hamzah S.Pd., M.Pd** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Sabri AR, M.Ag** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada kepala Instalasi Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instalasi Radiologi Rumah Sakit serta karyawan-karyawati dan adik-adik dari kampus ATRO yang juga banyak membantu dalam proses penelitian.
9. Kepada Keluarga besar Alm. **Andi Muhyidin** serta saudara-saudaraku kakak **Warni**, kakak **Baso**, kakak **Dewi**, kakak **Runi dan** kakak iparku yang senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada suamiku **Imat** tercinta yang telah membantu penulis selama masa penyusunan dan penyelesaian skripsi dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2011 **Yana S.Si, Afni S.Si, Karra S.Si, Ayu S.Si, Chaca S.Si, Wani S.Si, Maya S.Si, Isna S.Si, Tahir S.Si, Ari S.Si, Darma S.Si, Misbah, Erha, Fia S.Si, Irma S., S.Si, Diah S.Si** dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan diatas yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta teman-teman di Pondok Aulia yang memberikan berjuta cerita sedih dan membahagiakan dan kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, adik-adik 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkucuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang scinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Aamiin.

Gowa, 17 Oktober 2016

Penulis,



ANDI MUSFIRA
NIM.60400111006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR GAMBAR.....	xi-xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SIMBOL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Radiasi Dan Penerapannya.....	8
2.2 Interaksi Radiasi dengan Materi Fisik	10
2.3 Besaran dan Satuan Radiasi	14
2.4 Sinar X	15

2.5 Pesawat Sinar X	24
2.6 Pemeriksaan Thorax	26
2.7 Faktor-Faktor Pembentukan Gambar Radiografi atau Faktor Ekspose	30
2.8 Identifikasi Jenis Penyakit yang Bisa direkam oleh Foto Thorax	32
2.9 Aspek Proteksi Radiasi	33
2.10 Pengukuran Dosis Serap Radiasi	34
2.11 Rekomendasi Dosis Maksimum Radiasi	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat	40
3.2 Alat dan Bahan	40
3.3 Sampel Penelitian	42
3.4 Prosedur Kerja	42
3.5 Teknik Analisis Data	43
3.6 Teknik Pengambilan Data	43
3.7 Diagram Alir Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.2 Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59

5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
Lampiran I : Hasil Analisis Dosis Serap.....	66
Lampiran II : Dokumentasi Foto.....	73
Lampiran III : Dokumentasi Surat Keterangan Penelitian	81
Lampiran IV : Dokumentasi Surat Keputusan	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Spektrum Gelombang Elektromagnetik	9
Gambar 2.2 Proses Efek Fotolistrik	10
Gambar 2.3 Hamburan Compton	12
Gambar 2.4 Produksi Pasangan	13
Gambar 2.5 Tabung Pesawat Sinar X	16
Gambar 2.6 Produksi Sinar X <i>Bremsstrahlung</i>	23
Gambar 2.7 Ilustrasi terjadinya Sinar X Karakteristik	23
Gambar 2.8 Pesawat Sinar X	24
Gambar 2.8 Anatomi <i>thorax</i> pada manusia	26
Gambar 2.9 Posisi Pasien Posterior Anterior	28
Gambar 2.10 Posis Pasien Anterior Posterior	29
Gambar L.1 Ruang Rontgen	L74
Gambar L.2 Ruang Ekspose.....	L74
Gambar L.3 Ruang Ganti	L74
Gambar L.4 Penyiapan Alat Rontgen	L74
Gambar L.5 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien	L75
Gambar L.6 Kontrol Ekspose	L75
Gambar L.7 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien	L75
Gambar L.8 Kontrol Ekspose	L75
Gambar L.9 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien	L76

Gambar L.10 Kontrol Expose	L76
Gambar L.11 Proses Pengambilan Foto Thorax	L76
Gambar L.12 Kontrol Expose	L76
Gambar L.13 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L77
Gambar L.14 Kontrol Expos	L77
Gambar L.15 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L77
Gambar L.16 Kontrol Expose	L77
Gambar L.17 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L78
Gambar L.18 Kontrol Expose	L78
Gambar L.19 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L78
Gambar L.20 Kontrol Expose	L78
Gambar L.21 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L79
Gambar L.22 Kontrol Expose	L79
Gambar L.23 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L79
Gambar L.24 Kontrol Expose	L79
Gambar L.25 Pemilihan Sampel Penelitian Sekaligus Mengatur Posisi Pasien ..	L80
Gambar L.26 Kontrol Expose	L80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Dosis Serap Pada Pasien Anak-Anak	49
Grafik 4.1 Dosis Serap Pada Pasien Remaja	51
Grafik 4.2 Dosis Serap Pada Pasien Dewasa	53
Grafik 4.3 Dosis Serap Pada Pasien Lansia	55
Grafik 4.4 Hubungan Antara Dosis Serap Radiasi Dengan Tegangan	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dosis Maksimum Yang Diperkenankan Bagi Pekerja Radiasi	39
Tabel 2.2 Dosis Maksimum Yang Diperkenankan Bagi Masyarakat	39
Tabel 2.3 Rekomendasi Dosis Maksimum Yang Diperbolehkan	40
Tabel 3.1 Untuk Usia Anak-Anak 1-11 Tahun	44
Tabel 3.2 Untuk Usia Remaja 12-25 Tahun.....	44
Tabel 3.3 Untuk Usia Dewasa 26-45 Tahun	45
Tabel 3.4 Untuk Usia Lanjut (Lansia) 46-85 Tahun	45
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Dosis Serap Untuk Anak-Anak 1-11 Tahun	48
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Dosis Serap Untuk Remaja 12-25 Tahun	50
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Dosis Serap Untuk Dewas 26-45 Tahun	52
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Dosis Serap Untuk Lansia 46-85 Tahun	54

DAFTARSIMBOL

No	Simbol	Keterangan	Satuan	Hal
1	V	Tegangan tabung sinar X	kV	30
2	I	Arus tabung sinar X	mA	30
3	t	Waktu yang diperlukan untuk menyinari	S	31
4	FFD	Jarak dari tabung ke objek	Cm	30
5	λ	Panjang gelombang (10^{-10} cm)	Cm	11
6	E	Energi	J	13
7	m_e	Massa elektron ($m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg)	Kg	13
8	C	Kecepatan cahaya ($c = 3 \times 10^8$ m/s)	m/s	13
9	Gy	Dosis serap radiasi	mGy	14
10	E	Dosis paparan radiasi	mR	36

ABSTRAK

Nama : **Andi Musfira**
NIM : **60400111006**
JudulSkripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN DOSIS SERAP RADIASI FOTO THORAX PADA PASIEN DENGAN BERBAGAI TINGKATAN UMUR**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dosis serap radiasi foto thorax yang diterima oleh pasien anak-anak, dewasa dan lanjut usia pada saat menjalani pemeriksaan radiodiagnostik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dosis serap dianalisis dengan menggunakan data dari tegangan (kV), arus (mA), dan waktu (s) yang diperoleh dari kontrol ekspose. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien anak-anak (1-1 tahun) sekitar (0,0631-0,1494) mGy, pada pasien remaja (12-25 tahun) sekitar (0,0604-0,2223) mGy, dewasa (26-45 tahun) sekitar (0,0888-0,1859) mGy dan pada pasien lansia (46-85 tahun) antara (0,0814-0,2279). Kesimpulan pada penelitian ini bahwa dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien yang paling besar adalah pasien dewasa (26-45 tahun), lansia (46-85 tahun), remaja (12-25 tahun) dan anak-anak (1-11 tahun).

Kata Kunci: *Radiasi, dosis serap, Foto thorax, sinar x*

ABSTRACT

Name : **ANDI MUSFIRA**
NIM : **60400111044**
Thesis Title : **COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATION DOSE
ABSORBENCY THORAX PATIENTS WITH ALL**

This study aims for identify and analyze absorbsency dose of radiationthorax received by patients of children, adults and the elderly at the time undergoing radiodiagnostic examination. The method used in this research that the absorbed dose is analyzed using data from the voltage (kV), current (mA), and time (s) obtained from the control exposure. The results showed that in pediatric patients (1-15 years) can receive radiation absorbed dose in the range of (0,0593 to 0,1326) mGy, patients were categorized adults aged (30 -45 years) received the absorbed dose ranges between (0,1316 to 0,1795) mGy and absorbed dose received by elderly patients aged (70-85 years) ranged (0,0814 to 0,1375) mGy. The conclusion of this research that the absorbed dose of radiation received by patients most adala adult patients (30-45 years old), the elderly (70-85 years) and children (1-15 years).

Keywords: *Radiation, doses absorption, photo thorax, x-rays,*

BAB I


PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi nuklir untuk kesejahteraan manusia telah merambah keberbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, industri dan riset kebumihan, energi, pangan dan pertanian, ilmu fisika dan kimia, serta kelautan dan hidrologi dan lain-lain (Lusiyanti dan Syaifudin, 2008).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang kedokteran saat ini membuat penggunaan sinar X semakin bertambah luas. Salah satu penggunaan sinar X dalam bidang kedokteran adalah sebagai alat bantu diagnostik dan terapi.

Segala hal yang telah diciptakan oleh Allah swt., memiliki manfaat dan kegunaan yang dapat menunjang kehidupan manusia (Iswadi, 2012). Contoh pemanfaatan hasil ciptaan Allah swt.,terdapat dalam Q.S An-Nahl: 69 (Kementrian Agama R.I., 2009, hal: 274).

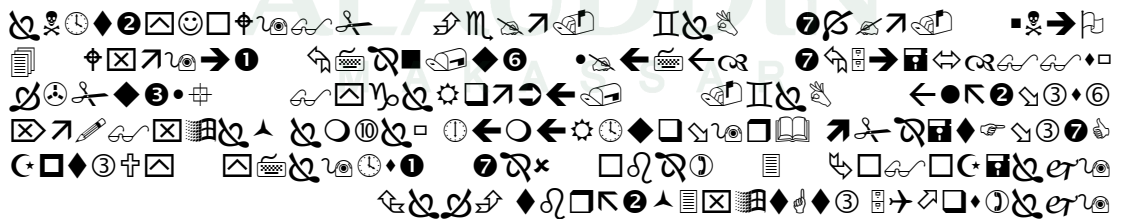

TerjemahNya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (Q.S An-Nahl:69)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan tentang madu yang mengandung obat penyembuhan bagi manusia dijadikan alasan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa madu adalah obat bagi segala macam penyakit. Tetapi banyak kata dokter mengatakan bahwa manusia yang mengidap penyakit diabetes tidak dapat mengkonsumsi madu. Ini menunjukkan bahwa madu tidak menjadi obat penyembuh untuk semua penyakit. Redaksi ayat ini menurut Ibn'Asyur, telah mengisyaratkan bahwa madu bukanlah obat semua penyakit. Pada kalimat yang terakhir berbunyi "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya" yang artinya sesuatu yang memerlukan pemikiran atau pengetahuan untuk mengetahui manfaat suatu penemuan seperti sinar X atau pemikiran untuk mengetahui dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien dari pesawat sinar X (Shihab, 2002).

Dalam ayat tersebut disebutkan madu, dapat berfungsi sebagai obat. Tetapi perlu diteliti penyakit apa saja yang dapat disembuhkan atau dicegah oleh madu. Namun yang menjadi catatan adalah segala manfaat (untuk obat). Ayat ini ditutup dengan kalimat bagi orang-orang yang berfikir atau bagi orang-orang yang memikirkannya yang artinya bahwa segala sesuatu memerlukan suatu pengetahuan dan riset untuk mengetahui kandungan dan manfaatnya bagi manusia, maka nuklir merupakan obat bagi manusia apabila digunakan dengan dosis yang sesuai.

Unit pelayanan radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik yang berhubungan dengan studi dan penerapan berbagai teknologi pencitraan dengan menggunakan sumber radiasi pengion. Sumber radiasi pengion tersebut harus

mempunyai daya tembus yang sangat besar sehingga mampu menembus bahan yang dilaluinya, salah satunya yaitu berasal dari pesawat sinar X (Evi Widayati, 2013).

Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya (foton) dari sumber radiasi. Radiasi yang ditimbulkan dari tindakan medis yang berasal dari sumber buatan manusia, misalnya radiasi dari sinar X. Radiografi atau Roentgen sinar X termasuk kedalam radiasi pengion yang merupakan sarana penunjang diagnostik yang sudah berkembang pesat. Dalam bidang medis penggunaan sinar X untuk pencitraan diagnostik telah digunakan selama lebih dari satu abad. Salah satu manfaat sinar X adalah dapat mendeteksi penyakit kelainan organ dengan cepat melalui radiodiagnosa (A. Fauziyah dan P. Dwijananti, 2012)

Pesawat sinar X (foto Rontgen) berfungsi untuk foto thorax, tulang tangan, kaki dan organ tubuh yang lainnya (Karmila Bandu, 2014). Bila sinar X diinteraksikan dengan bahan maka hasilnya dapat diteruskan, dihamburkan dan diserap. Banyaknya foton sinar X yang diteruskan dan dihamburkan dapat berpengaruh pada kualitas radiograf yang dihasilkan, sedangkan foton sinar X yang diserap hanya akan berpengaruh pada dosis radiasi yang diterima oleh pasien (Arif Fahmi, K. Sofjan Firdausi dan Wahyu Setia Budi, 2008).

Menurut Masrochah (2000), dari kemampuan sinar X dapat menembus bahan perekam berupa emulsi film, maka akan timbul perbedaan kehitaman (kontras) akibat perbedaan kerapatan organ yang dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk menampakkan radiograf.

Evi Widayati (2013) telah melakukan penelitian untuk mengetahui dosis serap yang diterima oleh pasien anak-anak dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari radiasi yang berlebihan saat menjalani pemeriksaan radiodiagnostik dalam penelitiannya nilai dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki atau anak-anak yang berjenis kelamin perempuan dengan umur yang berbeda-beda diperoleh nilai rata-rata dosis serap yang beragam.

Ada pula penelitian lain yang dilakukan oleh Karmila Bandu (2014) tentang efek radiasi sinar X pada anak-anak menyatakan bahwa dapat terjadi kerusakan jaringan atau dapat memberikan efek yang berbahaya pada manusia apabila kelebihan dalam memberikan dosis radiasi foto thorax pada pasien anak-anak. Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Helfi Yuliati dan Mukhlis Akhadi (2001), menyatakan bahwa ada tiga parameter pengoperasian pesawat sinar X sangat berpengaruh terhadap penerimaan dosis oleh pasien, yaitu tegangan puncak (kVp), intensitas keluaran pesawat dan lamapenyinaran. Karena intensitas sinar X ditentukan oleh arus listrik (I) dalam filamen yang nilainya berordemili ampere (mA), dan lama penyinaran berorde detik (s), maka dua parameter terakhir dapat digabung dalam bentuk perkalian antara arus dan waktu dengan satuan mAs.

Dalam pemberian dosis pada pasien yang berlebihan akan membahayakan jaringan sehat yang lainnya sehingga dapat menimbulkan berbagai. Dosis serap radiasi yang akan diterima oleh pasien dapat diukur. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dengan judul penelitian “**Analisis**

Perbandingan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Dengan Berbagai Tingkatan Umur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Seberapa besar dosis serap radiasi foto thorax yang diterima oleh pasien anak-anak, Remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana komparatif antara dosis serap yang oleh pasien anak-anak, Remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana relasi antara tegangan yang digunakan dengan dosis serap yang diperoleh di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui seberapa besar dosis serap radiasi foto thorax yang diterima oleh pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
2. Dapat mengetahui perbandingan antara dosis serap yang diperoleh oleh pasien anak-anak, Remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) di Instalasi Radiologi

Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

3. Dapat mengetahui hubungan antara tegangan yang digunakan dengan dosis serap yang diperoleh di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengukuran dosis radiasi dilakukan pada pasien hanya pada pemeriksaan thorax dengan empat kategori menurut departemen kesehatan tahun 2009 sampel pasien yaitu anak-anak (usia 0-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (usia 25-45 tahun) dan lanjut usia (usia 46-85 tahun).
2. Teknik penyinaran foto thorax pada setiap sampel dilakukan pada posisi *posterior – anterior* (PA) dan *anterior- posterior* (AP) dengan bagian yang disinari adalah dada.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan kajian pustaka yang berguna bagi akademisi khususnya di bidang Fisika Radiasi dalam lingkup penerimaan dosis serap radiasi pada pemeriksaan foto thorax untuk pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia).

2. Manfaat aplikasi teknik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi nilai dosis kepada pasien maupun masyarakat umum, memberikan masukan yang berguna bagi pelayanan diagnostik di rumah sakit dalam melakukan eksposi pada pemeriksaan *thorax* untuk pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia, sehingga dapat diterima dosis radiasi yang serendah mungkin terhadap pasien, pekerja radiasi dan masyarakat umum. Selain itu dengan data yang diperoleh dimaksudkan dapat dijadikan acuan atau referensi ketika melakukan pemeriksaan pada pasien.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Radiasi dan Penerapannya

Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (foton) dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita, contohnya adalah televisi, lampu penerang, alat pemanas (*microwave oven*), komputer dan lain-lain (Adiwardjo, Dkk, 2010). Dalam fisika kesehatan, radiasi mendeskripsikan setiap proses dimana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Apa yang membuat radiasi adalah bahwa energi memancarkan (yaitu bergerak ke luar dalam garis lurus ke segala arah) dari suatu sumber. Geometri ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlaku untuk semua jenis radiasi.

Radiasi adalah suatu fenomena/peristiwa penyebaran energi gelombang elektromagnetik atau partikel subatom melalui vakum atau media material. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau pun tidak ada medium, dalam rentang frekuensi yang luas. Radiasi terdiri dari beberapa jenis, dan setiap jenis radiasi tersebut memiliki panjang gelombang masing-masing (Arief, 2015, h: 1-3). Pada gambar (2.1) merupakan spektrum elektromagnetik dari energi yang terendah sampai energi yang tertinggi, dapat diuraikan sebagai berikut:

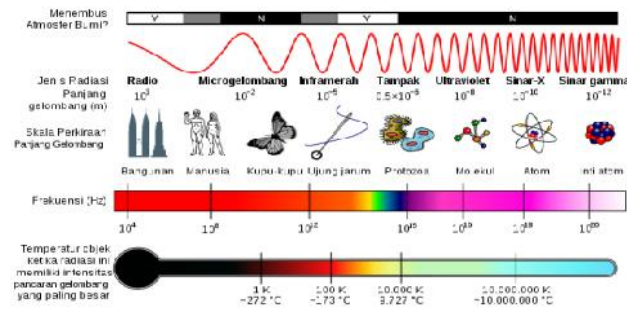

Gambar 2.1. Spektrum Gelombang Elektromagnetik
(Sumber: Arif, 2015)

Radiasi merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber energi kelingkungannya tanpa membutuhkan medium atau bahan penghantar tertentu. Radiasi nuklir memiliki sifat yang khas, diantaranya adalah:

- Tidak dapat dirasakan secara langsung dan
- Dapat menembus berbagai jenis bahan.

Radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Jika suatu inti tidak stabil, maka inti mempunyai kelebihan energi. Inti itu tidak dapat bertahan, suatu saat inti akan melepaskan kelebihan energi tersebut dan mungkin melepaskan satu atau dua atau lebih partikel atau gelombang sekaligus. Setiap inti yang tidak stabil akan mengeluarkan energi atau partikel radiasi yang berbeda. Pada sebagian besar kasus, inti melepaskan energi elektromagnetik yang disebut radiasi gamma, yang dalam banyak hal mirip dengan sinar X (Anonim, 2016).

Berdasarkan tingkat energi yang dimiliki, radiasi dapat dibedakan atas radiasi non pengion dan pengion. Radiasi non pengion yang berupa gelombang

elektromagnetik adalah radiasi dengan energi yang tidak cukup untuk menyebabkan terjadinya ionisasi pada materi yang dilintasinya. Sedangkan radiasi pengion yang dapat berupa partikel dan gelombang elektromagnetik merupakan radiasi dengan energi yang besar sehingga mampu untuk melakukan ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilintasinya (Alatas, Dkk, 2015).

Menurut Ferry Suyatno (2008), radiasi sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan gelombang pendek. Gelombang elektromagnetik banyak jenisnya antara lain sinar lampu, ultra violet, infra merah, gelombang radio dan TV. Sinar X mempunyai daya tembus yang cukup tinggi terhadap bahan yang dilaluinya. Dengan demikian sinar X dapat dimanfaatkan sebagai alat diagnosis dan terapi di bidang kedokteran nuklir. Perangkat sinar X untuk diagnosis disebut dengan photo rontgen


2.2 Interaksi Radiasi dengan Materi Fisik

Berkurangnya energi dari sinar X pada saat melewati suatu materi fisik terjadi karena tiga proses utama, yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton dan produksi pasangan.

1. Efek fotolistrik

Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari dengan cahaya (foton) dalam ruang hampa atau merupakan suatu interaksi sebuah foton dan elektron yang terikat kuat dimana energinya sama atau lebih kecil dari energi foton. Elektron yang keluar dari permukaan logam tersebut disebut fotoelektron. Efek fotolistrik terjadi pada foton

berenergi rendah yaitu antara energi 0,01 MeV hingga 0,5 MeV. Proses terjadinya efek fotolistrik ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut (Nayiroh, 2014):

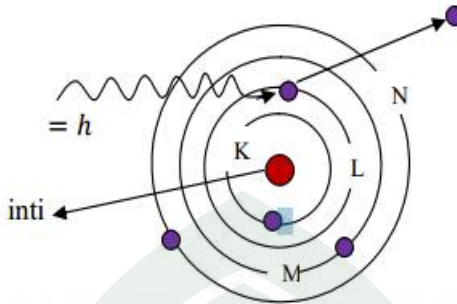

Gambar 2.2 Proses efek fotolistrik
(Sumber:Gusmavita, 2011)

Menurut Nayiroh (2014) fakta-fakta yang terjadi pada efek fotolistrik:


- Laju pemancaran elektron bergantung pada intensitas cahaya.
- Laju pemancaran elektron tak bergantung pada panjang gelombang cahaya di bawah suatu panjang gelombang tertentu.
- Nilai panjang gelombang (λ) tidak bergantung pada intensitas sumber cahaya, tetapi hanya bergantung pada jenis logam yang digunakan sebagai permukaan fotosensitif.
- Energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan tidak bergantung pada intensitas cahaya, tetapi hanyalah bergantung pada panjang gelombangnya, energi kinetik ini didapati bertambah secara linear terhadap frekuensi sumber cahaya.
- Apabila sumber cahaya dinyalakan, arus segera akan mengalir (dalam selang waktu 10^{-9} s).

Menurut Nayiroh(2014) sedangkan sifat karakteristik pada proses efek Fotolistrik:

- a. Hanya cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logam yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik (yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat).
- b. Penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan penambahan jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam (yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar).
- c. Arus listrik terdeteksi dengan segera pada rangkaian kawat setelah cahaya yang sesuai disinari pada pelat logam.

2. Hamburan Compton

Hamburan Compton merupakan interaksi antara foton dan elektron bebas atau hampir bebas yaitu yang berada pada kulit terluar dari atom. Energi radiasi hanya sebagian saja diserap untuk mengeluarkan elektron dari atom (foto-elektron) sedangkan sisa energi akan terpancar sebagai “*scattered radiation*” atau hamburan radiasi dengan energi yang lebih rendah daripada energi semula. Efek Compton terjadi pada elektron-elektron yang terikat secara lemah pada lapisan kulit terluar pada penyinaran dengan energi radiasi yang lebih tinggi yaitu berkisar antara 200-1000 KeV (Gusmavita, 2011). Berikut ilustrasi terjadinya hamburan Compton.

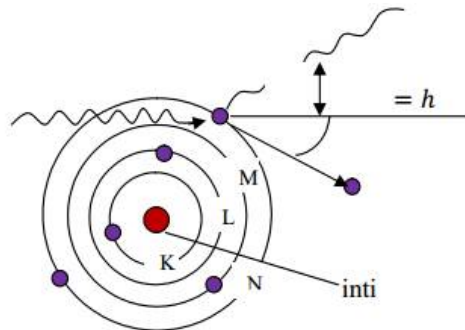

Gambar 2.3 Proses hamburan Compton
(Sumber: Gusmavita, 2011)

3. Produksi pasangan

Pembentukan sepasang elektron (*Pair Production*) atau produksi pasangan yaitu proses pembentukan positron dan elektron melalui energi radiasi sinar gamma yang melebihi 1,02 MeV yaitu energi massa positron dan elektron. Proses ini terjadi apabila radiasi dengan energi yang sangat tinggi mendekati atau memasuki medan listrik atom/inti. Ini sesuai dengan teori Einstein yang menyatakan bahwa energi ekuivalen dengan massa yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E = mc^2 \quad (2.1)$$

Keterangan: E = Energi (J)


m = Massa elektron ($m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg)

c = Kecepatan cahaya ($c = 3 \times 10^8$ m/s)

Proses terjadinya positron dan elektron (menjadi 2 sinar γ) masing-masing dengan energi 0,51 MeV dinamakan proses *Annihilasi*. Setelah kehilangan energi karena ionisasi sepanjang perjalanannya, positron dapat bergabung dengan sebuah

elektron dan lenyap bersama-sama dalam bentuk energi yang lain (Gabriel, 1996).

Seperti yang digambarkan dalam gambar 2.4 berikut ini:

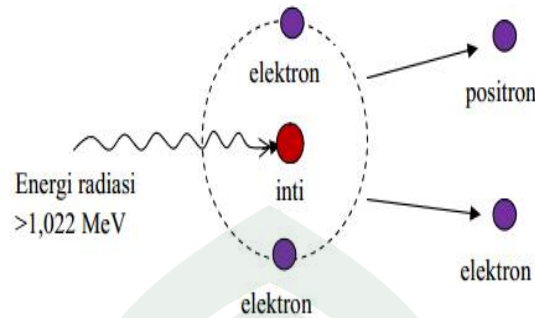

Gambar 2.4 Proses produksi pasangan

(Sumber: <http://www.google.image.com>)

2.3 Besaran dan Satuan Radiasi

Satuan radiasi ada beberapa macam. Satuan radiasi ini tergantung pada kriteria penggunaannya, yaitu:

1. Satuan untuk paparan radiasi

Paparan radiasi dinyatakan dengan satuan *Rontgen* atau sering disingkat dengan R adalah suatu satuan yang menunjukkan besarnya intensitas sinar X atau sinar gamma yang dapat menghasilkan ionisasi diudara dalam jumlah tertentu.

2. Satuan dosis absorpsi medium

Untuk mengetahui banyaknya radiasi yang terserap oleh suatu medium digunakan satuan dosis radiasi terserap atau *Radiation Absorbed Dose* yang disingkat Rad. Jadi dosis absorpsi merupakan ukuran banyaknya energi yang diberikan oleh radiasi pengion kepada medium. Dalam satuan SI, satuan dosis radiasi serap disebut dengan Gray yang disingkat Gy. Dalam hal ini 1 Gy sama

dengan energi yang diberikan kepada medium sebesar 1 J/kg. Dengan demikian maka:

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ Rad}$$

Sedangkan hubungan antara Rontgen dengan Gray adalah:

$$1 \text{ R} = 0,00869 \text{ Gy}$$

3. Satuan dosis ekuivalen

Satuan untuk dosis ekuivalen lebih banyak digunakan berkaitan dengan pengaruh radiasi terhadap tubuh manusia atau sistem biologis lainnya. Dosis ekuivalen ini semula berasal dari pengertian *Rontgen equivalent of man* atau disingkat dengan Rem yang kemudian menjadi nama satuan untuk dosis *ekuivalen*.

Hubungan antara dosis ekuivalen dengan dosis absorpsi dan *quality faktor* adalah:

$$\text{Dosis ekuivalen (Rem)} = \text{Dosis serap (Rad)} \times Q \quad (2.2)$$

Sedangkan dalam satuan SI, dosis ekuivalen mempunyai satuan Sievert yang disingkat dengan Sv. Hubungan antara Sievert dengan Gray dan Quality adalah:

$$\text{Dosis ekuivalen (Sv)} = \text{Dosis serap (Gy)} \times Q \quad (2.3)$$

Berdasarkan perhitungan:

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ Rad}, \text{ maka } 1 \text{ Sv} = 100 \text{ Rem} \text{ (Arief, 2015)}$$

2.4 Sinar X


Sinar X merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik, dipancarkan akibat pengeboman anoda wolfram oleh elektron-elektron bebas dari suatu katoda. Film polos dihasilkan oleh pergerakan elektron-elektron tersebut melintasi pasien dan menampilkan film radiografik.

Pada dasarnya sinar X merupakan pancaran berkas elektron dari katoda menuju anoda yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Sinar X mempunyai panjang gelombang 0,01 nm-10 nm, sehingga sinar X mempunyai daya tembus yang sangat besar. Sinar X dapat terjadi jika terdapat perbedaan potensial arus searah yang besar di antara kedua elektroda (katoda dan anoda) dalam sebuah tabung hampa udara (Febriani, 2013). Menurut Wihono (1986:6.28), sinar X adalah foton-foton yang mempunyai energi tinggi yang dihasilkan dengan menembaki suatu sasaran dengan elektron yang berenergi tinggi.

Sejak ditemukan sinar X lebih dari 100 tahun yang lalu oleh Wilhelm Conrad Roentgen dan dikenalnya sifat radioaktivitas oleh Marie Curie dan Henri Becquerel. Sinar X merupakan salah satu bentuk dari radiasi ionisasi buatan. Penggunaan radiasi sebagai modalitas pengobatan penyakit kanker telah berkembang dengan pesatnya. Perkembangan ini ditopang oleh majunya teknologi dewasa ini dan makin berkembangnya ilmu dasar terutama dibidang biologi molekuler. Aplikasi radiasi pada pengobatan penyakit kanker berlandaskan pada aspek-aspek onkologi saat ini lebih diterima dengan terminologi radiasi onkologi (*radiation Oncology*).

Pembangkit sinar X berupa tabung hampa udara yang di dalamnya terdapat filamen yang juga sebagai katoda dan terdapat komponen anoda. Jika filamen dipanaskan maka akan keluar elektron dan apabila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang tinggi, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Dengan percepatan elektron tersebut maka akan terjadi tumbukan tak kenyal sempurna antara elektron dengan anoda, akibatnya terjadi pancaran radiasi sinar X (Susworo, 2006).

Arus listrik yang digunakan untuk memanaskan filamen sehingga filamen dapat memanaskan elektron dapat memberi elektron. Elektron-elektron ini akan dapat dipercepat dari katoda ke anoda. Perbedaan tegangan antara katoda dan anoda dalam orde 20 KeV sampai 100 KeV. Dalam praktek klinik biasanya digunakan 80-90 KeV. Sinar-X dan sinar Gamma mempunyai sifat yang sama oleh karena keduanya merupakan gelombang elektromagnetik (Hani, 2010). Berikut medel tabung sinar X yaitu:

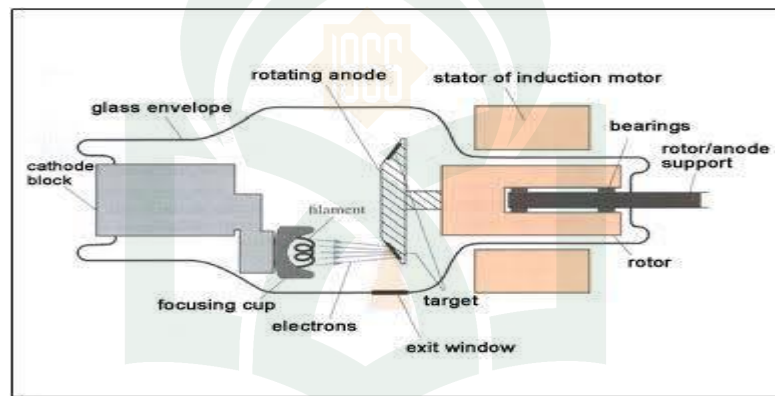

Gambar 2.5 Tabung pesawat sinar X
(Sumber: <http://www.google.image.com>)

Seorang ilmuwan bernama Wilhem Roentgen pada tahun 1895 mendapatkan bahwa radiasi yang kemampuannya untuk menembus besar yang sifatnya belum diketahui (yang disebut dengan sinar X) ditimbulkan jika elektron cepat menumbuk materi. Sekarang ini telah diketahui sifat-sifat sinar X yaitu (Humaidi, 2005):

1. Tidak kelihatan dan mempunyai daya tembus yang besar. Jika dikaitkan dengan panjang gelombang maka sinar X mempunyai panjang gelombang yang kecil atau berfrekuensi besar.
2. Merambat menurut garis lurus.


3. Tidak bermuatan sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet.
4. Merupakan gelombang elektromagnetik transversal.
5. Dapat menghitamkan pelat fotografis/film foto.
6. Refraksi, difraksi, refleksi, dan polarisasi sama seperti pada sinar biasa.
7. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya.
8. Dapat merusak jaringan hidup atau sel.

Menurut Rudi, Pratiwi dan Susilo (2012) ada beberapa sifat sinar X menurut Beiser:

1. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang $0,0210 \text{ \AA}$ sehingga termasuk gelombang di luar daerah cahaya tampak.
2. Seperti gelombang elektromagnetik lainnya, sinar X dapat merambat seperti halnya laju cahaya.
3. Sinar X tidak dapat dibelokkan oleh lensa atau prisma, namun dapat dihamburkan oleh kristal.
4. Sinar X juga mengalami serapan selama proses transmisi di dalam bahan sehingga daya tembus sinar X bergantung pada jenis materi dan energinya.

Dalam arti fisis maupun kiasan, cahaya memegang peran penting bagi manusia. Dalam arti fisis, cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, infra merah, ultra violet, sinar X dan sinar gamma. Menurut kementerian Agama R.I, 2009, h: 354 Dalam al-Qur'an telah

dijelaskan tentang cahaya yang tidak tampak atau cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata yaitu berada Q.S An-Nur: 35 yang berbunyi:

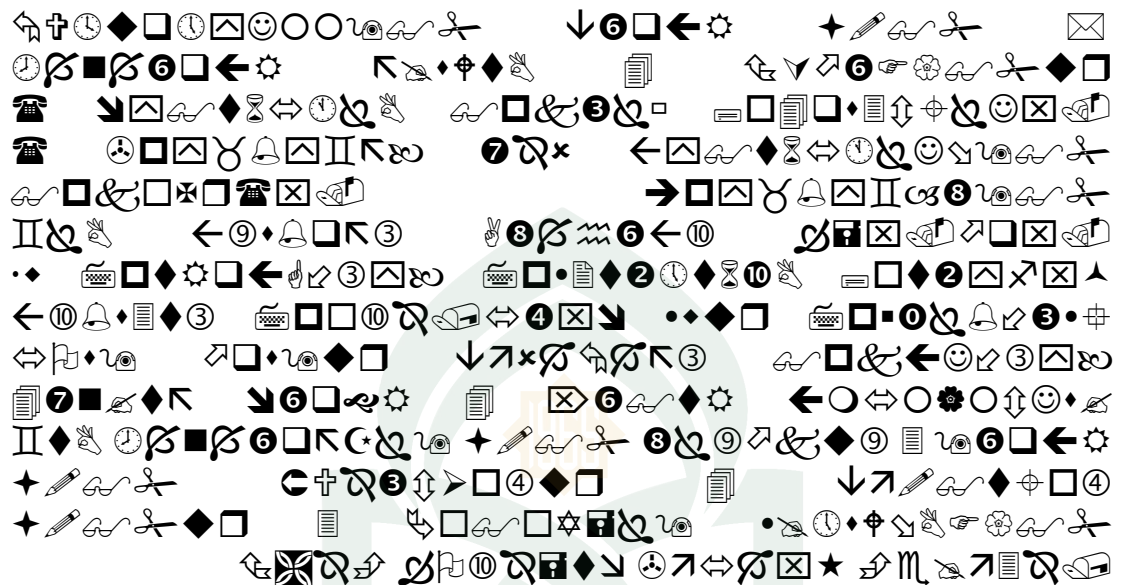

TerjemahNya:

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu(Q.S. Nur:35).

Penjelasan ayat di atas yaitu ayat ini dapat dihubungkan dengan akhir ayat yang lalu yang menjelaskan bahwa Allah swt menurunkan ayat-ayat yang demikian jelas serta menjelaskan segala tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi manusia. Ayat ini menjelaskan: Diturunkannya oleh Allah swt

ayat-ayat yang berfungsi seperti dikemukakan itu disebabkan karena Allah swt adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala maupun non material berupa cahaya kebenaran, ayat-ayat yang berfungsi seperti dikemukakan itu disebabkan karena Allah swt adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala maupun non material berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan dan lain-lain yang dirasakan dengan mata hati. Maha Kuasa Allah dalam segala firman-Nya. Sungguh indah apa yang telah Allah tegaskan dalam ayat-Nya bahwasanya Allah-lah Maha Cahaya itu. Dalam surah diatas juga menyatakan bahwa “cahaya diatas cahaya” yang dapat merujuk pada pengertian frekuensi getaran energi foton yang berlapis-lapis yang oleh ilmu fisika ditangkap dan digambarkan dalam spektrum cahaya.

Dalam surat di atas juga dinyatakan bahwa Allah swt membimbing kepada “cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Allah swt membuat perumpamaan-perumpamaan” makna cahaya dalam konteks ini adalah petunjuk.

Secara teori, gelombang cahaya merambat dengan rambatan lurus tanpa memerlukan medium. Ternyata perumpamaan ini bersifat indrawi dan tidak nyata dan memaparkannya bagi manusia untuk memudahkan mereka memahami hal-hal yang abstrak. Perumpamaan ini sangat sinkron dengan apa yang Allah swt ungkapkan dalam firman di atas, yakni petunjuk yang disampaikan oleh Allah swt kepada seorang hamba adalah seperti cahaya yang merambat lurus. Allah swt tidak membutuhkan perantara, perumpamaan petunjuk sangat cocok dengan cahaya karena

cahaya tidak butuh medium untuk merambat dan Allah swt maha mengetahui segala sesuatu termasuk mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk-petunjuk-Nya (Shihab, 2002: h:548-549).

Menurut Rasad (2005) proses terjadinya sinar X dari tabung Rontgen adalah sebagai berikut:


1. Katoda (filamen) dipanaskan (lebih dari 20000 °C) sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator.
2. Karena panas, elektron-elektron dari katoda (filamen) terlepas.
3. Sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan ke alat pemusat (*focusing cup*).
4. Filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran (target) dengan memilih potensial tinggi.
5. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran (target) sehingga terbentuk panas (<99 %) dan sinar X (<1%).
6. Pelindung (perisai) timah akan mencegah keluarnya sinar X dari tabung, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela.
7. Panas yang tinggi pada sasaran (target) akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator pendingin.

Berdasarkan proses terjadinya, maka sinar X dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sinar X Bremsstrahlung

Sinar X Bremsstrahlung adalah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman. Elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam kecepatan tinggi, apabila melintas dekat ke inti suatu atom, maka gaya tarik elektrostatik dalam atom yang kuat akan menyebabkan elektron membelok dengan tajam (Badiklat BAPETEN, 2013).


Sinar X yang digunakan dalam penyinaran medis adalah sinar X bremsstrahlung. Sinar ini dapat dihasilkan melalui pesawat sinar X atau pemercepat zarah yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu tabung sinar X, sumber tegangan tinggi dan unit pengatur. Terjadi radiasi yang dikenal dengan "*bremstrahlung*" yaitu elektron yang mendekati atom target (anoda) akan berinteraksi dengan inti atom bahan anoda, maka elektron mengalami perlambatan akibat adanya gaya tarik elektrostatik antara elektron dengan inti atom sehingga mengeluarkan radiasi dan bersifat kontinyu (Sofiana, Noor dan Normahayu, 2015). Sinar X yang dihasilkan akibat perlambatan berkas elektron cepat dalam medan magnet atom anoda yang disebut sinar X kontinyu atau sinar X bremsstrahlung yang mempunyai spektrum kontinyu (Maryanto, Solichin dan Abidin, 2008). Berikut ilustrasi terjadinya proses sinar-X *Bremsstrahlung* :

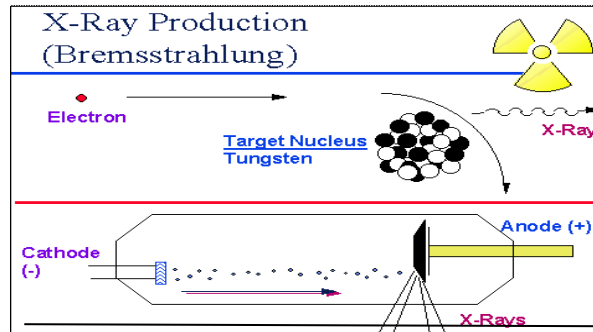

Gambar 2.6 Produksi sinar-X *Bremsstrahlung*
(Sumber: [Http://www.google.image.com](http://www.google.image.com))

2. Sinar-X Karakteristik

Sinar X karakteristik, terjadi akibat tumbukan berkas elektron yang cepat dengan elektron orbit dari atom target, sehingga secara alamiah terjadi proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ketinggian energi yang lebih rendah sembari melepaskan sinar X karakteristik (Badiklat BAPETEN, 2013). Sinar X yang dihasilkan akibat transisi elektron dari orbit tinggi ke orbit rendah dari atom anoda. Transisi elektron ini terjadi akibat adanya kekosongan elektron ditumbuk oleh elektron berkecepatan tinggi (Djoko Maryanto, Solichin dan Zaenal Abidin;2008). Ilustrasi terjadinya sinar X karakteristik seperti ditunjukkan pada gambar 2.7 berikut:

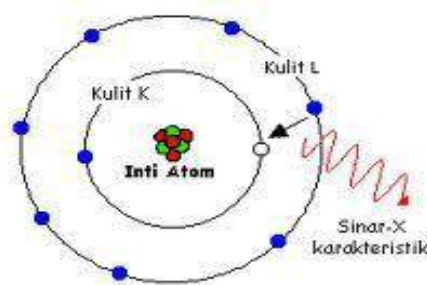

Gambar 2.7 Ilustrasi terjadinya sinar-X karakteristik
(Sumber:<http://www.google.image.com>)

2.5 Pesawat Sinar X

Pesawat sinar X atau pesawat Roentgen adalah suatu alat yang di gunakan untuk melakukan diagnosa medis dengan menggunakan sinar X. Sinar X yang dipancarkan dari tabung inersia di arahkan pada bagian tubuh yang akan di diagnosa. Berkas sinar X tersebut akan menembus dan melewati bagian tubuh kemudian akan ditangkap oleh film, sehingga terbentuk citra dari bagian tubuh yang disinari. Pesawat sinar X terdiri dari sistem dan sub sistem sinar X atau komponen. Sistem sinar X adalah seperangkat komponen untuk menghasilkan radiasi dengan cara terkendali. Sedangkan subsistem berarti setiap kombinasi dari dua atau lebih komponen sistem sinar X (PelatihanUji Kesesuaian Pesawat sinar X, Balai pendidikan dan Pelatihan, badan pengawas tenaga Nuklir, 2013).



Gambar 2.8 Pesawat Sinar X
Sumber: Dokumen pribadi

Pesawat sinar X adalah pesawat yang dipakai untuk memproduksi sinar X. Untuk dapat menghasilkan suatu pencitraan sinar X diperlukan beberapa instrumentasi yang baku sebagai berikut (Suyatno, 2008):

1. Tabung sinar X

Tabung sinar X berisi filament yang juga sebagai katoda dan berisi anoda. Filamen terbuat dari tungsten, sedangkan anoda terbuat dari logam anoda (Cu, Fe atau Ni). Anoda biasanya dibuat berputar supaya permukaannya tidak lekas rusak yang disebabkan tumbukan elektron.

2. Trafo Tegangan Tinggi

Trafo tegangan tinggi berfungsi pelipat tegangan rendah dari sumber menjadi tegangan tinggi antara 30 kV sampai 100 kV. Pada trafo tegangan tinggi diberi minyak sebagai media pendingin. Trafo tegangan tinggi berfungsi untuk mempercepat elektron di dalam tabung.

3. Instrumentasi kontrol/Kolimator

Sistem kontrol berfungsi sebagai pengatur parameter pada pengoperasian pesawat sinar X. Instrumentasi kontrol terbagi menjadi lima modul yaitu:

- a. modul *power supplay* (catu daya DC)
- b. modul pengatur tegangan (kV)
- c. modul pengatur arus (mA)
- d. modul pengatur waktu pencitraan (S)
- e. modul kendali sistem
- f. catu daya AC dari sumber PLN.

Pesawat sinar X mempunyai sejumlah komponen yang menata kembali, mengendalikan dan menyimpan energi listrik sebelum digunakan ke tabung sinar X. Komponen-komponen tersebut secara kolektif dinyatakan sebagai catu daya atau pembangkit (generator). Fungsi utama dari generator adalah untuk menjadikan operator dapat mengendalikan 3(tiga) parameter kuantifikasi yaitu tegangan tabung (kV), arus tabung (mA) dan waktu paparan(s). Generator memiliki fungsi sebagai berikut(PelatihanUji Kesesuaian Pesawat sinar X, Balai Pendidikan dan Pelatihan, badan pengawas tenaga Nuklir; 2013):

1. Menaikkan tegangan listrik (menghasilkan kV)
2. Mengkonversi arus listrik bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC)
3. Mengubah bentukgelombang (filter)
4. Menyimpan energi (untuk pesawat sinar X mobile)
5. Mengendalikan tegangan tabung (kilovoltage-kV)
6. Mengendalikan arus tabung (miliampere-mA)
7. Mengendalikan waktu paparan (*exposure time*).

2.6 Pemeriksaan Thorax

Foto thorax atau sering disebut chest x-ray (CXR) adalah suatu proyeksi radiografi dari thorax untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur-struktur di dekatnya. Foto thorax menggunakan radiasi terionisasi dalam bentuk x-ray.

Foto thorax digunakan untuk mendiagnosis banyak kondisi yang melibatkan dinding thorax, tulang thorax dan struktur yang berada di dalam kavitas thorax

termasuk paru-paru, jantung dan saluran-saluran yang besar. Pneumonia dan gagal jantung kongestif sering terdiagnosis oleh foto thorax. CXR sering digunakan untuk skrining penyakit paru yang terkait dengan pekerjaan di industri-industri seperti pertambangan dimana para pekerja terpapar oleh debu (Anonim, 2016)

1. Anatomi dan fungsi thorax

Toraks adalah daerah pada tubuh manusia (atau hewan) yang berada di antara leher dan perut (abdomen). *Thorax* merupakan rongga yang berbentuk kerucut, pada bagian bawah lebih besar dari pada bagian atas dan pada bagian belakang lebih panjang dari pada bagian depan serta tersusun dari tulang dada, ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Rongga dada berisi paru-paru dan *mediastinum*. *Mediastinum* adalah rongga yang terletak diantara dua kantung *pleura* adalah lapisan pembungkus paru.

Di dalam rongga dada terdapat beberapa sistem diantaranya yaitu sistem pernafasan dan peredaran darah. Organ pernafasan yang terletak dalam rongga dada yaitu *esofagus* dan paru, sedangkan pada sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah dan saluran limfa. Pembuluh darah pada sistem peredaran darah terdiri dari arteri yang membawa darah dari jantung, vena yang membawa darah ke jantung dan kapiler yang merupakan jalan lalu lintas makanan dan bahan buangan (Widayati, 2013).



Gambar 2.9 Anatomi *thorax* pada manusia
(Sumber: <http://www.google.image.com>)

2. Teknik radiografi *thorax*

Cara pengambilan foto *thorax* tergantung dari usia pasien. Untuk pasien dengan umur 0-5 tahun, biasanya dilakukan dengan pengambilan *supine AP*, sedangkan untuk anak dengan usia lebih dari lima tahun, dilakukan pengambilan foto dengan posisi *up right PA*.

a. *Posterior-anterior* (PA)


- a. Pasien diposisikan berdiri tegak menghadap *bucky stand* (kaset vertikal), Linea Midsternalis sejajar garis tengah kaset.
- b. Kedua punggung tangannya diletakkan di atas panggul dan siku ditekan ke depan.
- c. FFD 150 cm
- d. Eksposi pada saat pasien tahan nafas setelah inspirasi penuh, berikan aba-aba untuk tarik napas (Firmansyah, 2010).



Gambar 2.10 Posisi pasien PA
(Sumber:<http://www.google.image.com>)

b. *Anterior-posterior (AP)*

Pada posisi AP sumber sinar X berkebalikan dengan PA. Posisi AP lebih sulit diinterpretasi dibandingkan dengan posisi PA. Posisi ini digunakan pada pasien yang tidak bisa bangun dari tempat tidur atau pada bayi. Pada situasi seperti ini, pasien diposisikan setengah duduk atau *supine* di atas meja pemeriksaan/*brandcare*, kedua lengan lurus disamping tubuh, kaset di belakang tubuh dengan jarak fokus film keobjek sebesar 100 cm (Widayati,2013).

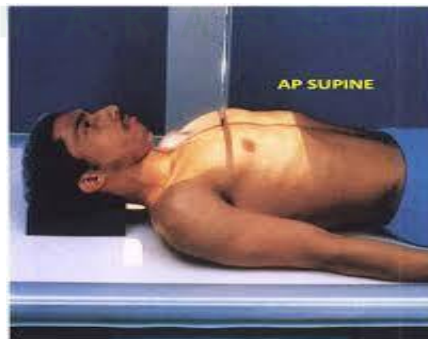

Gambar 2.11 Posisi pasien AP
(Sumber:<http://www.google.image.com>)

2.7 Faktor-faktor pembentukan gambar radiografi (Faktor Ekspose)

Pembentukan gambar pada peristiwa pencitraan pesawat sinar X tergantung dari beberapa faktor berikut ini (Febriani, 2013):

1. Pengaruh arus tabung (mA)

Arus tabung berasal dari pemanasan filamen, jika pemanasan filamen ditingkatkan maka arus dalam tabung sinar X juga meningkat. Semua intensitas sinar X atau derajat terang (*brightness*) akan bertambah sesuai dengan peningkatan intensitas radiasi sinar X dititik fokus. Arus tabung menentukan jumlah elektron yang akan melewati target (anoda) sehingga dihasilkan sinar X yang mempunyai intensitas dan energi yang cukup untuk menembus organ tertentu.

2. Pengaruh tegangan (kV)

Tegangan tabung berpengaruh pada kualitas radiasi atau daya tembus sinar X yang dihasilkan. Dengan demikian juga akan berpengaruh pada pembentukan gambar, karena dengan perubahan kV akan menyebabkan perubahan total pada intensitas berkas sinar X.

3. Pengaruh jarak (Cm)

Dalam proses pemotretan sinar X, terdapat pengaturan jarak yang dikenal dengan istilah FFD (*Focus Film Distance*) yang merupakan jarak fokus tabung sinar X dengan permukaan film; semakin kecil nilai FFD maka densitas film akan semakin meningkat karena intensitas sinar X yang meningkat pula. Pengaturan jarak dapat dilakukan dengan menggerakkan *stand* tabung menjauhi

atau mendekati obyek sehingga akan mempengaruhi intensitas berkas sinar X yang selanjutnya akan berpengaruh pula pada pembentukan gambar radiografi.

4. Pengaruh waktu (s)

Waktu eksposi akan menentukan lamanya penyinaran yang dilakukan. Menaikkan waktu eksposi berarti menambah jumlah radiasi yang mencapai objek dan film.

Menurut Sjahriar Rasad (2005), bahwa Faktor ekspose sangat bervariasi tergantung pada berbagai hal, antara lain:

- a. Ukuran/tebal objek atau pasien yang difoto
- b. Kelainan patologis yang akan diperiksa, pemotretan dengan atau tanpa grid
- c. Pada objek yang selalu bergerak, organ yang pergerakannya tidak dapat dikontrol, anak kecil dan lain-lain, untuk hal ini yang perlu diperhatikan waktu ekspose yang sesingkat mungkin.

Faktor-faktor ekspose yang lain yaitu:

1. Besaran kilovoltage (kV)

Besaran kV pada umumnya dikaitkan dengan daya tembus sinar, makin tinggi besaran kV yang digunakan makin besar pula daya tembus sinar, demikian pula sebaliknya. Umumnya jumlah kV menunjukkan kualitas radiasi. Bila kV dinaikkan, maka densitas foto meninggi, kontras rendah dan sinar hambur meningkat. Pada radiodiagnostik penggunaan kV antara 50-80 kV, setiap kenaikan atau penurunan 10 kV, mAs (*miliampere seconde*) dapat diturunkan atau dinaikkan sekitar 50 %.

2. Miliampere seconde(mAs)

Miliampere seconde(mAs) adalah perkalian antara besaran nilai ampere dengan waktu eksposi. mAs ini menunjukkan kuantitas radiasi. Contoh:

$$\begin{aligned} \text{mAs} &= \text{mA} \times \text{s} \\ &= 100 \times 1/10 \text{ detik} \\ &= 400 \times 1/40 \text{ detik} \\ &= 50 \times 1/5 \text{ detik} \end{aligned}$$

Dengan contoh di atas, mAs dapat diperoleh dengan berbagai cara, sehingga untuk organ yang bergerak yang memerlukan waktu yang singkat dapat menggunakan mA tertentu (Rasad, 2005 :hal: 20-21).

2.8 Identifikasi jenis penyakit yang bisa direkam oleh foto thorax

Jenis penyakit yang dapat direkam melalui foto thorax yaitu: foto thorax normal, infeksi paru, kanker paru, hipertranslusensi paru dan paru kistik, penyakit pleura dan ekstrapleura, lesi kosta, trauma dada, aids paru, torax pediatrik, penyakit jantung, massa mediastinum, lesi diafragma, pneumokoniosis, pendekatan terhadap lesi lokal, reaksi periosteum, trauma ekstremitas, fraktur-klasifikasi, penyatuan dan komplikasi, trauma tulang belakang, trauma wajah dan pelvis, infeksi tulang, foto polos abdomen, akut abdomen, pemeriksaan kontras pada gastrointestinal, abdomen pediatrik, pencitraan traktus urinarus, dan lain-lain (Dwijayanti dan Dharman, 2010)

2.9 Aspek Proteksi Radiasi

1. Efek paparan radiasi terhadap kesehatan

Radioterapi dengan sinar X, sinar gamma atau partikel isotop radioaktif pada hakekatnya tergantung dari pada energi yang diabsorpsi baik secara efek fotoelektrik dan efek Compton yang menimbulkan ionisasi pada jaringan. Dan sebagai akibat ionisasi ini terjadi kelainan atau kerusakan pada sel atau jaringan, akibat dari radiasi pengion ini dinamakan efek biologis (Gabriel, 1996: hal: 295).

2. Proteksi Radiasi

Proteksi radiasi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknik yang membahas tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pemberian perlindungan terhadap seseorang atau sekelompok orang dari kemungkinan akibat negatif dari radiasi pengion (Barsasella, 2010).

Menurut NCRP (*National Council on Radiation Protection*), tujuan dari proteksi radiasi adalah:

- a. Untuk mencegah radiasi klinis yang penting, dengan mengikuti batas dosis minimum
- b. Membatasi resiko terhadap kanker dan efek kelainan turunan pada masyarakat.

Untuk menjamin keselamatan kerja radiasi bagi pekerja radiasi dan masyarakat sekitarnya. Pengusaha Instalasi Nuklir (PIN) dalam melaksanakan setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir harus menerapkan sistem keselamatan radiasi yang meliputi (Maryanto, Solichin dan Abidin, 2008):

- a. Justifikasi: Setiap pemakaian zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya harus didasarkan pada azas manfaat.
- b. Optimasi: Semua penyinaran harus diusahakan serendah-rendahnya *ALARA* (*As Low As Reasonably Achievable*) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial.
- c. Limitasi: Dosis ekivalen yang diterima oleh pekerja radiasi atau masyarakat tidak boleh melampaui nilai batas dosis (NBD) yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Kepala Bapeten No. 01/Ka-BAPETEN/V-99.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh *International Commission on Radiological Protection* (ICRP) untuk menghindari bahaya radiasi maka di tentukan suatu dosis maksimum yang dapat diperkenankan sebagai pedoman dalam proteksi radiasi, yaitu *Maximum Permissible Dose* (MPD). Nilai MPD ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Oleh karena proteksi radiasi tidak saja di tinjau dari sudut efek somatik saja, tetapi juga efek genetik (Hani, 2010).

2.10 Pengukuran Dosis Serap Radiasi

Dosis radiasi adalah jumlah energi radiasi yang diserap kedalam material. Dosis serap merupakan jumlah energi yang diserahkan radiasi atau banyaknya energi yang diserap oleh bahan permassa bahan itu, jadi dosis serap merupakan banyaknya energi yang diberikan oleh radiasi pengion kepada medium (Safitri dan Fitri, 2010)

United States Nuclear Regulatory Commision (NRC) adalah salah satu sumber informasi resmi yang dijadikan standar di beberapa negara untuk penetapan garis pedoman pada proteksi radiasi. NRC telah menyatakan bahwa dosis individu

terpapar radiasi maksimal adalah 0.05 Sv atau 5 rem/tahun. Walaupun NRC adalah badan resmi yang berkenaan dengan batas pencahayaan ionisasi radiasi, namun ada kelompok lain yang juga merekomendasikan hal serupa. Salah satu kelompok tersebut adalah *National Council on Radiation Protection* (NCRP), yang merupakan kelompok ilmuwan pemerintah yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas riset radiasi terbaru dan mengupdaterekomendasi mengenai keamanan radiasi.

Dosis maksimum yang diijinkan adalah jumlah maksimum penyerapan radiasi yang sampai pada seluruh tubuh individu, atau sebagai dosis spesifik pada organ tertentu yang masih dipertimbangkan aman. Aman dalam hal ini berarti tidak adanya bukti bahwa individu mendapatkan dosis maksimal yang telah ditetapkan, dimana cepat atau lambat efek radiasi tersebut dapat membahayakan tubuh secara keseluruhan atau bagian tertentu. Rekomendasi untuk batas atas paparan telah dibentuk pula oleh NCRP sebagai panduan didalam pekerjaan yang berkaitan dengan radiasi. Rekomendasi NCRP meliputi (www.geocities.com/radiologi_vet, 2015, h: 3-4):

- a. Individu/operator tidak diizinkan bekerja dengan radiasi sebelum umur 18 tahun.
- b. Dosis yang efektif pada tiap orang pertahun mestinya tidak melebihi 50 mSv (5 rem).
- c. Untuk khalayak ramai, ekspose radiasi (tidak termasuk dari penggunaan medis) mestinya tidak melebihi 1 mSv (0,1 rem) per tahun.

- d. Untuk pekerja yang hamil, batasan ekspose janin atau embrio mestinya tidak melebihi 0,5 mSv (0,05 rem). Dengan demikian untuk pekerja wanita yang sedang hamil tidak lagi direkomendasikan bekerja sampai kehamilannya selesai.

Dosis untuk pasien harus diminimalkan apabila memungkinkan, dan beberapa tindakan berikut ini dianjurkan (Dwijyanthi dan Dharmawan, 2010):

- a. Lakukan pencitraan pada pasien hanya bila dapat alasan klinis yang baik untuk melakukan prosedur tersebut.
- b. Lakukan pencitraan hanya pada daerah yang diperlukan. Kolimasi yang tepat memperkecil resiko.
- c. Pelindung gonad harus di gunakan pada orang-orang yang berusia reproduktif.
- d. Pencitraan pasien yang hamil harus di hindari bila memungkinkan secara medis. Bila periode haid berakhir telah terlewati, pasien harus diasumsikan sedang hamil.
- e. Pemeriksaan ulang harus diminimalkan dengan melakukan praktik radiografi yang baik.
- f. Perbesar jarak fokus kulit agar menurunkan dosis yang masuk.

Exposure/penyinaran dapat didefinisikan sebagai jumlah energi yang mengalir persatuan waktu melalui satuan luas yang dipancarkan oleh tabung sinar X. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Febriani, 2013):

$$E = \frac{v^2 \cdot i \cdot t}{FFD^2} \quad (2.4)$$

Keterangan: E = *Exposure* (mR)

v = Tegangan tabung (kV)

i = Arus tabung (mA)

t = Lama waktu penyinaran (s)

FFD = Jarak Fokus ke Film (cm)

Dari rumus (2.4) maka dapat diketahui masing-masing besar atau jumlah dosis paparan radiasi yang akan diterima pasien. Karena 1 Roentgen sama dengan 0,877 rad dosis di udara, sehingga untuk mengetahui dosis serap yang diterima oleh pasien yaitu dengan cara mengalikan dosis paparan radiasi dengan 0,877 rad. Dari satuan dosis rad kemudian dikonversi kedalam satuan dosis Gray (Widayati, 2013). Sebelum satuan SI digunakan, dosis serap diberi satuan erg/gr dengan satuankhusus rad (*radiation absorbed dose*) yang dapat menunjukkan jumlah energi radiasi yang dipindahkan ke objek radiasi dengan setiap tipe radiasi ionisasi. 1 Rad sebanding dengan perpindahan energi 100 erg/gr objek radiasi. Berdasarkan keduasatuan dosis serap tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut (Febriani, 2013):

$$1 \text{ milirontgen (mR)} = 10^{-3} \text{ R}$$

$$1 \text{ Rad} = 10^{-2} \text{ J.kg}^{-2} \text{ jaringan}$$

$$= 10^{-2} \text{ Gy atau } 1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

2.11 Rekomendasi Dosis Maksimum Radiasi

Dosis maksimum yang diperkenankan bagi pekerja radiasi berbeda dengan masyarakat umum. Bagi masyarakat tidak lagi memakai MPD (*Maxium Permissible Dose*), akan tetapi diganti dengan *dosis limit* (batas dosis). Maksud dari pemakaian dosis limit ini untuk memperoleh standarisasi dalam pelaksanaan proteksi pada

pemakaian sumber-sumber radiasi sehingga masyarakat tidak mungkin mendapatkan radiasi yang membahayakan. Nilai batas dosis untuk masyarakat ialah 1/10 dari MPD bagi pekerja radiasi.

Pengukuran dosis serap ini telah dilakukan oleh Yuliati dan Kusumawati (2006), dari hasil pengukuran dosis radiasi dengan TLD-100 yang diterima oleh pasien anak yang menjalani pemeriksaan foto *thorax* yaitu berkisar antara 0,0930-0,4040 mGray. Dilanjutkan oleh penelitian Sofyan, *et al* (2009), dimana dosis radiasi yang diterima pasien anak di kota padang sangat bervariasi berdasarkan kelompok usia 0-1 tahun, 1-5 tahun, 5-10 tahun, dan 10-15 tahun diperoleh besarnya dosis radiasi untuk pasien anak masing-masing adalah $0,1260 \pm 0,1500$ mGray, $0,1170 \pm 0,0930$ mGray, $0,1110 \pm 0,0360$ mGray dan $0,1600 \pm 0,1390$ mGray. Kedua penelitian ini relatif lebih besar dari nilai dosis maksimum yang direkomendasikan oleh badan yang berwenang mengatur nilai dosis. Berdasarkan beberapa hasil pengukuran tersebut maka nilai dosis serap yang diterima pasien anak di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Paru Jember masih lebih kecil dibandingkan dengan terimaan dosis di kedua Rumah Sakit tersebut. Meskipun dosis serap yang diterima masing-masing kategori pasien baik laki-laki ataupun wanita untuk setiap penggolongan usia masih dibawah batas maksimum yang diijinkan, dimana untuk pasien usia 1-5 tahun tidak melebihi 0,0300 mGray, 0,0400 mGray untuk usia 5-10 tahun, dan 0,0500 mGray untuk usia 10-15 tahun.

Tabel 2.1 dan 2.2 merupakan perbedaan antara dosis maksimum yang diperkenankan untuk pekerja dan masyarakat yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Dosis maksimum yang diperkenankan bagi pekerja radiasi

Pekerja Radiasi	MPD
Seluruh tubuh, sum-sum tulang dan kelenjar kelamin	5,750 mR dalam 1 tahun atau 3,450 mR dalam 3 bulan. Dosis seluruhnya tidak melebihi 5rem (N-18) rem N=umur
Kulit, tulang dan kelenjar thyroid	34,500 mR dalam 1 tahun
Tangan lengan bagian bawah dan pangkal kaki	86,250 mR dalam 1 tahun
Bagian lain dari tubuh	17,250 mR dalam 1 tahun

(Hani dan Riwidikno, 2007: hal: 199-200).

Tabel II.2 Dosis maksimum yang diperkenankan bagi masyarakat

Masyarakat	MPD
Seluruh tubuh, sum-sum tulang dan kelenjar kelamin	575 mR dalam 1 tahun atau 345 mR dalam 3 bulan.
Kulit, tulang dan kelenjar thyroid	3,450 mR dalam 1 tahun, anak-anak dibawah umur 16 tahun: 1,5 rem
Tangan lengan bagian bawah dan pangkal kaki	86,250 mR dalam 1 tahun
Bagian lain dari tubuh	17,250 mR dalam 1 tahun

(Hani dan Riwidikno, 2007: hal: 199-200).

Tabel 2.3 Rekomendasi dosis maksimum yang diperbolehkan

Bagian tubuh/ Individual	Rata-rata per minggu (mrem)	Rata-rata per minggu (mrem)	Maksimum pertahun (rem)
Pekerja			
Seluruh badan, gonad, organ, pembentuk darah, mata	1	3	5
Kulit seluruh badan	-	10	30
Tangan, lengan, kepala, leher, kaki dan mata kaki	1,5	25	75
Wanita subur	-	-	0,5
Masyarakat Umum			
Seluruh badan	0,1	-	0,5
Pelajar	-	-	0,10
Populasi	-	-	0,17

(Sumber: www.geocities.com/radiologi_vet, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat : Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Hj. A. Sultan Dg
Raja Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan

Waktu Penelitian : 6 Juni-15 Juli 2016

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Satu set pesawat *roentgen* yang terdiri dari tabung sinar-X, *control table*, dan *bucky*.
2. Kaset film
3. Pencuci film otomatis
4. Film
5. Cairan processin film
6. Alat tulis menulis
7. Kamera

3.3 Sampel Penelitian

Menurut Departemen kesehatan umur manusia terdiri beberapa sampel penelitian yaitu:

1. Anak-anak yang berumur 1-11 tahun
2. Remaja yang berumur 12-25 tahun
3. Dewasa yang berumur 26-45 tahun
4. Usia lanjut yang berrumur 46-85 tahun

3.4 Prosedur Kerja

Prosedur kerja untuk penelitian ini yaitu:

1. Melakukan pemilihan sampel pasien berdasarkan umur yaitu anak-anak (1-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26-45 tahun) dan lansia (46-85 tahun)
2. Mempersiapkan alat Rontgen dan perangkat-perangkat pendukung lainnya
3. Mengatur jarak fokus ke film atau objek pada posisi 100 cm
4. Mengatur sinar yang akan digunakan agar tepat mengenai pasien dan mengatur juga jumlah sinar agar sesuai dengan besarnya objek yang akan difoto
5. Mengatur faktor *exposure* atau yang terdiri dari tegangan tabung (kV) dan arus tabung serta lama waktu penyinaran (mAs)
6. Melakukan penyinaran yang dikerjakan oleh petugas (radiografer) dan penyinaran dilakukan dari arah belakang atau di ruang operator
7. Mencatat hasil ekspose berupa tegangan, arus, waktu dan jarak pada tabel pengamatan 3.1

8. Kemudian menghitung atau menganalisis data dengan menggunakan persamaan 2.4
9. Setelah itu hasil yang didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya, kemudian dikonversikan kesatuan dosis serap yaitu mGray (mGy).

3.5 Teknik Analisis Data

Setiap hasil data yang diperoleh dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{v^2 i t}{FFD^2}$$

Keterangan:

E : Dosis paparan radiasi (R)

v : Tegangan tabung (kV)

i : Arus tabung (mA)

t : Waktu penyinaran (s)

FFD: Jarak fokus ke film (Cm)

Selanjutnya dibandingkan sesuai dengan dosis paparan radiasi secara standar untuk masing-masing ketiga kategori sampel yaitu anak-anak (1-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (25-45 tahun) dan lanjut usia (lansia) (46-85 tahun)


Tabel 3.3 Untuk usia dewasa (26- 45 tahun)

No	Usia Responden (tahun)		Dosis Paparan Radiasi (R)		Dosis Absorpsi Medium (rad)		Dosis Serap (mGy)	
	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir
1
2
3
4
5
...

Tabel 3.4 Untuk usia lanjut usia (lansia) 46-85 tahun

No	Usia Responden (tahun)		Dosis Paparan Radiasi (R)		Dosis Absorpsi Medium (rad)		Dosis Serap (mGy)	
	Lansia awal	Lansia akhir	Lansia awal	Lansia akhir	Lansia awal	Lansia akhir	Lansia awal	Lansia akhir
1
2
3
4
5
...

3.7 Diagram Alir Penelitian

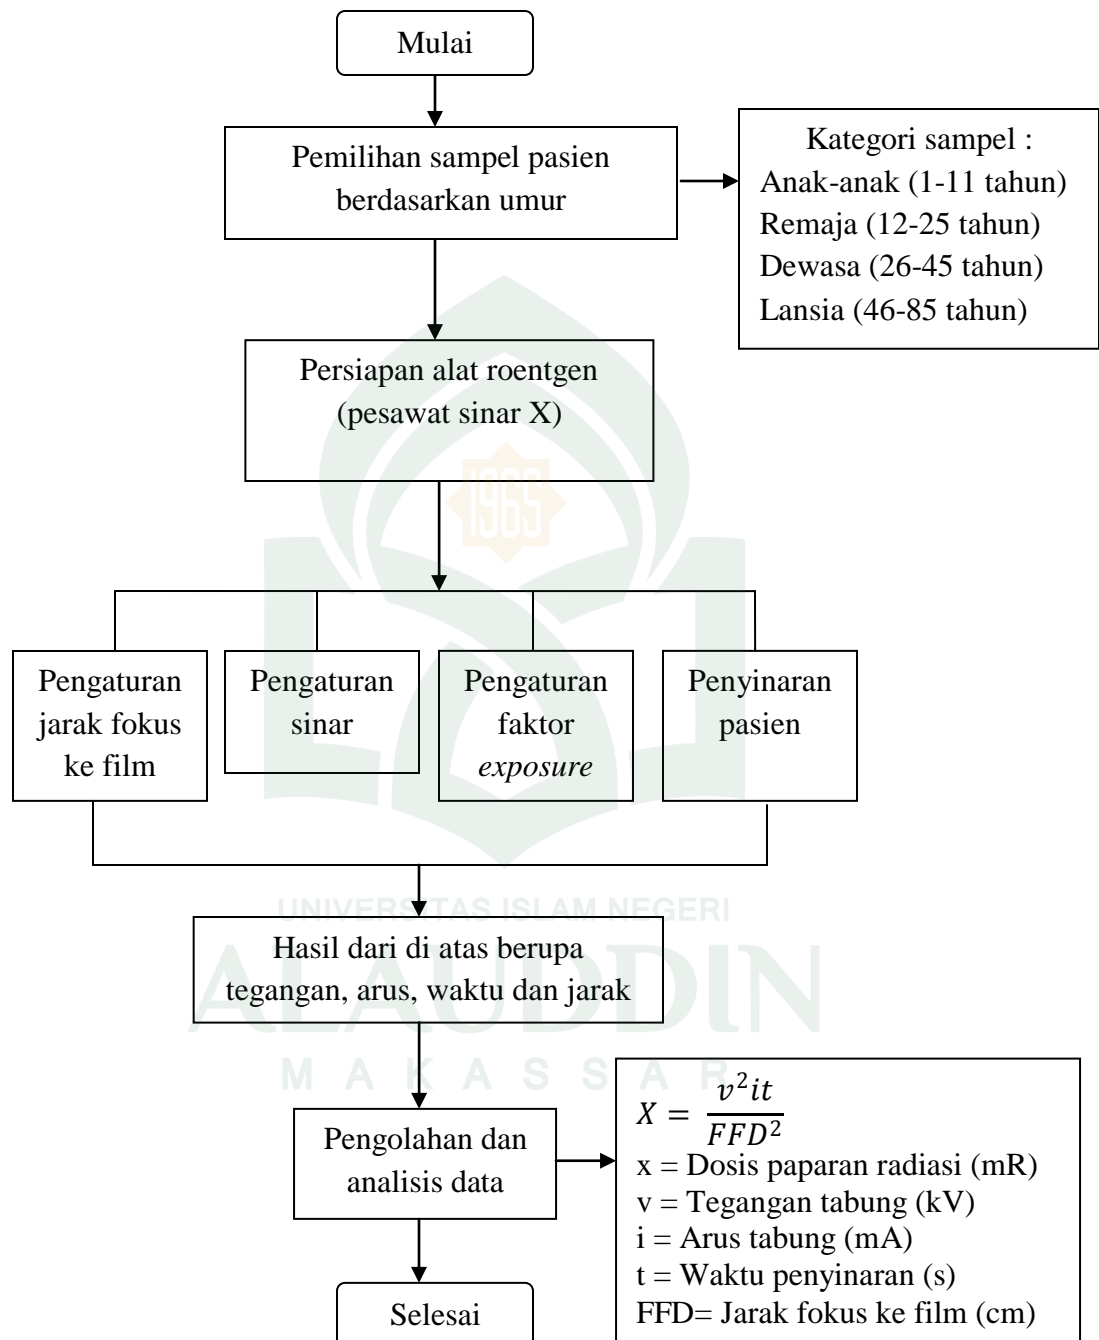

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Hj. A. Sultan Dg Raja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Pada penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh perbandingan dosis serap radiasi foto thorax pada pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel pasien anak-anak yang berumur 1-11 tahun, remaja berumur 12-25 tahun, dewasa berumur 26-45 tahun dan usia lanjut yang berumur 46-85 tahun.

Untuk mengetahui perbandingan disetiap sampel maka nilai dosis paparan radiasi terlebih dahulu harus ditentukan seperti pada persamaan 2.4 yang satuannya terlebih dahulu dikonversikan ke Satuan Internasional (SI) yaitu untuk kV (kilo volt) dikonversikan keV (volt), untuk mA (Milli Ampere) diubah ke A (ampere) dan untuk jarak (cm) diubah ke (m) kemudian diubah ke satuan yang telah ditentukan seperti pada dosis paparan radiasi dikalikan dengan 10^{-3} untuk mendapatkan nilai mR (milli roentgen). Setelah itu, untuk mendapatkan nilai dosis absorpsi mediumnya (rad) dapat diperoleh dengan cara mengalikan dosis paparan radiasi terhadap nilai 0,877 rad. Karena 1 Roentgen sama dengan 0,877 rad dosis di udara, kemudian dikonversikan ke satuan milliGray atau mGy dengan cara mengalikan 10^{-5} .

Selanjutnya pasien dikelompokkan ke dalam tabel penelitian, seperti yang terlihat pada tabel 4.1 untuk dosis serap radiasi pasien anak-anak (1-11 tahun), tabel 4.2 untuk dosis serap radiasi pada pasien remaja (12-25 tahun), tabel 4.3 dosis serap radiasi pada pasien untuk dewasa (26-45 tahun) dan pada tabel 4.3 untuk dosis serap radiasi pada pasien lansia (46-85 tahun).

Dari tabel-tabel tersebut bahwa dengan melalui variasi parameter tegangan (kV) dan arus serta waktu penyinaran (mAs) memberikan nilai dosis serap yang berbeda, dimana penggunaan variasi tegangan (kV) dan arus serta waktu penyinaran (mAs) yang besar menghasilkan nilai dosis serap yang besar pula, tetapi dalam penelitian ini arus (mA) telah ditentukan yaitu sebesar 100 mA.

a. Dosis serap radiasi pada anak-anak (1-11 tahun)


Tabel 4.1 Hasil perhitungan dosis serap untuk anak-anak 1-11 tahun (Dosis serap minimum dan maksimum yang diperbolehkan 0,024-0,404 mGy)

No	Usia Responden (tahun)		Dosis Paparan Radiasi (R)		Dosis Absorpsi Medium		Dosis Serap (mGy)	
	Balita	Kanak-kanak	Balita	Kanak-kanak	Balita	Kanak-kanak	Balita	Kanak-kanak
1	1,5	6	7200000	11197000	6314,4	5867,42	0,063	0,0982
2	2	8	7056000	11094000	6188,11	9729,44	0,062	0,097
3	2,4	9	8427000	10390200	7390,48	9112,21	0,074	0,0911
4	3	11	11636100	15125000	10204,9	13264,63	0,1029	0,133
5	5		11236000		9853,97		0,099	

Dari tabel 4.1 di atas dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien anak-anak memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dimana dosis serap yang diterima oleh pasien anak-anak terbagi menjadi dua kategori yaitu balita dan kanak-kanak. Pada

pasien balita memiliki dosis serap radiasi 0,063 mGy, 0,062 mGy, 0,1025 mGy dan 0,099 mGy.

Dan pada pasien kanak-kanak memiliki dosis serap radiasi 0,0982 mGy, 0,059 mGy, 0,911 mGy dan 0,133mGy, dan telah memenuhi syarat untuk dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien anak-anak sesuai batas maksimal yang telah diijinkan.

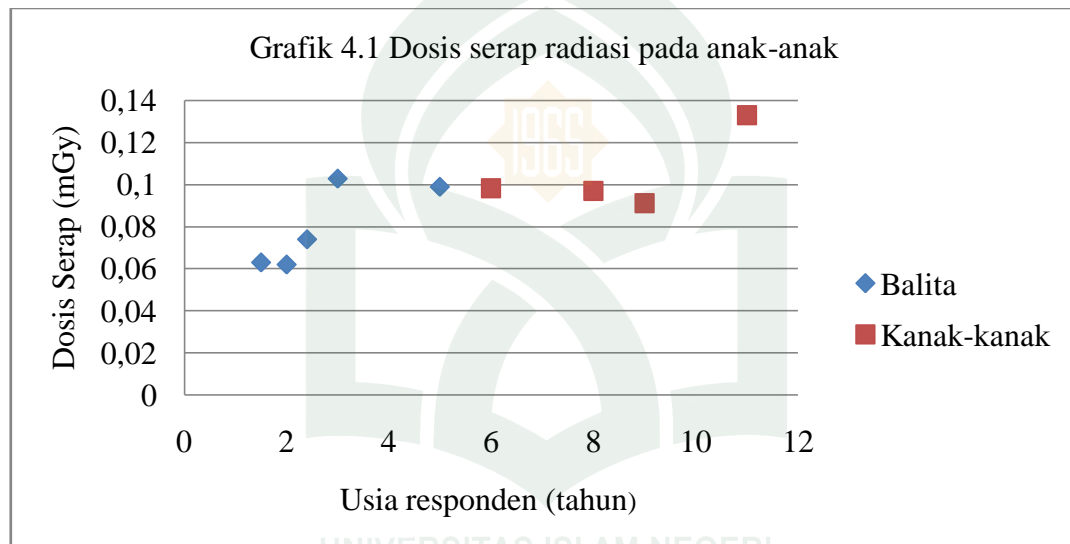

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat ditunjukkan bahwa data-data yang telah diperoleh yaitu pada umur 1,2 tahun, 2 tahun, 2,4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan 11 tahun, menunjukkan bahwa usia responden (dari 1,2 tahun – 11 tahun) tidak berpengaruh terhadap pemberian faktor *exposure*. Jadi faktor usia tidak mempengaruhi terhadap pemberian faktor *eksposure* dalam pemeriksaan radiodiagnostik, karena bertambah pula berat badan atau tebal ukuran badan pasien, maka dosis serap yang diterimanya semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan dosis serap minimum dan maksimum yang diperoleh.


b. Dosis serap radiasi pada orang remaja (12-25 tahun)

Tabel 4.2 Hasil perhitungan dosis serap untuk remaja 12-25 tahun (Dosis serap minimum dan maksimum yang diperbolehkan 0,024-0,0404 mGy)

No	Usia Respondent (tahun)		Dosis Paparan Radiasi (R)		Dosis Absorpsi Medium		Dosis Serap (mGy)	
	Remaja awal	Remaja akhir	Remaja awal	Remaja akhir	Remaja awal	Remaja akhir	Remaja awal	Remaja akhir
1	12	17	8252000	19756800	7236,99	17326,71	0,072	0,173
2	13	18	13140750	21866000	15200,62	19176,46	0,152	0,192
3	14	19	14796800	18000900	12976,79	15786,79	0,129	0,08
4	15	20	6885000	18418733	6038,15	16153,23	0,06	0,108
5	16	21	11236000	13330800	9853,97	11691,11	0,099	0,117
6		22		13330800		11691,11		0,117
7		23		16194150		14202,27		0,142
8		24		19756800		17326,71		0,173
9		25		19057500		16713,43		0,167

Pada tabel 4.2 di atas dosis serap yang diterima oleh pasien remaja memiliki perbedaan yang tidak mencolok seperti pada remaja awal memiliki dosis serap radiasi 0,0722 mGy, 0,152 mGy, 0,129 mGy, 0,060 mGy dan 0,099 mGy.

Pada remaja akhir dosis serap radiasi yang diterima yaitu 0,173 mGy, 0,192 mGy, 0,080 mGy, 0,108 mGy, 0,117 mGy, 0,117 mGy, 0,142 mGy, 0,173 mGy dan 0,167 mGy dan telah memenuhi syarat untuk dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien dewasa sesuai batas maksimal yang telah diijinkan.

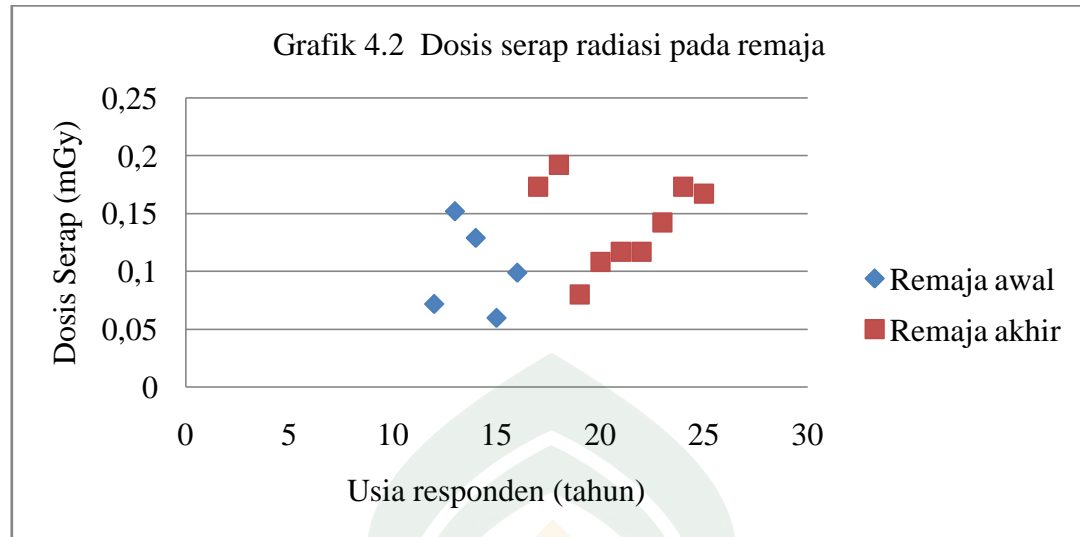

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat ditunjukkan bahwa data-data yang telah diperoleh yaitu pada umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun dan 25 tahun, menunjukkan bahwa usia responden (dari 12 tahun – 25 tahun) tidak berpengaruh terhadap pemberian faktor *exposure*. Jadi faktor usia tidak mempengaruhi terhadap pemberian faktor *eksposure* dalam pemeriksaan radiodiagnostik, karena bertambah pula berat badan atau tebal ukuran badan pasien, maka dosis serap yang diterimanya semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan dosis serap minimum dan maksimum yang diperoleh.


c. Dosis serap radiasi pada pasien dewasa (26-45 tahun)

Tabel 4.3 Hasil perhitungan dosis serap radiasi untuk dewasa 26-45 tahun (dosis serap minimum dan maksimum (0,07-2,37))

No	Usia Responden (tahun)		Dosis Paparan Radiasi (R)		Dosis Absorpsi Medium (rad)		Dosis Serap (mGy)	
	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir	Dewasa awal	Dewasa akhir
1	28	36	16900000	21193200	14821,3	18586,44	0,148	0,186
2	29	38	14580000	19756800	12786,66	17326,71	0,128	0,173
3	31	39	15680000	18418733,3	13751,36	16153,23	0,138	0,162
4	32	40	13812500	17768400	12113,57	15539,94	0,133	0,156
5	33	41	15680000	13623750	13751,36	11948,03	0,138	0,119
6	34	42	11822500	15125000	10368,34	13264,63	0,104	0,133
7	35	45	19812500	16335566,7	17375,57	9807,55	0,174	0,098

Pada tabel 4.3 di atas dosis serap yang diterima oleh pasien remaja memiliki perbedaan yang tidak mencolok seperti pada dewasa awal yang memiliki dosis serap 0,148 mGy, 0,128 mGy, 0,138 mGy, 0,133 mGy, 0,104 mGy dan 0,174 mGy.

Pada dewasa akhir dosis serap yang diterima yaitu 0,186 mGy, 0,173 mGy, 0,162 mGy, 0,156 mGy, 0,119 mGy, 0,133 mGy dan 0,098 mGy dan telah memenuhi syarat untuk dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien dewasa sesuai batas maksimal yang telah diijinkan.

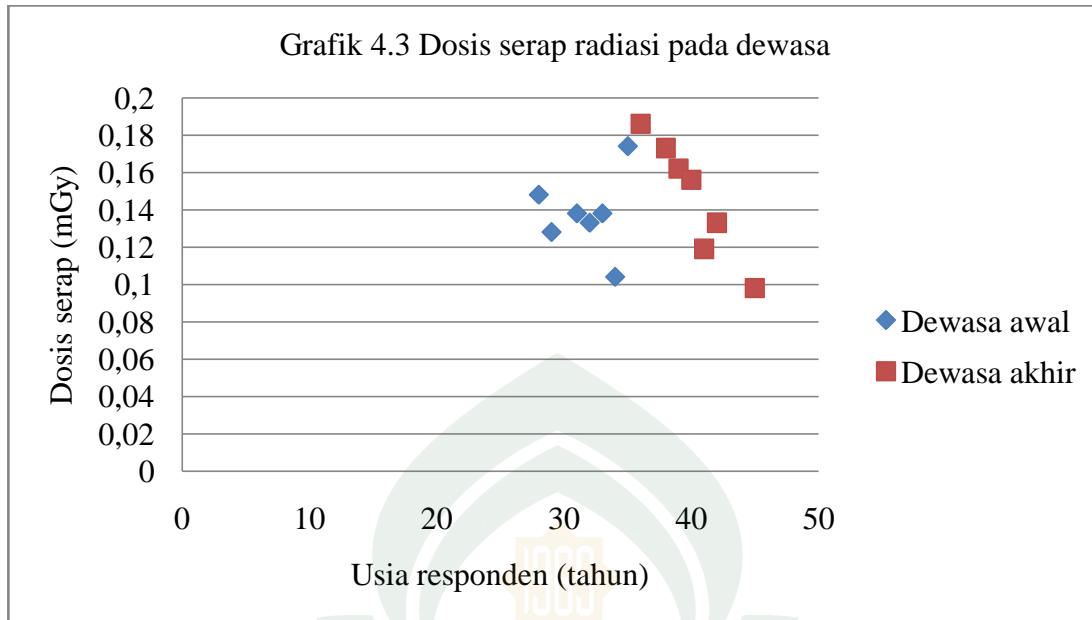

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat ditunjukkan bahwa data-data yang telah diperoleh yaitu pada umur 28 tahun, 29 tahun, 31 tahun, 32 tahun, 33 tahun, 34 tahun, 35 tahun, umur 36 tahun, 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun, 41 tahun, 42 tahun dan 45 menunjukkan bahwa usia responden (dari 26 tahun – 45 tahun) tidak berpengaruh terhadap pemberian faktor *exposure*. Jadi faktor usia tidak mempengaruhi terhadap pemberian faktor *eksposure* dalam pemeriksaan radiodiagnostik, karena bertambah pula berat badan atau tebal ukuran badan pasien, maka dosis serap yang diterimanya semakin meningkat.

d. Dosis serap radiasi pada pasien lansia (46-85 tahun)


Tabel 4.4 Hasil perhitungan dosis serap radiasi untuk lansia 46-85 tahun (dosis serap minimum dan maksimum yang diperbolehkan 0,035-0,178 mGy)

No	Usia Responden (tahun)			Dosis Paparan Radiasi (R)			Dosis Absorpsi Medium (rad)			Dosis Serap (mGy)		
	Lansia awal	Lansia akhir	Manula	Lansia awal	Lansia akhir	Manula	Lansia awal	Lansia akhir	Manula	Lansia awal	Lansia akhir	Manula
1	46	56	66	21866000	18432000	13330800	19176,5	16164,9	11691,1	0,192	0,162	0,117
2	49	57	67	18816000	14406000	19057500	16501,6	12634,1	16713,4	0,165	0,126	0,167
3	50	58	69	24200000	25992000	12757500	21223,4	22794,0	11188,3	0,212	0,228	0,112
4	51	60	70	24200000	24200000	14232600	21223,4	21223,4	12481,98	0,212	0,212	0,125
5	53	62	71	16245000	19845000	17458600	14246,9	17404,1	15311,2	0,143	0,174	0,153
6	55	64	72	19208000	25088000	11763350	16845,4	22002,2	10316,46	0,169	0,220	0,103
7			74			11928900			10461,6			0,105
8			75			20281250			17786,7			0,178
9			76			13330800			11691,1			0,117
10			79			13520000			11857,0			0,119
11			80			11210750			9831,8			0,098
12			81			11560000			10138,1			0,101
13			82			19057500			16713,4			0,167
14			84			15125000			13264,6			0,133
15			85			14320000			12558,6			0,126

Pada tabel 4.4 di atas dosis serap yang diterima oleh pasien lansia memiliki perbedaan yang tidak mencolok seperti pada lansia awal memiliki dosis serap 0,192 mGy, 0,165 mGy, 0,212 mGy, 0,212 mGy, 0,143 mGy dan 0,169 mGy. Pada lansia akhir dosis serap yang diterima yaitu 0,162 mGy, 0,126 mGy, 0,228 mGy, 0,212 mGy, 0,174 mGy dan 0,220 mGy.

Sedangkan pada manula dosis serap yang diterima pada umur 66 tahun, 67 tahun, 69 tahun, 70 tahun, 71 tahun, 72 tahun, 74 tahun, 75 tahun, 76 tahun, 79 tahun, 80 tahun, 81 tahun, 82 tahun, 84 tahun dan 85 tahun masing-masing menerima dosis serap yaitu 0,117 mGy, 0,167 mGy, 0,112 mGy, 0,125 mGy, 0,153 mGy, 0,103 mGy, 0,105 mGy, 0,178 mGy, 0,117 mGy, 0,119 mGy, 0,098 mGy, 0,101 mGy, 0,167

mGy, 0,133 mGy, dan 0,126 mGy dan telah memenuhi syarat untuk dosis serap radiasi yang diterima oleh pasien dewasa sesuai batas maksimal yang telah diijinkan.

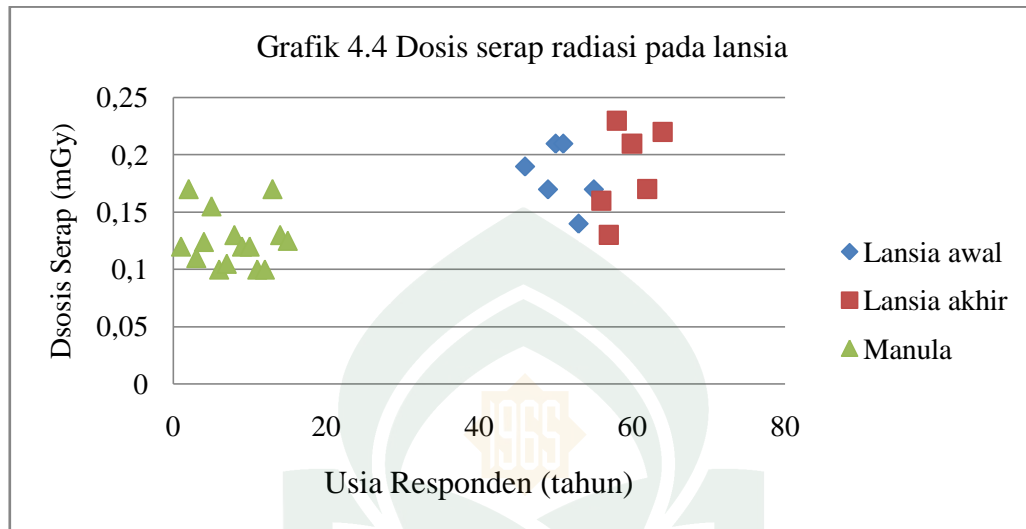

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat ditunjukkan bahwa data-data yang telah diperoleh yaitu pada umur 46 tahun, 49 tahun, 50 tahun, 51 tahun, 53 tahun, 55 tahun, 56 tahun, 57 tahun, 58 tahun, 60 tahun, 62 tahun, 64 tahun, 66 tahun, 67 tahun, 69 tahun, 70 tahun, 71 tahun, 72 tahun, 74 tahun, 75 tahun, 76 tahun, 79 tahun, 80 tahun, 81 tahun, 82 tahun, 84 tahun dan 85 tahun menunjukkan bahwa usia responden (dari 46 tahun – 85 tahun) tidak berpengaruh terhadap pemberian faktor *exposure*. Jadi faktor usia tidak mempengaruhi terhadap pemberian faktor *eksposure* dalam pemeriksaan radiodiagnostik, karena bertambah pula berat badan atau tebal ukuran badan pasien, maka dosis serap yang diterimanya semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan dosis serap minimum dan maksimum yang diizinkan.

4.2 Pembahasan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh perbandingan dosis serap radiasi antara umur berkategori anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) yaitu:

Data yang telah diperoleh pada grafik 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 menyatakan dosis serap radiasi pada pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai yang telah diperoleh bervariasi seperti pada pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Pada pasien yang dikategorikan anak-anak (usia 1-11 tahun) diperoleh data bahwa dosis serap radiasi yang dapat diterima berada antara (0,0631-0,1494) mGy. Begitu pula halnya dengan pasien yang dikategorikan remaja yang berusia (12-25 tahun) dosis yang diterimanya berkisar (0,0604-0,2223) mGy. Kategori ini (remaja) lebih besar dosis serap radiasi yang harus diterima dibanding dengan anak-anak yang berusia (1-11 tahun).

Dosis serap yang dapat diterima oleh pasien dewasa yang berumur (30-45 tahun) berkisar antara (0,0888-0,1859) mGy, jika dibandingkan dengan pasien lanjut usia yang berumur (46-85 tahun) berkisar antara (0,0814-0,2279) mGy, maka dosis serap yang diterima oleh pasien dewasa lebih kecil dibandingkan pasien lansia, tetapi ada beberapa data dosis serap yang diterima oleh pasien dewasa lebih besar dibandingkan dengan pasien lansia. Hal ini disebabkan karena pengaturan faktor *exposure* yang berupa kV dan mAs yang diberikan oleh operator (radiografer) pesawat sinar-X hanya berdasarkan pengujian yang meliputi postur tubuh pasien


yaitu berat badan pasien atau tebal ukuran badan pasien, semakin berat atau tebal tubuh pasien dosis yang diberikan semakin besar pula, hal ini dilakukan agar gambar hasil foto thorax yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Sehingga organ terlihat sempurna. Jika pasien tersebut memiliki berat badan yang besar/berat namun usianya masih muda tetap diberikan dosis yang besar pula disini agar daya tembus sinar X dapat maksimal dan dapat menghasilkan gambar yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan pasien sangat mempengaruhi dosis radiasi yang diberikan terhadap si pasien.

Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara dosis serap yang diterima oleh pasien dan tegangan tabung (kV) sebagai berikut:

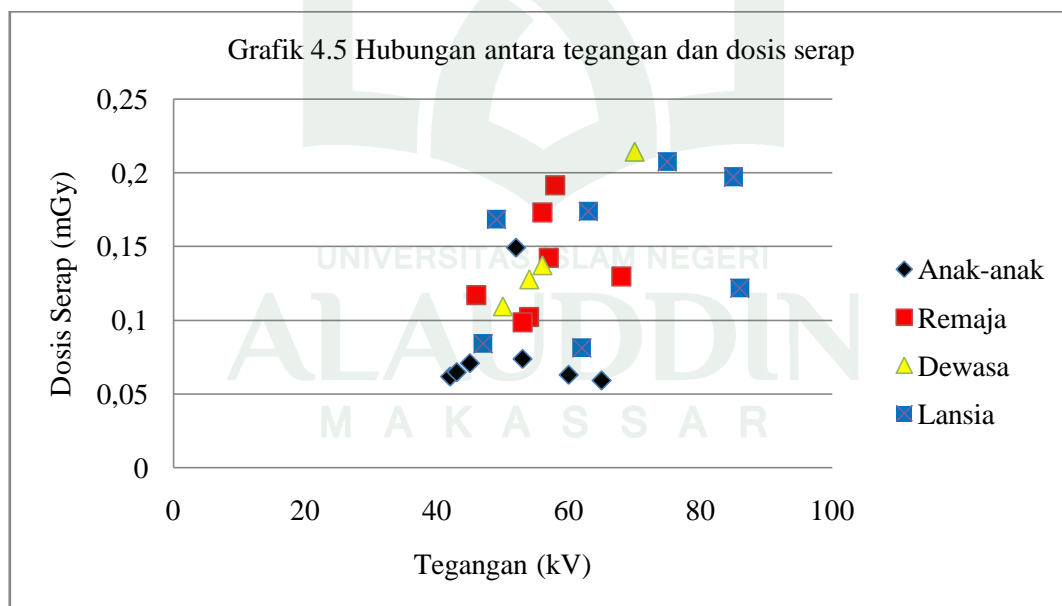

Dari grafik 4.5 di atas hubungan antara dosis serap (mGy) dengan tegangan tabung (kV) yaitu apabila tegangan (kV) yang digunakan semakin besar, maka dosis serap yang dihasilkan semakin besar pula. Tegangan tabung merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi pembentukan gambar pada peristiwa pencitraan pesawat sinar X atau faktor yang mempengaruhi pembentukan gambar radiografi. Tegangan yang digunakan pada pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lansia sekitar 40 kV sampai 90 kV. Selain tegangan tabung yang menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan gambar radiografi ada juga arus tabung (mA), waktu ekspose (s) yang sesingkat mungkin dan jarak antara pasien dan tabung sinar X (cm), selain itu faktor yang mempengaruhi adalah ukuran objek atau pasien yang akan diream (difoto), kelainan patologis yang akan diperiksa dan pemotretan dengan grid atau tanpa grid.

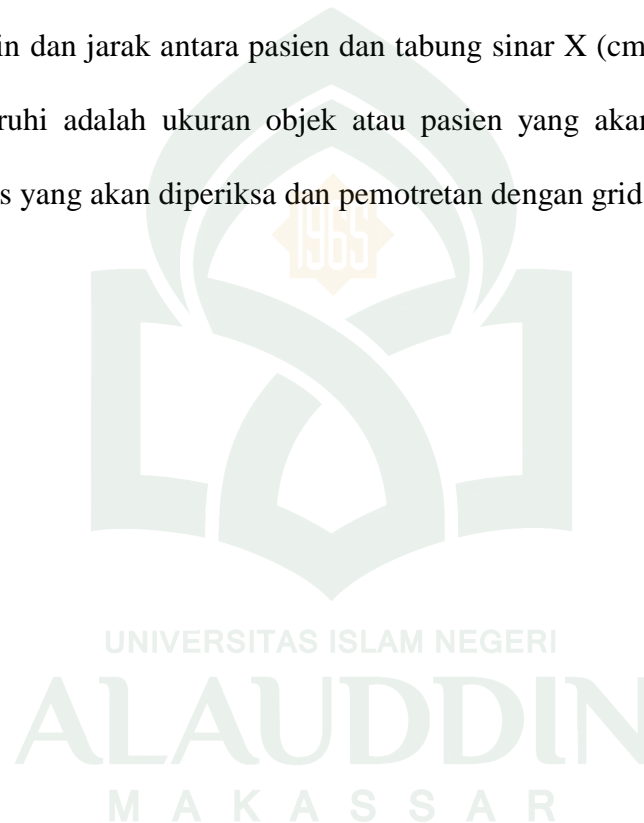

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Telah dilakukan penelitian tentang nalisis perbandingan dosis serap radiasi foto thorax yang diterima oleh pasien anak-anak, dewasa dan lansia, dan diperoleh data sebagai berikut:

- 1 Besar dosis serap radiasi foto thorax yang diterima oleh pasien di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum H.A. Sultan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu pada pasien anak-anak (1-11 tahun) sekitar (0,0631-0,1494) mGy, pada pasien remaja (12-25 tahun) sekitar (0,0604-0,2223) mGy, dewasa (26-45 tahun) sekitar (0,0888-0,1859) mGy dan pada pasien lansia (46-85 tahun) antara (0,0814-0,2279) mGy.
- 2 Perbandingan antara dosis serap yang diperoleh oleh anak-anak, remaja, dewasa dan lansia yaitu pasien yang memiliki dosis serap yang paling tinggi adalah lansia sedangkan yang terendah adalah anak-anak, sedangkan untuk remaja dan dewasa berada diantara anak-anak dan lansia.
- 3 Hubungan antara tegangan yang digunakan dengan dosis serap yang diperoleh yaitu apabila tegangan (kV) yang digunakan semakin besar, maka dosis serap yang dihasilkan semakin besar pula tetapi tergantung juga dari beberapa faktor yaitu arus (mA), jarak (cm) dan waktu (s).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dapat diusulkan sebagai masukan kepada Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Hj. A. Sultan Dg Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk meningkatkan proteksi radiasi khususnya asaoptimasi yaitu perlunya perhitungan besarnya dosis yang diberikan kepada pasien anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.
2. Bagi operator harus mengupayakan untuk menjaga agar penyinaran dosis serap radiasi pada pasien dapat diusahakan serendah mungkin sesuai dengan pedoman bagi setiap penggunaan radiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandu. Karmila, 2014, *Efek Radiasi Sinar-X Pada Anak-Anak*, Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dwijayanthi, Linda & Dharmawan, Didiek, 2010, *Mengenali Pola-Pola Foto diagnostik*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Fahmi. Arif dkk, 2008, *Pengaruh Faktor Eksposi Pada Pemeriksaan Abdomen Terhadap Kualitas Radiograf Dan Paparan Radiasi Menggunakan Computed Radiography*, Rumah Sakit Umum Daerah Laboratorium Fisika Atom & Nuklir, Jurusan Fisika FMIPA dan UNDIP, Vol 11 , No.4, Oktober 2008 Hal 109-118.
- Fauziah.A,dan Dwijayanti.P, 2013, *Pengaruh Radiasi Sinar-X Terhadap mortilitas Sperma Pada Tikus Mencit (mus mucus)*, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 9;2013:93-98
- Gabriel, J. F, 1996, *Fisika Kedokteran*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Gusmavita, Adisti, 2011, *Simulasi Penentuan Dosis Serapan Radiasi- γ Dari ^{103}Pd Pada Brachytherapy Payudara Menggunakan Software MCNP5 Dengan Tehnik PBSI*, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Juli 2011
- Humaidi Syahrul, 2005, *Dampak Radiasi Monitor Komputer*, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, e-usu Reppository.
- Iswadi, 2012,*Pendahuluan Fisika Inti*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Alauddin University Press, Makassar.

- Lusiyanti. Yanti dan Syaifuddin. Mukh Syaifudin, 2008, *Penerapan Efek Interaksi Radiasi Dengan Sistem Biologi Sebagai Dosimeter Biologi*, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – BATAN, FN, Vol 2 No. 1, Mei 2008, ISSN 1978-8738
- Maryanto. Djoko, 2012, *Analisis Keselamatan Kerja Radiasi Pesawat Sinar-X Di Unit Radiologi Rsu Kota Yogyakarta*, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir–Batan, Seminar Nasional IV, Sdm Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 25 - 26 Agustus 2008, Issn 1978-0176
- Muhamad. Arief, Latar, *Pengendalian Bahaya Radiasi Elektromagnetik Ditempat Kerja*, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Univ. Esa Unggul.
- Nayiroh. Nurun, 2014, *Teori Kuantum Radiasi (Dualisme Partikel Dan Gelombang)*, Pertemuan ke 4, Fisiska Moder, 18 September
- Quraish. shihab. M, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian, Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta.
- Rasad, Sjahriar, 2005, *Radiologi Diagnostik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Rudi.Dkk, 2012, *Pengukuran Paparan Radiasi Pesawat Sinar x Di Instalasi Radiodiagnostik Untuk Proteksi Radiasi*, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang Gunungpati, Semarang. Jawa Tengah, Unnes Physics 1 (1) (2012), Unnes Physics Journal <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upj>, ISSN NO 22526978.
- Ruslan Hani. Ahmadi, 2010, *Teori Dan Aplikasi Fisika Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

- Ruslan Hani. Ahmadi dan Riwidikno. Handoko, 2007, *Fisiska Kesehatan*, Nuha medika, Yogyakarta, 2007, September
- Safitri. Rini dan Fitri. Lenni, “*Study Of Gamma Ray Irradiation On FoodPreservetion (Case Study On Chili Powder)*”, jurusan Fisika, jurusan Biologi FMIPA Universitas Syiah Kuala, Jurnal Natural, Vol. 10, No. 2, 2010
- Salim. Bahreisy, H dan Said. Bahreisy, H, 2003, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 6*, Victoria Agencie, Kuala Lumpur
- Sofyan, H, Yuliati, H, Milvita, D dan Nengsih, S, 2009, *Dosis Radiasi Pasien Radiologi Anak pada Pemeriksaan Torak di Kota Padang*, Depok, Prosiding Seminar Nasional Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan V
- Supriyanto. Amir, 2005, *Pengukuran Radioaktivitas Dan Radiasi-Gamma Lingkungan Di Provinsi Lampung*, Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Lampung Jl. S. Brojonegoro 1 Bandar Lampung, Desember 2005, Vol. 11, No. 3
- Susworo, R, 2006, *Radioterapi, Dasar-Dasar Radioterapi dan Tata Laksana Radioterapi Penyakit Kanker*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Widayati. Evi, 2013, *Analisis Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Anak Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Paru Jember*, Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
- www.geocities.com/radiologi_vet, 2015, *Efek Radiasi Ionisasi Sinar X Terhadap Jaringan*, 24 mei
- Yuliati, H. dan Kusumawati, D,D, 2006, *Terimaan Dosis Radiasi Foto Thorak oleh Pasien Anak*, Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional Teknis non Peneliti, hal: 155-164

RIWAYAT HIDUP



Andi Musfira lahir di Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tengah pada tanggal 24 Januari 1992. Merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Andi Muhyddin (Alm) dan Ibunda Indo Tang. Penulis menamatkan pendidikan di SD Negeri No.207 dampang pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Gangking dan tamat pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kindang tamat tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Berkat lindungan Allah swt, dan iringan do'a kedua orang tua serta saudara-saudaraku, juga berkat bimbingan para dosen dan dukungan dari teman-teman seperjuangan, sehingga dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berhasil meraih gelar sarjana sains dengan IPK 3,47 (memuaskan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran I : Hasil Analisis Dosis Serap



1. Analisis Dosis Serap pada Anak-anak (1-11 tahun)

Contoh analisis dosis serap pada anak-anak umur 1,2 tahun

➤ Pada Umur 1,2 tahun

$$E = \frac{v^2 I \cdot t}{FFD^2}$$

$$E = \frac{(60 \cdot 10^3)^2 \cdot v \cdot 2,0 \times 10^{-3} \text{ mAs}}{1^2 \text{ m}}$$

$$E = 7200000 \text{ R}$$

$$\begin{aligned} mR &= 7200000 \times 10^{-3} \\ &= 7200 \text{ mR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} mR &= 7200 \times 0,877 \text{ rad} \\ &= 6314,4 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis serap (mGy)} &= 6314,4 \times 10^{-5} \\ &= 0,0631 \text{ mGy} \end{aligned}$$

Dengan cara perhitungan yang sama untuk umur 1,2 tahun, maka diperoleh nilai dosis serap untuk semua tingkat umur pada anak-anak yaitu:

Tabel L.1 Hasil perhitungan dosis serap untuk Anak-anak 1-11 tahun

Umur (tahun)	V (kV)	I x t (mAS)	Dosis Paparan Radiasi (R)	Dosis Absorpsi Medium (rad)	Dosis serap (mGy)	Dosis serap (Max & Min) yang diperbolehkan (mGy)	Ket
1,2	60	0,0020	7200000	6314,4	0,0631	0,024 – 0,404	Sesuai
2	42	0,0040	7056000	6188,112	0,0619	0,024 – 0,404	Sesuai
2,4	53	0,0030	8427000	7390,479	0,0739	0,024 – 0,404	Sesuai
3	52	0,0047	11636133,3	10204,889	0,1020	0,024 – 0,404	Sesuai
5	53	0,0040	11236000	9853,972	0,0985	0,024 – 0,404	Sesuai
6	58	0,0034	11197000	9819,769	0,0982	0,024 – 0,404	Sesuai

8	43	0,0060	11094000	9729,438	0,0973	0,024 – 0,404	Sesuai
9	55	0,0035	10390200	9112,2054	0,0911	0,024 – 0,404	Sesuai
11	55	0,0050	15125000	13264,625	0,1326	0,024 – 0,404	Sesuai

2. Analisis Dosis Serap pada Remaja (12-25 tahun)

Contoh analisis dosis serap pada pasien remaja umur 12 tahun

➤ Pada Umur 12 tahun

$$E = \frac{v^2 I \cdot t}{FFD^2}$$

$$E = \frac{(554 \cdot 10^3)^2 \cdot v \cdot 4,0 \times 10^{-3} \text{ mAs}}{1^2 \text{ m}}$$

$$E = 11664000 \text{ R}$$

$$R = 11664000 \times 10^{-3}$$

$$= 11664 \text{ mR}$$

$$mR = 11664 \times 0,877 \text{ rad}$$

$$= 13155 \text{ rad}$$

$$\text{Dosis serap (mGy)} = 10229,328 \times 10^{-5}$$

$$= 0,1023 \text{ mGy}$$

Dengan cara perhitungan yang sama untuk umur 12 tahun, maka diperoleh nilai

dosis serap untuk semua tingkat umur pada pasien remaja yaitu:

Tabel L.2 Hasil perhitungan dosis serap untuk Remaja 12-25 tahun

Umur (tahun)	V (kV)	I x t (mAS)	Dosis Paparan Radiasi (R)	Dosis Absorpsi Medium (rad)	Dosis serap (mGy)	Dosis serap (Max & Min) yang diperbolehkan (mGy)	Ket
12	54	0,0040	11664000	10229,328	0,1023	0,024 – 0,404	Sesuai
13	65	0,0060	25350000	22231,95	0,2223	0.024 - 0.404	Sesuai
14	68	0,0032	14796800	12976,7936	0,1298	0.024 - 0.404	Sesuai
15	45	0,0034	6885000	6038,145	0,0604	0.024 - 0.404	Sesuai
16	53	0,0040	11236000	9853,972	0,0985	0.024 - 0.404	Sesuai
17	56	0,0063	19756800	17326,7136	0,1733	0.024 - 0.404	Sesuai
18	58	0,0065	21866000	19176,482	0,1918	0.024 - 0.404	Sesuai
19	57	0,0057	18000900	15786,7893	0,1579	0.024 - 0.404	Sesuai
20	56	0,0059	18418733,3	16153,22913	0,1612	0.024 - 0.404	Sesuai
21	46	0,0063	13330800	11691,1116	0,1169	0.024 - 0.404	Sesuai
22	46	0,0063	13330800	11691,1116	0,1169	0.024 - 0.404	Sesuai
23	51	0,0063	16194150	14202,26955	0,1420	0.024 - 0.404	Sesuai
24	56	0,0063	19756800	17326,7136	0,1733	0.024 - 0.404	Sesuai
25	55	0,0063	19057500	16713,4275	0,1671	0.024 - 0.404	Sesuai

3. Analisis Dosis Serap pada Dewasa (26-45 tahun)

Contoh analisis dosis serap pada dewasa umur 28 tahun

➤ Pada Umur 28 tahun

$$E = \frac{v^2 I \cdot t}{FFD^2}$$

$$E = \frac{(65 \times 10^3)^2 \cdot 4,0 \times 10^{-3} \text{ mAs}}{1^2 \text{ m}}$$

$$E = 16900000 \text{ R}$$

$$R = 16900000 \times 10^{-3}$$

$$= 16900 \text{ mR}$$

$$\text{mR} = 16900 \times 0,877 \text{ rad}$$

$$= 14821,3 \text{ rad}$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis serap (mGy)} &= 14821,3 \times 10^{-5} \\ &= 0,1482 \text{ mGy} \end{aligned}$$

Dengan cara perhitungan yang sama untuk umur 28 tahun, maka diperoleh nilai dosis serap untuk semua tingkat umur pada dewasa yaitu:

Tabel L.3 Hasil perhitungan dosis serap untuk Dewasa 26-45 tahun

Umur (tahun)	V (kV)	I x t (mAs)	Dosis Paparan Radiasi (R)	Dosis Absorpsi Medium (rad)	Dosis serap (mGy)	Dosis serap (Max & Min) yang diperbolehkan (mGy)	Ket
28	65	0,0040	16900000	14821,3	0,1482	0.07 - 2.37	Sesuai
29	54	0,0050	14580000	12786,66	0,1279	0.07 - 2.37	Sesuai
31	56	0,0050	15680000	13751,36	0,1375	0.07 - 2.37	Sesuai
32	53	0,0050	13812500	12113,5625	0,1211	0.07 - 2.37	Sesuai
33	56	0,0050	15680000	13751,36	0,1375	0.07 - 2.37	Sesuai
34	49	0,0050	11822500	10368,3325	0,1037	0.07 - 2.37	Sesuai
35	63	0,0050	19812500	17375,5625	0,1738	0.07 - 2.37	Sesuai
36	58	0,0063	21193200	18586,4364	0,1859	0.07 - 2.37	Sesuai
38	56	0,0063	19756800	17326,7136	0,1733	0.07 - 2.37	Sesuai
39	57	0,0059	18418793,33	16153,22913	0,1615	0.07 - 2.37	Sesuai
40	56	0,0057	17718400	15539,0368	0,1554	0.07 - 2.37	Sesuai
41	47	0,0063	15623750	11948,1116	0,1195	0.07 - 2.37	Sesuai
42	55	0,0050	15125000	13264,625	0,1326	0.07 - 2.37	Sesuai
45	54	0,0042	11183066,67	9807,549467	0,0981	0.07 - 2.37	Sesuai

4. Analisis Dosis Serap pada Lansia (46-85 tahun)

Contoh analisis dosis serap pada lansia umur 46 tahun

➤ Pada Umur 46 tahun

$$E = \frac{v^2 I \cdot t}{FFD^2}$$

$$E = \frac{(58 \times 10^3)^2 \cdot v \cdot 6,5 \times 10^{-3} \text{ mAs}}{1^2 \text{ cm}}$$

$$E = 21860000 \text{ R}$$

$$R = 21866000 \times 10^{-3}$$

$$= 21866 \text{ mR}$$

$$mR = 21866 \times 0,877 \text{ rad}$$

$$= 19176,482 \text{ rad}$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis serap (mGy)} &= 19176,482 \times 10^{-5} \\ &= 0,1918 \text{ mGy} \end{aligned}$$

Dengan cara perhitungan yang sama untuk umur 75 tahun, maka diperoleh nilai dosis serap untuk semua tingkat umur pada lansia yaitu:

Tabel L.4 Hasil perhitungan dosis serap untuk Lansia 70-85 tahun

Umur (tahun)	V (kV)	I x t (mAS)	Dosis Paparan Radiasi (R)	Dosis Absorpsi Medium (rad)	Dosis serap (mGy)	Dosis serap (Max & Min) yang diperbolehkan (mGy)	Ket
46	58	0,0065	21866000	19176,482	0,1918	0,035 - 1,7775	Sesuai
49	56	0,0060	18816000	16501,632	0,1650	0,035 - 1,7775	Sesuai
50	55	0,0080	24200000	21223,4	0,2122	0,035 - 1,7775	Sesuai
51	55	0,0080	24200000	21223,4	0,2122	0,035 - 1,7775	Sesuai
53	57	0,0050	16245000	14246,865	0,1425	0,035 - 1,7775	Sesuai
55	49	0,0080	19208000	16845,416	0,1685	0,035 - 1,7775	Sesuai
56	48	0,0080	18432000	16164,864	0,1616	0,035 - 1,7775	Sesuai
57	49	0,0060	14406000	12634,062	0,1263	0,035 - 1,7775	Sesuai
58	57	0,0080	25992000	22794,984	0,2279	0,035 - 1,7775	Sesuai
60	55	0,0080	24200000	21223,4	0,2122	0,035 - 1,7775	Sesuai
62	63	0,0050	19845000	17404,065	0,1740	0,035 - 1,7775	Sesuai
64	56	0,0080	25088000	22002,176	0,2200	0,035 - 1,7775	Sesuai
66	46	0,0063	13330800	11691,1116	0,1169	0,035 - 1,7775	Sesuai

67	55	0,0063	19057500	16713,4275	0,1671	0,035 - 1,7775	Sesuai
69	45	0,0063	12757500	11188,3275	0,1119	0,035 - 1,7775	Sesuai
70	50	0,0060	14232600	12482,0	0,1248	0,035 - 1,7775	Sesuai
71	81	0,0026	17458600	15311,2	0,1531	0,035 - 1,7775	Sesuai
72	56	0,0044	11763350	10316,5	0,1032	0,035 - 1,7775	Sesuai
74	51	0,0040	11928900	10461,6	0,1046	0,035 - 1,7775	Sesuai
75	80	0,0033	20281250	17786,7	0,1779	0,035 - 1,7775	Sesuai
76	46	0,0063	13330800	11691,1116	0,1169	0,035 - 1,7775	Sesuai
79	65	0,0032	13520000	11857,04	0,1186	0,035 - 1,7775	Sesuai
80	57	0,0037	112107500	9831,8	0,0983	0,035 - 1,7775	Sesuai
81	68	0,0025	11560000	10138,12	0,1014	0,035 - 1,7775	Sesuai
82	55	0,0063	19057500	16713,4275	0,1671	0,035 - 1,7775	Sesuai
84	55	0,0050	15125000	13264,625	0,1326	0,035 - 1,7775	Sesuai
85	64	0,0038	14320000	12558,6	0,1256	0,035 - 1,7775	Sesuai



Lampiran II : Dokumentasi Foto





Gambar L.1 Ruang rontgen



Gambar L.2 Ruang ekspose



Gambar L.3 Ruang ganti



Gambar L.4 Penyiapan alat Rontgen



Gambar L.5 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.6 Kontrol expose



Gambar L.7 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.8 Kontrol expose



Gambar L.9 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.10 Kontrol expose



Gambar L.11 Proses pengambilan Foto thorax



Gamabr L.12 Kontrol ekspose



Gambar L.13 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.14 Kontrol expose



Gambar L.15 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.16 Kontrol expose



Gambar L.17 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.18 Kontrol expose



Gambar L.19 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.20 Kontrol expose



Gambar L.21 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.22 Kontrol expose



Gambar L.23 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.24 Kontrol expose




Gambar L.25 Pemilihan sampel penelitian sekaligus mengatur posisi pasien



Gambar L.26 Kontrol expose

**Lampiran III : Surat Keterangan
Penelitian**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus Tridji: Survei Alauddin No. 63 Makassar III (0411) 865720, Fax: (0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. Yusuf Tampi No. 36, Heirangcemping-Cowwi, III (0411) 541875, Fax: (0411) 8221400

Nomor : ST.VI.1/PP.009/1622/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Makassar, 23 Mei 2016

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMO Prov. Sulsel
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Andi Musfira
NIM	: 60400111006
Semester	: X
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Muh. Said, L, S.Si., M.Pd. 2. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Anak-Anak Dewasa Dan Lansia" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi Izin untuk Penelitian di Kepala UPT P2T BKPMO Prov. Sul-sel).

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kuas Dekan,
No. ST.VI/WKP.07.6/1622/2016
Makassar, 20 Mei 2016
Ketua Dekan Bidang Kemahasiswaan



Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Alamat : Jl. Durian No. 2 Telp. (0413) dan 81102 Bulukumba 92511

Bulukumba, 31 Mei 2016

Nomor : 350/BP3K/LB/V/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Direktur RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
 Kab. Bulukumba
 di-
 Bulukumba

Berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (UPT-P2T) Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Nomor : 6642/01.P/P2T/05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 Perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ANDI MUSFIRA**
 No. Pokok : 60400111006
 Prog. Studi : Fisika
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di RSUD H. A.Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN DOSIS SERAP RADIASI FOTO THORAX PADA PASIEN ANAK-ANAK DEWASA DAN LANSIA" akan berlangsung pada tanggal 06 Juni s/d 15 Juli 2016.

Schubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami **mengizinkan** yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



TAUFIK S.H. M.H.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19631231 199203 1 102

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba;
3. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA
 JALAN SERIKAYA NO. 17 Telp (0413) 81290, 81292 FAX. 83030



Bulukumba, 03 Juni 2016

Nomor : 419 /RSUD-BLK/05.VI/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Ruangan _____
 di _____
 Tempat

Berdasarkan surat dari Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan nomor 350/BP3K/LB/VI/2016 Tanggal 27 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI MUSFIRA
 No.pokok : 60400111006
 Program studi : Fisika
 Institusi : Universitas UIN Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di lingkup saudara dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN DOSIS SERAP RADIASI FOTO THORAX PADA PASIEN ANAK – ANAK DEWASA DAN LANSIA DI RSUD H.A. SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA 2016" yang akan berlangsung pada tanggal 06 Juni s/d 15 Juli 2016.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi.

An. Direktur
 Kabid Pelayanan Keperawatan

H. BUSTAN, SKM, M.Kes
 Nip : 19581014 198003 1 009



**Lampiran IV : Surat-Surat
Keputusan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 33 Makassar ☎ (0411) 898720, Fax: (0411) 894923
Kampus II: Jl. H.M. Yasir Limpo No.36, Romangpolong Gowa ☎ (0411) 841879, Fax: (0411) 8221400

Nomor: ST.VI.17/PP.0091/0691/2016

Semata Gowa, 07 Maret 2016

Perihal: Penting

Lamp: -

Hal: Undangan Seminar Draft Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Draft Skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Mustafa
NIM : 60400112006
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : "Analisis Perbandingan dan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax Pada Pasien Anak-Anak Dewasa Dan Lanjut Usia (Lansia)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/11 Maret 2016
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 196912051993031001

Tembusan :
Mahasiswa (i).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



ALAUDDIN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 NOMOR : 478 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
 ANDI MUSFIRA NIM 60400112006
 JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama **ANDI MUSFIRA NIM 60400112006**, untuk melaksanakan seminar draft ..
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 269 Tahun 1993 JO Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
 Sekretaris : Ihsan, S.Pd., M.S.
 Pembimbing I : Muh. Said, L. S.S., M.Pd.
 Pembimbing II : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
 Penguji I : Ihsan, S.Pd., M.S.
 Penguji II : Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd.
 Penguji III : Dr. Sabri AR, M.Eng.
 Pelaksana : Agusdin, S.Sos.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan, mengenal materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi;
 2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 01 Maret 2016





KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/ PP.00.9/2016 Samata Gowa, 26 Agustus 2016
Sifat : Penting
Lamp :-
Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Ythp

Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)

Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Andi Musfira
NIM : 60400111006
Jurusan : FISIKA
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Dosis Serap Foto Thorax pada Pasien Anak-Anak, Dewasa dan Lansia

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/22 Agustus 2016
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fak. Sains dan Teknologi

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :
Mahasiswa ybs



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1303 TAHUN 2016
TENTANG**

**PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Pemohonan **ANDI MUSFIRA, NIM 60400111006, tertanggal 16-Agust-16,** untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi.
- Meringkat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.
Sekretaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Pembimbing II : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji II : Ria Rezky Hamzah, S.Pd., M.Pd.
Penguji III : Dr.Sabri, M.Ag.
Pelaksana : Nassar, S.Ag.

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditela pkan di : Makassar
Pada tanggal : 16-Agust-16

**An.Rektor
Dekan**



Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 787 TAHUN 2016
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : ANDI MUSFIRA, NIM: 60400111006
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Dr.Hj.Wasliah,S.T.,M.T.
Sekertaris : Nassar,S.Ag.
Penguji I : Dr.Muh.Sabri AR,
Penguji II : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Penguji III : Sahara,S.Si., M.Sc.,Ph.D
Pelaksana : Jusmulyadi,S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 18-Apr-16

Dekan
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NIP. 19691205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : STVI.1/PP.09/2016

Samata Gowa, 31 Agustus 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah/ Ujian Meja

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekerlaris
3. Penguji I
4. Penguji II
5. Penguji III
6. Pembimbing I
7. Pembimbing II
8. Pelaksana

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : ANDI MUSHRA

Nim : 60400111006

Jurusan : FISIKA

Judul Skripsi : "Analisis Perbandingan Dosis Serap Racios Fala Thorax pada Pasien Anak-
Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia"

Dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin/05 September 2016

Waktu : 09.00.10.00 Wita

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah Fak. Sainstek

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

/Dekan

UNIVERSITAS



Prof. Dr. M. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan

alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi,

.....2016
Penguji/ Pembimbing,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1522 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **ANDI MUSFIRA**
NIM : 60400111006
Tanggal : 29 Agustus 2016
Mahasiswa Jurusan : F 151 KA
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Analisis Perbandingan Dosis Serap Radiasi Foto Thorax pada Pasien Anak-Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
Sekretaris : Ihsan, S. Pd., M. Si.
Penguji I : Ihsan, S. Pd., M. Si.
Penguji II : Ria Reski Hamzah, S. Pd., M. Pd.
Penguji III : Dr. Muh. Sabri AR., M. Ag.
Pembimbing I : Muh. Said L., S. Si., M. Pd.
Pembimbing II : Sahara, S. Si., M. Sc. Ph. D.
Pelaksana : Dra. Juslilah

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/ Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 29 Agustus 2016

An. Rektor
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001