

**STUDI PENENTUAN KUALITAS BERKAS RADIASI
PESAWAT SINAR-X MAMMOGRAFI DI RSUD KOTA
MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Pada
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

DEWI KARTIKA LESTARI

NIM : 60400112057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Kartika Lestari
NIM : 60400112057
Tempat/ Tgl. Lahir : Watampone, 19 Oktober 1994
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Fisika/Fisika/Kesehatan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Komp. BTN Lonrae Blok G1 No.1 Kec.
T.R. Timur Kab. Bone
Judul : Studi Penentuan Kualitas Berkas Radiasi
Pesawat Sinar-X Mammografi di RSUD
Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 27 November 2017

Penyusun



Dewi Kartika Lestari
NIM: 60400112057



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Studi Penentuan Kualitas Berkas Radiasi Pesawat Sinar-X Mammografi di RSUD Kota Makassar*", yang disusun oleh saudari **DEWI KARTIKA LESTARI**, Nim: 60400112057 Mahasiswi Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 27 November 2017 M, bertepatan dengan 8 Rabi'ul Awwal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Fisika, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 27 November 2017

8 Rabi'ul Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	
Sekretaris	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	
Munaqisy I	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc.	
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.	
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	
Pembimbing II	: Muh. Said L., S.Si., M.Pd.	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**STUDI PENENTUAN KUALITAS BERKAS RADIASI PESAWAT SINAR-X MAMMOGRAFI DI RSUD KOTA MAKASSAR**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta **Annas Sanusi** dan Ibunda tercinta **Hj. Kartini M.**, selaku orang tua yang telah menjadi motivator dan pemberi semangat yang luar biasa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat serta tiada henti-hentinya mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan agar penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Di samping itu, penulis mengucapkan terima kasih pula kepada Ayahanda **Ihsan, S.Pd., M.Si**, selaku pembimbing I sekaligus Sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak memberikan sedekah tenaga, pikiran, motivasi, dan bersabar meluangkan waktu dengan setulus hati dalam proses bimbingan sampai pada penyelesaian penulisan skripsi ini serta kepada Ayahanda **Muh. Said L, S.Si., M.Pd.**, selaku pembimbing II sekaligus penasehat

akademik yang senantiasa memberikan tenaga, pikiran, dan motivasi dalam memacu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan namun berkat pertolongan dari Allah SWT. Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:.

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta Wakil Dekan Bidang Akademik **Dr. Wasilah, S.T., M.T**, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kepegawaian **Dr. Thahir Maloko, M. Hi**, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan **Dr. Andi Suarda, S.T., M.T**.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Jurusan Fisika yang banyak memberikan saran, masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberi bimbingan selama mengikuti praktikum di Laboratorium.
5. Ibu **Fitriyanti, S.Si., M.Sc** dan, Bapak **Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.**, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak kritikan, masukan serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.


6. Bapak, Ibu **Dosen Jurusan Fisika** yang telah memberikan ilmu sejak berada di bangku perkuliahan hingga selesainya menjadi mahasiswa di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
7. Seluruh pegawai **BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan)** yang telah membantu, memberikan izin dan bimbingan selama proses penelitian hingga pengolahan data skripsi.
8. Seluruh **Staf Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan berupa administrasi akademik di selama menjadi mahasiswa.
9. Kakanda **Hadiningsih, S.E.**, selaku Staf Akademik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membantu dalam proses administrasi akademik dan pelayanan yang baik di Jurusan Fisika.
10. Para Laboran di Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membantu selama kegiatan di Laboratorium Fisika.
11. Untuk kakak-kakak tercinta **Erwin Gunawan, Ika Sartika Askar, Ilham Setiawan, Budi Hermawan**, dan adikku **Sri Hardianti Astuti** dan **Semua Keluarga** yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
12. Kepada para senior, rekan-rekan dan adik-adik di Jurusan Fisika terima kasih buat kenangannya selama berada di Jurusan Fisika.
13. Kepada semua pihak yang belum sempat penulis tuliskan dan telah memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam

penyelesaian studi, penulis mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

“Manusia Hanya Dapat Memulai Dengan Basmalah Dan Biarkan Allah SWT Yang Menyelesaikan Segala Urusan Dan Menentukan Hasil Akhirnya”

Samata, 27 November 2017
Penyusun

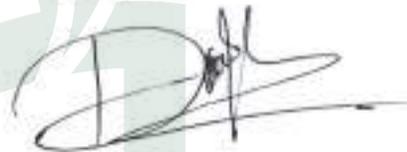

Dewi Kartika Lestari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIMBOL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sinar-X.....	5
2.2 Proses Terjadinya Sinar-X.....	11

2.3 Sifat-sifat Sinar-X.....	12
2.4. Efek Sinar-X.....	13
2.5 Radiasi.....	15
2.6 Sistem Proteksi Radiasi.....	20
2.7 Pesawat Mammografi.....	21
2.8 Komponen Pesawat Mammografi.....	25
2.9 Kanker Payudara.....	29
2.10 Kualitas Berkas Radiasi/ HVL.....	35
2.11 Batas Nilai Toleransi HVL.....	37
2.12 Multimeter <i>X-ray RaySafe</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat.....	40
3.2 Alat dan Bahan.....	40
3.3 Prosedur Kerja.....	40
3.4 Tabel Pengamatan.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
3.6 Bagan Alir Penelitian.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengukuran Kualitas Berkas Radiasi dengan Menggunakan Filter Al.....	46
4.2 Pengukuran Kualitas Berkas Radiasi dengan Pengukuran Langsung dengan Menggunakan Multimeter X-ray.....	49
4.3 Perbandingan antara Kualitas Berkas Pesawat Sinar-X	

Mammografi dengan Menggunakan Filter Aluminium dan Kualitas Berkas Radiasi dengan Pengukuran Langsung Menggunakan Multimeter X-ray.....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	L1



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
3.1	Pengukuran dosis sebanyak 3x untuk mendapatkan dosis setengah dari dosis mula-mula	42
3.2	Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter Al	43
3.3	Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan multimeter <i>X-ray</i>	43
3.4	Perbandingan nilai HVL pada pengukuran dengan menggunakan filter Al dan nilai HVL dengan menggunakan multimeter X-ray.	44
4.1	Pengukuran dosis sebanyak 3x untuk mendapatkan dosis setengah dari dosis mula-mula dengan pengaturan 50 mAs	48
4.2	Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter Al	48
4.3	Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter <i>X-ray</i>	50
4.4	Perbandingan nilai HVL pada pengukuran dengan menggunakan filter Al dan nilai HVL dengan menggunakan multimeter X-ray.	51

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Alat Foto Listrik	6
2.2	Tabung pesawat sinar-X	7
2.3	Spektrum gelombang elektromagnetik	8
2.4	Spektrum energi sinar-X mammografi	14
2.5	Pesawat sinar-X mammografi	21
2.6	Bagian-bagian pesawat sinar-X mammografi	26
2.7	Mammogram yang menunjukkan payudara normal dan payudara dengan kanker	29
2.8	Multimeter <i>X-ray RaySafe</i>	38
3.1	Pengukuran HVL menggunakan <i>non-invasif beam analyzer</i>	41
4.1	Pengaturan posisi detektor dengan menggunakan <i>waterpass</i>	46
4.2	Pengukuran HVL dengan menggunakan detektor	47

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik	Keterangan Grafik	Halaman
------------	-------------------	---------

4.1	Grafik hubungan antara nilai batas toleransi minimum dan maksimum serta nilai HVL dengan menggunakan filter aluminium dan dengan menggunakan multimeter <i>X-ray</i>	53
-----	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
I	Hasil data pengukuran	L2
II	Nilai Batas Toleransi dan Nilai HVL	L5
III	Dokumentasi Penelitian	L8
IV	Persuratan Pemerintahan	L14
V	Persuratan SK Pembimbing	L22



DAFTAR SIMBOL

No	Keterangan Simbol	Satuan
HVL	<i>Half Value Layer/</i> Ketebalan suatu lapisan yang menghasilkan intensitas $D_0/2$	mmAl
D_0	Dosis mula-mula	mGy
t_b	Ketebalan suatu lapisan lebih kecil dari $D_0/2$	mmAl
t_a	Ketebalan suatu lapisan lebih besar dari $D_0/2$	mmAl
D_a	Dosis yang hasilkan lebih besar $D_0/2$	mGy
D_b	Dosis yang hasilkan lebih besar $D_0/2$	mGy
kVp	Tegangan tabung	kV
Mo	Molybdenum	-
Rh	Rhodium	-

ABSTRAK

NAMA : DEWI KARTIKA LESTARI
NIM : 60400112057
JUDUL :STUDI PENENTUAN KUALITAS BERKAS RADIASI
PESAWAT SINAR-X MAMMOGRAFI DI RSUD KOTA
MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium dan melalui pengukuran multimeter *X-ray*. Penelitian ini menggunakan pesawat mammografi tipe analog *Lylium*, multimeter *X-ray RaySafe*, *waterpass* dan filter aluminium dengan kemurnian 99%. Untuk mengukur kualitas berkas radiasi digunakan s\dua metode, yaitu metode tahap awal melalui pengukuran dosis mula-mula. Dan metode kedua melaui penyinaran detektor dan langsung terbaca pada multimeter *X-ray RaySafe*. Dari hasil penelitian pada pengukuran kualitas berkas dengan menggunakan filter aluminium dan pengukuran kualitas berkas dengan menggunakan multimeter *X-ray RaySafe* semua nilai kualitasnya masih dalam batas toleransi yang diizinkan oleh Bapeten dari acuan *Government of Western Australia* sehingga kedua jenis metode ini dapat dilakukan karena tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: Kualitas berkas radiasi, filter aluminium, Pesawat sinar-X mammografi dan multimeter X-ray RaySafe.

ABSTRACT

NAME : DEWI KARTIKA LESTARI
NIM : 60400112057
TITLE : STUDY OF QUALITY DETERMINATION OF RADIATION OF MAMMOGRAPHY X-RAY RADIATION IN MAKASSAR CITY HOSPITAL

This study aims to find out the quality of mammography X-ray radiation beam by using aluminum filter and through X-ray multimeter measurement. The study used a Lylium analog mammography plane, a RaySafe X-ray multimeter, a 99% purity waterpass and aluminum filter. To measure the quality of the radiation beam used two methods, namely the initial stage method through the initial dose measurement. And the second method is by irradiation of the detector and directly readable on the RaySafe X-ray multimeter. From the results of the research on the measurement of the quality of the beam by using aluminum filter and the measurement of the quality of the file using RaySafe X-ray multimeter all the quality values are still within the limits permitted by Bapeten from Government of Western Australia's reference so that both types of methods can be done because they have no significant.

Keywords: radiation beam quality, aluminum filter, mammography X-ray plane and RaySafe X-ray multimeter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sinar-X ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Rontgen seseorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1895. Sinar-X mempunyai panjang gelombang 0,01 nm – 10 nm, sehingga sinar-X mempunyai daya tembus yang sangat besar. Sinar-X banyak digunakan dalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit dalam tubuh manusia, perkembangan sinar-X dalam dunia medik mempunyai dampak positif dan negatif. Dimana dampak positifnya dapat membantu pihak medik mengetahui penyakit dalam tubuh manusia sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel dalam tubuh manusia jika dosis radiasi yang masuk berlebih atau diatas batas normal yang telah ditetapkan pihak Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

Salah satu pesawat yang menggunakan bantuan sinar-X yaitu pesawat sinar-X mammografi. Mammografi adalah salah pesawat sinar-X yang berfungsi sebagai alat pendeteksi dini atau *screening* untuk mendiagnosis kanker payudara menggunakan sinar-X dosis rendah. Pesawat sinar-X mammografi mampu memperlihatkan kelainan pada payudara dalam bentuk yang terkecil hingga kurang dari 5 mm (stadium nol). Pada stadium ini, mammografi dapat memperlihatkan adanya suatu benjolan yang tidak dapat teraba baik oleh perempuan itu sendiri maupun dokter sekalipun, hingga benjolan tersebut berukuran 1 cm atau lebih.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Susiana Sidabutar tahun 2012, yakni melakukan penelitian tentang “Kontrol Kualitas Sistem Mammografi Digital DR” adapun tujuan yang dilakukan yaitu untuk menerapkan protokol kontrol kualitas yang ditetapkan International Atomic Energy Agency (IAEA), melakukan evaluasi kualitas citra pada DR, dan mengetahui estimasi *Mean Grandular Dose* (MGD).

Kualitas berkas merupakan kemampuan daya tembus atau energi yang dibutuhkan sinar-X untuk menembus suatu objek. Untuk sebuah pesawat radiologi diagnostik (mammografi), kualitas berkas radiasi dikarakterisasi secara numerik dengan nilai tebal paruh atau *Half Value Layer* (HVL). Studi penentuan kualitas pesawat sinar-X mammografi terbagi atas dua. Pertama, kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium dimana filter aluminium ini berperan sebagai pengganti payudara manusia atau dengan kata lain sebagai simulator payudara. Pengujian ini merupakan pengujian yang ditetapkan oleh Bapeten untuk menentukan nilai HVL dan dilaksanakan oleh pihak Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Kedua, pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* atau tanpa menggunakan filter. Dimana pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui nilai HVL yang terbaca pada detektor atau multimeter *X-ray*. Pengujian ini belum pernah dilakukan oleh pihak BPFK sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Bapeten.

Nilai batas toleransi sangat penting untuk diketahui karena berhubungan dengan kualitas elektron yang menebus payudara seorang pasien. Jika elektron

yang menembus payudara diatas batas nilai yang ditetapkan dapat berakibat fatal salah satunya dapat mengakibatkan kanker pada payudara.

Berdasarkan informasi di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang **“Studi Penentuan Kualitas Berkas Radiasi Pesawat Sinar-X Mammografi di RSUD Kota Makassar”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium dan dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium?
- b. Bagaimana kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan pengukuran langsung menggunakan multimeter *X-ray*?
- c. Bagaimana perbandingan antara kualitas berkas pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium dan kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung menggunakan multimeter *X-ray*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui kualitas berkas radiasi pesawat sinar-x mammografi dengan menggunakan filter aluminium.
- b. Untuk mengetahui kualitas berkas radiasi pesawat sinar-x mammografi dengan pengukuran multimeter *X-ray*.

- c. Untuk mengetahui perbandingan antara kualitas berkas pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium dan kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung menggunakan multimeter X-ray.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan di ruang Radiologi RSUD. Kota Makassar.
- b. Jenis pesawat yang digunakan yaitu pesawat sinar-X Mammografi yang hanya digunakan pada payudara manusia.
- c. Alat ukur yang digunakan multimeter *X-ray RaySafe*.
- d. Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X menggunakan filter aluminium.
- e. Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X dengan pengukuran multimeter *X-ray*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat fungsi pesawat sinar-X mammografi sebagai alat pendeteksi kanker payudara.
- b. Untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pada saat dilakukan uji kesesuaian khususnya pada pengukuran nilai HVL agar dapat dilakukan secara otomatis tidak lagi menggunakan pengukuran secara manual.
- c. Mengefisiensikan penggunaan eksposur pada pesawat sinar-X mammografi.

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sinar-X

Sinar-X ditemukan oleh *Wilhelm Conrad Rontgen* seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1895. Penemuannya diilhami dari hasil percobaan percobaan sebelumnya antara lain dari J.J Thomson mengenai tabung katoda dan Heinrich Hertz tentang foto listrik. Kedua percobaan tersebut mengamati gerak elektron yang keluar dari katoda menuju ke anoda yang berada dalam tabung kaca yang hampa udara. Pembangkit sinar-X berupa tabung hampa udara yang di dalamnya terdapat filament yang juga sebagai katoda dan terdapat komponen anoda. Jika filamen dipanaskan maka akan keluar elektron dan apabila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang tinggi, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Dengan percepatan elektron tersebut maka akan terjadi tumbukan tak kenyal sempurna antara elektron dengan anoda, akibatnya terjadi pancaran radiasi sinar-X (Suyatno, 2008: 503).

Peristiwa terjadinya sinar-X diawali dari percobaan Heinrich Hertz pada tahun 1887 dengan menggunakan tabung hampa yang berisi katoda dan anoda. Katoda dan anoda dihubungkan dengan sumber listrik E. Pada tegangan, E, yang rendah tidak ada arus elektron dari katoda ke anoda yang dapat dilihat dari galvanometer. Pada saat katoda disinari gelombang pendek elektromagnetik ternyata dari katoda keluar elektron menuju anoda yang diamati dari galvanometer. Arus yang terbaca di Galvanometer adalah arus yang sangat kecil dalam order mikro ampere. Peristiwa di atas disebut dengan efek foto listrik.


Kecuali disinari dengan gelombang pendek elektron dapat keluar dari katoda dengan cara dipanaskan sehingga terjadi emisi termis. Jadi dengan cara dipanaskan atau diberi gelombang pendek elektromagnetik katoda dapat memancarkan elektron lebih banyak. Makin pendek gelombang elektromagnetik yang menumbuk katoda, maka makin besar arus yang mengalir dan sebaliknya makin panjang gelombangnya, makin kecil arus yang terbaca di galvanometer. Hal demikian dapat dipahami karena bila gelombang elektromagnetik panjang gelombangnya makin pendek berarti frekuensinya makin besar dan energinya juga makin besar.

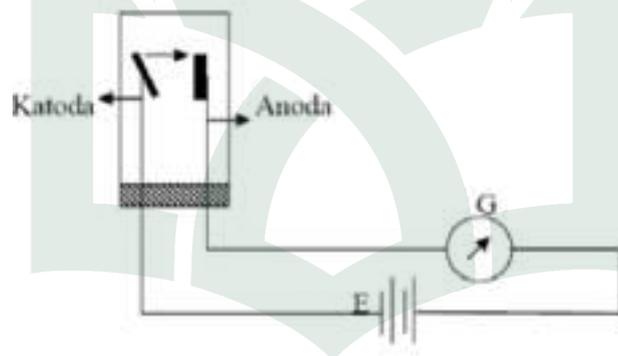

Gambar 2.1 Alat Foto Listrik

(Sumber: Bambang, 1986)

Sinar-X dihasilkan dari tabung Sinar-X, yang merupakan suatu alat untuk menghasilkan elektron bebas, mempercepat dan akhirnya menumbuk suatu target, seperti pada Gambar 2.2.

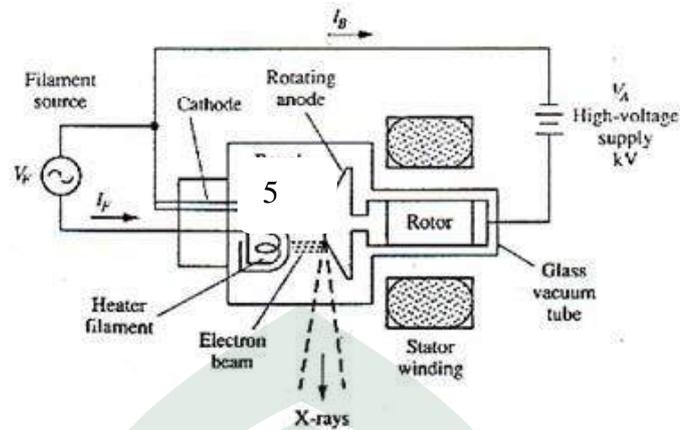

Gambar 2.2 Tabung Pesawat Sinar-X

(Sumber: <http://rasyanto.blogspot.co.id/p/ms-ct-scan-64-slices.html>)

Pada proses tumbukan tersebut, akan menghasilkan sinar-X kontinu (*bremstrahlung*) dan sinar-X karakteristik. Dua interaksi yang menghasilkan dua tipe sinar-X yaitu :


2.1.1 Sinar-X yang dihasilkan akibat perlambatan berkas elektron cepat dalam medan magnet atom anoda yang disebut sinar-X kontinyu atau sinar-X *bremstrahlung* yang mempunyai spektrum kontinyu.

2.1.2 Sinar-X yang dihasilkan akibat transisi elektron dari orbit tinggi ke orbit rendah dari atom anoda. Transisi elektron ini terjadi akibat adanya kekosongan elektron setelah ditumbuk oleh elektron berkecepatan tinggi. Sinar ini disebut dengan sinar-X karakteristik (DEPKES RI, 1999).

Pada dasarnya sinar-X merupakan pancaran berkas elektron dari katoda menuju anoda yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Sinar-X mempunyai panjang gelombang 0,01 nm – 10 nm, sehingga sinar-X mempunyai daya tembus yang sangat besar. Sinar-X dapat terjadi jika terdapat perbedaan potensial arus searah yang besar diantara kedua elektroda (katoda dan anoda)

dalam sebuah tabung hampa udara. Sinar-X adalah foton-foton yang mempunyai energi tinggi yang dihasilkan dengan menembaki suatu sasaran dengan elektron yang berenergi tinggi.

Pembuatan sinar-X yang berhubungan dengan pembangkitan panas akan lebih efisien pada tegangan tinggi dari pada tegangan rendah. Elektron dengan kecepatan tinggi menabrak target sehingga mengalami perpindahan dan mempercepat gerak elektron bagian dalam pada nukleus atom dengan menggunakan prinsip ionisasi atom. Menurut Hoxter elektron yang dipusatkan menuju permukaan anoda menumbuk sasaran yang akan mengakibatkan energi gerak elektron berubah menjadi sinar-X (1%) dan panas (99%). Sinar-X yang terjadi umumnya mempunyai energi yang berbeda-beda sesuai dengan energi kinetik elektron pada saat terbentuknya sinar-X dan juga tergantung pada arah pancarannya (Wirjosimin, 1995).

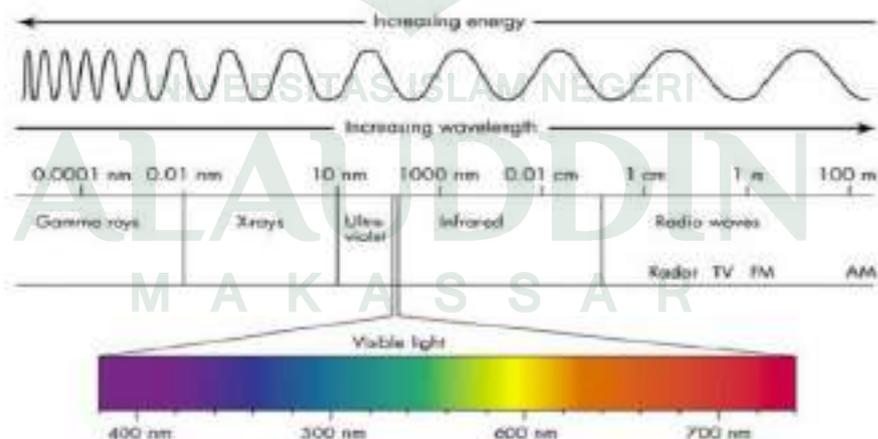

Gambar 2.3 Spektrum gelombang elektromagnetik
(Sumber : http://naqsdna.files.wordpress.com/2011/10/em_spectrum.jpg)

Spektrum merupakan ragam dari rentangan panjang dari suatu gelombang radiasi. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain.

Jenis-Jenis spektrum gelombang elektromagnetik ada 7 macam. Jenis tersebut dikategorikan berdasarkan besar frekuensi gelombangnya. Jika diurutkan dari frekuensinya yang paling besar ke yang paling kecil adalah:

1. Gelombang Radio

Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10^3 meter dengan frekuensi sekitar 10^4 Hertz. Sumber gelombang ini berasal dari rangkaian oscillator elektronik yang bergetar. Rangkaian oscillator tersebut terdiri dari komponen resistor (R), induktor (L), dan kapasitor (C). Spektrum gelombang radio dimanfaatkan manusia untuk teknologi radio, televisi, dan telepon.

2. Gelombang Mikro

Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10^{-2} meter dengan frekuensi sekitar 10^8 hertz. Gelombang ini dihasilkan oleh tabung klystron, kegunaannya sebagai penghantar energy panas. Salah satu contoh penggunaan gelombang micro yaitu pada oven microwave yang berupa efek panas untuk memasak. Gelombang micro dapat mudah diserap oleh suatu benda dan juga menimbulkan efek pemanasan pada benda tersebut. Selain itu, gelombang micro juga dapat digunakan untuk mesin radar.

3. Gelombang Infra Merah

Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10^{-5} meter dengan frekuensi sekitar 10^{12} hertz. Gelombang infra merah dihasilkan ketika molekul elektron bergetar karena panas, contohnya tubuh manusia dan bara api. Manfaat kegunaan lain yaitu untuk remote TV dan transfer data di ponsel.

4. Gelombang Cahaya Tampak

Sesuai namanya, spektrum ini berupa cahaya yang dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini memiliki panjang 0.5×10^{-6} meter dengan frekuensi 10^{15} hertz. Dan gelombang cahaya tampak sendiri terdiri dari 7 macam yang disebut warna. Jika diurutkan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.

5. Gelombang Ultra Violet

Gelombang UV memiliki panjang 10^{-8} meter dengan frekuensi 10^{16} hertz. Gelombang ini berasal dari matahari dan juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu mercury. Fungsi UV dapat bermanfaat dan dapat berbahaya bagi manusia. Salah satu contoh fungsi sinar UV adalah sebagai detector untuk membedakan uang asli dan uang palsu.

6. Gelombang Sinar X

Gelombang ini memiliki panjang 10^{-10} meter dan memiliki frekuensi 10^{18} hertz. Gelombang sinar X sering disebut juga dengan sinar rontgen, karena gelombang ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan rontgen di rumah sakit.

7. Gelombang Sinar Gamma

Gelombang ini memiliki panjang 10^{-12} meter dengan frekuensi 10^{20} hertz. Dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling besar dan serta panjang gelombang terkecil. Sehingga daya tembusnya sangat besar, bahkan bisa menembus plat besi. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat – alat kedokteran.

2.2 Proses Terjadinya Sinar-X

Tahapan proses terjadinya sinar-X sebagai berikut :

1. Katoda (*filamen*) dipanaskan (lebih dari 2000°C sampai menyala) dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator.
2. Karena panas, elektron-elektron dari katoda (*filamen*) terlepas.
3. Sewaktu panas dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan mempercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan ke alat pemusat (*focusing cup*).
4. Filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran (*target*) dengan memilih potensial tinggi.
5. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran (*target*) sehingga terbentuk panas ($>99\%$ dan sinar X $< 1\%$).
6. Pelindung (*perisai*) timah akan mencegah keluarnya sinar-X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela.

7. Panas yang tinggi pada sasaran (target) akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator pendingin.
8. Jumlah sinar-X yang dilepaskan setiap satuan waktu dapat dilihat pada alat pengukur miliampere (mA) sedangkan jangka waktu pemotretan dikendalikan oleh alat pengukur waktu (Rasad, 2005).

2.3 Sifat-Sifat Sinar-X

Sifat-sifat sinar-X telah terungkap pada percobaan rontgen yaitu sinar-X dapat memendarkan berbagai jenis bahan kimia dan juga dapat menembus materi yang tidak dapat ditembus oleh sinar yang lain. Sinar-X adalah gelombang elektromagnet dengan sifat-sifat utama sebagai berikut:

1. Sinar-X tidak dapat dilihat dengan mata.
2. Seperti gelombang elektromagnetik lainnya, sinar-X dapat merambat seperti halnya laju cahaya.
3. Sinar-X tidak dapat dideflesikan dengan lensa atau prisma dapat didefleksikan dengan kristal.
4. Sinar-X juga mengalami serapan selama proses transmisi di dalam bahan sehingga daya tembus sinar-X bergantung pada jenis materi dan energinya.
5. Sinar-X merupakan radiasi pengion sehingga mampu menghasilkan elektronelektron bebas di dalam materi.
6. Sinar-X dapat merubah jaringan tubuh (Rudi, 2012).

2.4 Efek Sinar-X

Penyerapan sinar-X oleh suatu bahan tergantung pada tiga faktor sebagai berikut.

1. Panjang gelombang sinar-X
2. Susunan obyek yang terdapat pada alur berkas sinar-X
3. Ketebalan dan kerapatan obyek

Jika kV rendah maka akan dihasilkan sinar-X dengan gelombang yang panjang dan sebaliknya dengan kV tinggi maka panjang gelombang sinar-X akan semakin pendek (Arif, 2008).

Sedangkan efek-efek radiasi berdasarkan jenis dosisnya yaitu :

2.4.1 Penyinaran dalam waktu singkat (akut) yang umumnya terjadi secara kebetulan (kecelakaan). Penyinaran akut yang melibatkan penyinaran dengan dosis tinggi dapat menimbulkan efek biologi seketika, yaitu efek yang kemunculannya kurang dari satu tahun sejak terjadinya penyinaran. Tetapi penyinaran akut dapat menimbulkan efek biologis tertunda apabila dosis radiasinya rendah.


2.4.2 Penyinaran oleh dosis radiasi rendah namun berlangsung terus –menerus (kronis). Penyinaran jenis ini biasanya tidak segera menampakkan efeknya, sehingga efek yang ditimbulkan disebut efek tertunda. Efek ini dapat muncul setelah beberapa tahun bahkan puluhan tahun sejak terjadinya penyinaran (Akhadi, 2000).

Persyaratan energi sinar-X rata-rata (efektif) untuk daerah jaringan payudara harus memenuhi kriteria bahwa energinya harus serendah mungkin,

tetapi masih memungkinkan untuk penetrasi payudara. Oleh karena itu perlu optimalisasi energi sinar- X rata-rata dalam hal :

1. Dosis serap harus serendah mungkin dengan menaikkan energi sinar-X.
2. Kontras meningkat seiring penurunan energi sinar-X.

Untuk payudara kecil perangkat mammografi dioperasikan pada tegangan 30 kV, yang berarti energi sinar-X efektif 18 sampai 20 kV, cukup memberikan keseimbangan antara dosis dan kontras, sedangkan untuk jaringan payudara tebal, sebaiknya energi sinar-X efektifnya sedikit ditingkatkan dan penggunaan filter yang berbeda. Dan pemilihan tabung sinar-X untuk mammografi optimalnya menggunakan tabung dengan anoda dan filter (0,03 mm) terbuat dari bahan Molybdenum (Mo), karena mempunyai karakteristik energi sinar-X efektifnya 17,9 keV dan 19,5 keV yang memberi keseimbangan antar dosis serap dan kontras seperti Gambar 3. (Garbet, 2013)

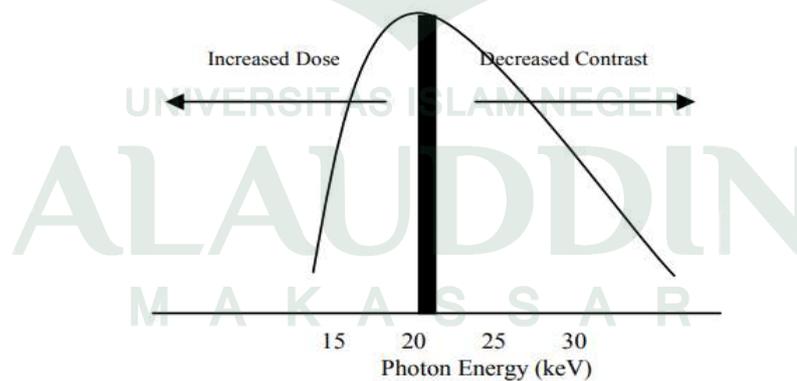

Gambar 2.4 Spektrum Energi Sinar-X Mammografi
(Sumber: <http://golum.riv.csu.edu.au>)

2.5 Radiasi

Radiasi merupakan pancaran energi melalui suatu materi dalam bentuk partikel atau gelombang. Ketika radiasi melewati suatu materi kemudian membentuk partikel bermuatan positif dan negatif, maka proses ini disebut radiasi ionisasi. Salah satu contoh radiasi ionisasi yaitu radiasi sinar-X. Radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel yang dipancarkan oleh sumber radiasi atau zat radioaktif. Radiasi sinar-X dihasilkan oleh tabung pesawat sinar-X karena sumbernya berasal dari luar tubuh manusia maka radiasi sinar-X merupakan radiasi eksternal. Dalam hal proteksi radiasi eksternal, terdapat tiga teknik untuk mengontrol penerimaan radiasi khususnya bagi pekerja radiasi yaitu meminimalkan jarak, meminimalkan waktu dan pemakaian perisai radiasi (Aryawijayanti, 2015).

Radiasi sinar-X dihasilkan oleh tabung pesawat sinar-X karena sumbernya berasal dari luar tubuh manusia maka radiasi sinar-X merupakan radiasi eksternal. Dalam hal proteksi radiasi eksternal terdapat tiga teknik untuk mengontrol penerimaan radiasi khususnya bagi pekerja radiasi yaitu meminimalkan jarak, meminimalkan waktu dan pemakaian perisai radiasi (Sugiratu, 2012).

Radiasi dijelaskan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nuur/24:35, yang berbunyi :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

وَلَا غَرَبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥)

Terjemahnya:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama, 2013 : 355)

Di dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa firman-Nya:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi...”

Ayat yang sangat menakjubkan ini, timbul bersama dengan cahaya yang tenang dan mencerahkan, sehingga tersebar keseluruh alam. Ia juga tersebar ke seluruh perasaan dan anggota-anggota badan. Ia mengalir ke seluruh sisi dan aspek kehidupan. Sehingga, seluruh alam semesta bertasbih dalam lautan cahaya yang sangat terang disebabkan karena Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala, maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan dan lain-lain yang dirasakan dengan mata hati.

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT memberikan kita (hambah-Nya) cahaya untuk kita pergunakan sebaik mungkin di mana cahaya begitu penting bagi umat manusia, tanpa cahaya kita tidak dapat melihat apa yang ada di dunia ini. Cahaya juga sangat penting bagi dunia medis dimana sinar-X merupakan salah satu wujud pengaplikasian dari cahaya. Baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala, maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan serta timbul bersama dengan cahaya yang tenang dan mencerahkan, sehingga tersebar keseluruh alam. Ia juga tersebar ke seluruh perasaan dan anggota-anggota badan. Berkat sinar-X para pekerja di dunia medis dapat mendiagnosa berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, dan salah satu pengaplikasian sinar-X terdapat pada pesawat sinar-X mammografi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung dari tubuh seseorang yang ditembakkan radiasi.

Efek radiasi berlebih dapat dianalogikan pada firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Qiyamah/75 Ayat 26-30:

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۚ ۲۶ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۚ ۲۷ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ ۲۸
وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۚ ۲۹ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۚ ۳۰

Terjemahnya:

Tidak! Apabila (nyawa) telah sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan (dengan dunia). dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan). kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau (Kementrian Agama, 2013 : 578).

Ini adalah pemandangan saat menjelang kematian, saat sakaratul-maut, yang dihadapkan oleh Al-Qur'an kepada mereka, seakan-akan kematian itu sedang terjadi, dan seakan-akan dia sedang keluar dari celah-celah lafal dan sedang bergerak sebagaimana keluarnya sifat-sifat lukisan itu dari celah-celah sentuhan kuas.

“Sekali-kali jangan! Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan....”

Ketika ruh sampai ke kerongkongan pada waktu *naza'* terakhir, ketika sedang terjadi sakaratul-maut yang menakutkan dan membingungkan, ketika sedang terjadi kesedihan luar biasa yang menjadikan pandangan tidak normal lagi..., dan orang-orang yang hadir memandangi ke kanan dan kiri mencari jalan untuk menyelamatkan ruh yang sedang sedih itu, *“Dan katakan (kepadanya), ‘Siapakah yang dapat menyembuhkan?’”* ... Barangkali ada jampi-jampi yang berguna...! Melingkar-lingkarlah orang yang sedang susah itu karena sekarat dan *naza'*..., *“Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan).”*... Batallah segala upaya tak berguna segala sarana, dan menjadi jelaslah jalan satu-satunya yang setiap makhluk hidup dihalau ke sana pada akhir perjalanan hidupnya, *“Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.”*

Pemandangan ini hampir-hampir bergerak dan berkata-kata, setiap ayat melukiskan gerakan, setiap alinea mengeluarkan kilatan cahaya, dan kondisi saat sakaratul-maut terlukis dan melukiskan ketakutan, kebingungan, dan kesedihan menghadapi kenyataan yang keras (tidak dapat ditawar-tawar) dan pahit, yang

tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari, “*Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau...*”(Al-Qiyamah:30).

Apabila pemandangan-pemandangan ini meninggalkan kesan yang kuat di dalam jiwa, karena kuatnya hakikat yang terkandung di dalamnya, dan kuatnya penyampaian Al-Qur’an yang mempersonifikasikannya dan menghidupkan nuansanya, maka sesudah membentangkan pemandangan-pemandangan itu surah ini mendekatkan berbagai sisinya sehingga menyentuh perasaan orang-orang yang menjadi sasaran pembicaraan dengan pemandangan lain yang sering terjadi berulang-ulang, yang tidak dibiarkannya berlalu begitu saja sehingga dihadapkannya kepada mereka di bumi ini dengan kekuatannya, kejelasannya, dan timbangan yang berat (Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an, 1992).

Dari ayat di atas Allah SWT telah memperlihatkan efek radiasi yang dipancarkan terus menerus maka dapat menyebabkan beberapa efek diantaranya kerusakan pada sel-sel dalam tubuh dan akhirnya menyebabkan kematian. Sungguh kematian itu adalah hal yang menakutkan bagi sebagian orang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah sehingga setiap hambah-Nya memperteguh keimanan-Nya. Salah satunya adalah mempelajari ilmu-Nya untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat manusia dalam hal ini menggunakan sinar-X yang terdapat pada pesawat sinar-X mammografi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung dari tubuh seseorang yang ditembakkan radiasi.

2.6 Sistem Proteksi Radiasi

Karena adanya efek-efek yang sangat membahayakan bagi manusia yang terkena paparan radiasi maka untuk mengeliminir efek yang diakibatkan maka perlunya sistem proteksi radiasi. Untuk menentukan sistem proteksi, pengawasan dan standar proteksi radiasi maka terdapat lembaga/badan-badan yang menentukan standar proteksi radiasi yaitu :

1. Komisi Internasional proteksi radiasi Komisi internasional proteksi radiasi, *International Commission on Radiological Protection (ICRP)* adalah badan yang mempunyai tugas untuk menciptakan pedoman dalam hal keselamatan radiasi, membahas prinsip-prinsip dasar proteksi radiasi dan kepada berbagai komite proteksi nasional memberikan tanggung jawab untuk memperkenalkan aturan-aturan teknis.
2. Perwakilan tenaga atom internasional.
3. Komisi satuan dan pengukuran radiologi internasional.
4. Dewan proteksi radiasi.
5. Batan (Badan Tenaga Nuklir). Badan inilah yang mengawasi sistem proteksi dalam bidang radiologi secara nasional (Muhlis, 2000).

Untuk menurunkan dosis serap terhadap pasien dan paparan terhadap personil, prinsip proteksi radiasi meliputi waktu, jarak dan perisai radiasi harus diterapkan dengan benar. Paparan radiasi secara langsung dihubungkan dengan waktu paparan, sedemikian sehingga dengan mengurangi waktu paparan separuhnya maka mengurangi dosis separuhnya. Oleh karena berkas sinar-X

berbeda setelah melalui bahan, maka intensitas radiasi berkurang yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber radiasi tersebut (Togap, 2006).

2.7 Pesawat Mammografi

Mammografi merupakan salah satu peralatan radiodiagnostik yang memanfaatkan sinar-X untuk membentuk citra organ payudara pada lembar film radiografi. Sinar-X berenergi rendah akan menembus organ '*mammae*' yang dikompresi sehingga akan menimbulkan efek pada film yang diletakkan di bawahnya. *Image* (citra) dari organ payudara yang terbentuk pada film dapat digunakan untuk deteksi adanya kanker diantara jaringan normal.



Gambar 2.5 Pesawat Sinar-X Mammografi

(Sumber: <http://ilmuradiologi.blogspot.co.id/2011/08/pesawat-sinar-x.html>)

Mammografi adalah proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar dosis rendah (umumnya berkisar 0,7 mSv). Mammografi digunakan untuk melihat beberapa tipe tumor dan kista, dan telah terbukti dapat

mengurangi mortalitas akibat kanker payudara. Selain mammografi, pemeriksaan payudara sendiri dan pemeriksaan oleh dokter secara teratur merupakan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan payudara. Beberapa negara telah menyarankan mammografi rutin (1-5 tahun sekali) bagi perempuan yang telah melewati paruh baya sebagai metode *screening* untuk mendiagnosa kanker payudara sedini mungkin (www.wikipedia.com).

Sebagaimana penggunaan sinar-X lainnya, mammogram menggunakan radiasi ion untuk menghasilkan gambar. Radiolog kemudian menganalisa gambar untuk menemukan adanya pertumbuhan yang abnormal. Walaupun teknologi mammografi telah banyak mengalami kemajuan dan inovasi, ada komunitas medis yang meragukan penggunaan mammografi karena tingkat kesalahan yang masih tinggi dan karena radiasi yang digunakan dapat menimbulkan bahaya.

Diketahui bahwa sekitar 10 % kasus kanker tidak terdeteksi dengan mammografi (*missed cancer*). Hal itu disebabkan antara lain oleh jaringan normal yang lebih tebal disekitar kanker, atau menutupi jaringan kanker sehingga jaringan kanker tidak terlihat.

Mammografi adalah foto payudara dengan sinar X dosis rendah. Pada mammografi dapat dilihat gambaran payudara secara keseluruhan. Mammografi merupakan alat yang terbaik untuk deteksi dini kanker payudara, karena sinar X pada mammografi mempunyai kemampuan menembus jaringan payudara yang mengalami kelainan berupa tumor dan menunjukkan kelainan dalam payudara tersebut secara memuaskan. Faktor-faktor yang dilihat pada saat pemeriksaan mammografi antara lain:

1. *Intermediate Findings*

Variabel yang menjelaskan keadaan sel atau jaringan yang terdapat dalam payudara, dimana variabel ini terdiri dari lima indikator yaitu *well defined*, *developing*, *architectural*, *skin thickening*, dan *asymetry*. Seorang wanita yang melakukan pemeriksaan mammografi memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu indikator atau tidak sama sekali pada variabel ini.

2. *Suspicious for Malignancy*

Variabel yang menjelaskan bentuk tumor yang terdapat dalam payudara atau tanda-tanda keganasan yang terlihat pada payudara, dimana variabel ini terdiri dari tiga indikator yaitu *mass*, *calcification*, dan *speculated sign*.

3. *BIRADS Category*

Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) digunakan untuk memprediksi tingkat keganasan pasien kanker payudara dalam skrining mammografi.

4. Letak abnormal

Akan dilihat letak dimana ada perubahan yang tidak wajar pada payudara kanan atau payudara kiri (Novianti, 2012).

2.7.1 Jenis Pesawat Mammografi

Terdapat dua jenis mammografi yaitu sebagai berikut:

- a. *Screen-film* mammografi, seperti halnya rontgen menggunakan film yang harus dicetak.

- b. *Full-field* mammografi, hasilnya dapat dilihat di monitor secara digital dan dapat dicetak jika diperlukan (*Government of Western Australia*, 1975).

2.7.2 Prinsip Kerja Mammografi

Prinsip kerjanya adalah pesawat mammografi yang digunakan kapasitas tegangan tabung rendah dan mAs yang tinggi. Tabung *X-ray* pada pesawat mammografi dengan target molibdenum (produksi energi rendah). Ada filter untuk mendapatkan kualitas berkas yang sesuai dengan keperluan yang digunakan adalah molybdenum. Focal spot yang ukurannya kecil yang diperlukan untuk mendapatkan ketajaman gambar. Pesawat mammografi mempunyai kombinasi berkas yang membatasi luas lapangan penyorotan. Pesawat mammografi dilengkapi dengan adanya kompresi *mammae* yang fungsinya untuk mengompresi *mammae* dan menahan payudara agar tidak bergerak. *Grid* yang berfungsi untuk mengurangi sinar hambur diantara obyek dan film, pada tempat kaset dimasukkan kaset yang berisi tunggal dengan kualitas tinggi dan berisi film beremulsi tunggal mengurangi paparan radiasi, sehingga gambaran lebih baik. Phototimer detektor diletakkan di bawah kaset seluruh otomatis. Detektor mengukur kV yang optimal dan filtrasi dari sebuah penyorotan. Tabung sinar-X sudah terpasang bersama-sama dengan reseptor citra dan sandaran payudara, serta komponen pelengkap yang dapat diputar terhadap sumbu horisontal untuk mencapai proyeksi radiografi yang diharapkan. Tabung sinar-X memiliki *focal spot* yang kecil dan menghasilkan spektrum sinar-X yang berenergi rendah. Kolimasi lapangan radiasi dan posisi fokus tabung dibuat vertikal terhadap pasien.

Konfigurasi ini bertujuan untuk memastikan visualisasi yang maksimum dari jaringan payudara. Sumbu katoda-anoda dibuat pada arah dinding dada sampai *nipple* sehingga efek heel memberikan banyak foton dalam daerah payudara yang paling tebal dan transmisi fotonnya paling rendah. Kompresi yang dibuat menggunakan piringan kompresi plastik bertujuan untuk mengurangi ketebalan payudara dan meletakkannya pada posisi yang benar sehingga proyeksi radiografi yang diharapkan dapat tercapai. Piringan kompresi dan meja sandaran payudara harus memiliki transmisi sinar-X yang tinggi. Meja sandaran payudara terdiri dari kombinasi film/*screen* mamografi atau reseptor digital. Meja tersebut juga bergabung dengan sebuah *grid* anti hamburan. Dalam banyak sistem, spektrum sinar-X dipilih secara otomatis berdasarkan ketebalan payudara dan transmisi melalui payudara (Chapter, 2011).

2.8 Komponen Pesawat Mammografi

Pesawat harus memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang bertelusur yang diterbitkan. Pesawat sinar-X mamografi terdiri dari: tabung, pembangkit tegangan, panel kontrol, dan perangkat lunak. Perangkat penunjang terdiri atas komponen: tiang penyangga, kolimator, instrumentasi tegangan, dan tabir. Verifikasi keselamatan, meliputi: pemantauan paparan radiasi, uji kesesuaian pesawat sinar-X, dan identifikasi terjadinya paparan potensial.



Gambar 2.6 Bagian-Bagian Pesawat Sinar-X Mammografi
(Sumber: dokumen pribadi)

Pemeriksaan mammografi memerlukan seperangkat pesawat sinar-X yang mempunyai komponen khusus. Hal ini dikarenakan organ yang diperiksa mempunyai struktur yang khusus berupa soft tissue atau jaringan lunak.

Adapun bagian-bagian pesawat mammografi adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas pesawat

Pesawat mammografi yang digunakan mempunyai kapasitas tegangan tabung rendah (25 –35 kVp) dan mAs yang tinggi. Jenis-jenis mAs total pada pesawat mammografi adalah sebagai berikut:

- a. *Low speed film* (2000 mAs)
- b. *Intermediate non screen film* (500 mAs)
- c. *Convensional non screen film* (200 mAs).

Penggunaan faktor eksposi berupa kV rendah diikuti dengan peningkatan mAs, dimaksudkan untuk mendapatkan kontras yang tinggi dalam radiograf.

2. Ukuran *focal spot*

Ukuran *focal spot* dari pesawat mammografi antara 0,1 sampai 0,6 mm. Ukuran *focal spot* kecil diperlukan untuk mendapatkan ketajaman yang baik dari organ. Pesawat mammografi biasanya dibuat sistem anoda putar dan bahan dari tungsten atau molybdenum untuk memungkinkan penggunaan fokus kecil pada pembebanan arus tabung.

3. Pembatas sinar

Pembatas sinar pada pesawat mammografi berupa conus yang dapat diganti-ganti sesuai dengan besarnya ukuran payudara.

4. Filter

Filter pada pesawat mammografi dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas berkas yang sesuai dengan keperluan, sehingga sinar-X yang mempunyai panjang gelombang tinggi akan diserap oleh filter. Filter yang digunakan adalah molybdenum dengan ketebalan 0,03 sampai 0,5 mmAl.

5. Alat kompresi

Alat kompresi pada pesawat mammografi berfungsi untuk menghilangkan kerutan-kerutan pada kulit, menahan bagian payudara agar tidak bergerak, dan untuk mendapatkan penampang payudara yang lebih luas. Alat ini dibuat dari bahan yang intensitasnya homogen sehingga tidak memberikan bayangan yang mengganggu gambaran.

6. *Grid*

Grid berfungsi untuk mengurangi sinar hambur diantara obyek dan film. Pesawat mammografi biasanya menggunakan grid dengan ratio 3,5 : 1. Grid yang

digunakan yaitu grid yang bergerak dan pergerakannya sudah diatur oleh pesawat.

7. Film

Film yang digunakan dalam mamografi biasanya non screen dengan emulsi tunggal (single emulsi) tanpa lembaran penguat, diletakkan dalam suatu amplop. Film ini berukuran 15 x 20 cm (<https://kumpulsore.blogspot.co.id/2014/02>).


Pada perangkat yang konvensional, film dalam kaset digunakan sebagai penangkap citra/gambar. Film hasil pencitraan/mammogram akan dilihat oleh ahli radiologi menggunakan kotak cahaya dan kemudian disimpan dalam jaket sebagai arsip. Sebelum menjadi mamogram, diperlukan proses kimiawi (pencucian film) sehingga hasil tidak segera dapat dilihat. Pada perangkat yang lebih modern, sebagai pengganti film, biasanya digunakan detektor sinar-X seperti flat panel detektor yang berbasis silikon.

Penggunaan flat panel detektor, memungkinkan ahli radiologi atau dokter segera mendapatkan hasil pencitraan/ mammogram dalam bentuk citra digital karena akuisisi gambar cepat (kurang dari satu menit) dan waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Mammogram digital memudahkan dalam penyimpanan, pembesaran, orientasi, kecerahan. Manfaat ini termasuk peningkatan kontras antara jaringan payudara yang padat dan non-padat. Setelah pemeriksaan selesai untuk lebih akurat dalam mendeteksi kanker payudara, dokter dapat memanipulasi gambar payudara, memperbaiki under atau *over-exposure* citra tanpa harus mengulang pemeriksaan. Mammogram digital juga memudahkan pengiriman dan

penyebaran informasi antara dokter dan atau ahli radiologi melalui jaringan internet untuk konsultasi jarak jauh dengan dokter lain. Manfaat lebih perangkat mamografi digital selain dosis radiasi yang lebih rendah, juga sensitivitas yang lebih tinggi dibanding mamografi konvensional (Santoso, 2013).

2.9 Kanker Payudara

Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Selain itu, kanker payudara (Carcinoma mammae) didefinisikan sebagai suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal dari parenchyma (<http://www.tempo.co.id/medika/arsip/082002/pus-3.htm>).

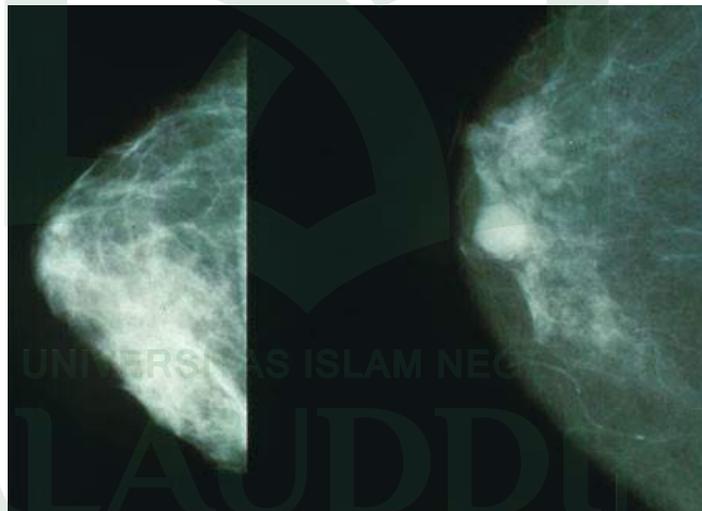

Gambar 2.7 Mammogram yang menunjukkan payudara normal (kiri) dan payudara dengan kanker (kanan)

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/kanker_payudara)

2.9.1 Gejala klinis kanker payudara

Gejala klinis kanker payudara dapat berupa:

1. Benjolan pada payudara

Umumnya berupa benjolan yang tidak nyeri pada payudara. Benjolan itu mula-mula kecil, semakin lama akan semakin besar, lalu melekat pada kulit atau menimbulkan perubahan pada kulit payudara atau pada puting susu.

2. Erosi atau eksema puting susu

Kulit atau puting susu tadi menjadi tertarik ke dalam (retraksi), berwarna merah muda atau kecoklat-coklatan sampai menjadi oedema hingga kulit kelihatan seperti kulit jeruk, mengkerut, atau timbul borok (ulkus) pada payudara. Borok itu semakin lama akan semakin besar dan mendalam sehingga dapat menghancurkan seluruh payudara, sering berbau busuk, dan mudah berdarah. Ciri-ciri lainnya antara lain:

- Pendarahan pada puting susu.
- Rasa sakit atau nyeri pada umumnya baru timbul apabila tumor sudah besar, sudah timbul borok, atau bila sudah muncul metastase ke tulang-tulang.
- Kemudian timbul pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, bengkak (edema) pada lengan, dan penyebaran kanker ke seluruh tubuh.

Kanker payudara lanjut sangat mudah dikenali dengan mengetahui kriteria operabilitas Heagensen sebagai berikut:

- terdapat edema luas pada kulit payudara (lebih 1/3 luas kulit payudara);
- adanya nodul satelit pada kulit payudara;
- kanker payudara jenis *mastitis karsinimatosa*;

- terdapat *nodul supraklavikula*;
- adanya *edema* lengan;
- adanya metastase jauh;
- serta terdapat dua dari tanda-tanda *locally advanced*, yaitu ulserasi kulit, *edema* kulit, kulit terfiksasi pada dinding toraks, kelenjar getah bening aksila berdiameter lebih 2,5 cm, dan kelenjar getah bening aksila melekat satu sama lain.

3. Keluarnya cairan (*Nipple discharge*)

Nipple discharge adalah keluarnya cairan dari puting susu secara spontan dan tidak normal. Cairan yang keluar disebut normal apabila terjadi pada wanita yang hamil, menyusui dan pemakai pil kontrasepsi. Seorang wanita harus waspada apabila dari puting susu keluar cairan berdarah cairan encer dengan warna merah atau coklat, keluar sendiri tanpa harus memijit puting susu, berlangsung terus menerus, hanya pada satu payudara (unilateral), dan cairan selain air susu.

2.9.2 Faktor-faktor penyebab

Faktor-faktor penyebab terjadinya kanker payudara antara lain:

1. Faktor risiko

Penyebab spesifik kanker payudara masih belum diketahui, tetapi terdapat banyak faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kanker payudara diantaranya:

- Faktor reproduksi: Karakteristik reproduktif yang berhubungan dengan risiko terjadinya kanker payudara adalah nuliparitas, menarche pada umur muda,

menopause pada umur lebih tua, dan kehamilan pertama pada umur tua. Risiko utama kanker payudara adalah bertambahnya umur. Diperkirakan, periode antara terjadinya haid pertama dengan umur saat kehamilan pertama merupakan perkembangan kanker payudara. Secara anatomi dan fungsional, payudara akan mengalami atrofi dengan bertambahnya umur. Kurang dari 25% kanker payudara terjadi pada masa sebelum menopause sehingga diperkirakan awal terjadinya tumor terjadi jauh sebelum terjadinya perubahan klinis.

- Penggunaan hormon: Hormon estrogen berhubungan dengan terjadinya kanker payudara. Laporan dari *Harvard School of Public Health* menyatakan bahwa terdapat peningkatan kanker payudara yang signifikan pada para pengguna terapi *estrogen replacement*. Suatu metaanalisis menyatakan bahwa walaupun tidak terdapat risiko kanker payudara pada pengguna kontrasepsi oral, wanita yang menggunakan obat ini untuk waktu yang lama mempunyai risiko tinggi untuk mengalami kanker payudara sebelum menopause. Sel-sel yang sensitive terhadap rangsangan hormonal mungkin mengalami perubahan degenerasi jinak atau menjadi ganas.
- Penyakit fibrokistik: Pada wanita dengan adenosis, fibroadenoma, dan fibrosis, tidak ada peningkatan risiko terjadinya kanker payudara. Pada hiperplasis dan papiloma, risiko sedikit meningkat 1,5 sampai 2 kali. Sedangkan pada hiperplasia atipik, risiko meningkat hingga 5 kali.
- Obesitas: Terdapat hubungan yang positif antara berat badan dan bentuk tubuh dengan kanker payudara pada wanita pasca menopause. Variasi

terhadap kekerapan kanker ini di negara-negara Barat dan bukan Barat serta perubahan kekerapan sesudah migrasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh diet terhadap terjadinya keganasan ini.

- **Konsumsi lemak:** Konsumsi lemak diperkirakan sebagai suatu faktor risiko terjadinya kanker payudara. Willett dkk, melakukan studi prospektif selama 8 tahun tentang konsumsi lemak dan serat dalam hubungannya dengan risiko kanker payudara pada wanita umur 34 sampai 59 tahun.
- **Radiasi:** Eksposur dengan radiasi ionisasi selama atau sesudah pubertas meningkatkan terjadinya risiko kanker payudara. Dari beberapa penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa risiko kanker radiasi berhubungan secara linier dengan dosis dan umur saat terjadinya eksposur.
- **Riwayat keluarga dan faktor genetik:** Riwayat keluarga merupakan komponen yang penting dalam riwayat penderita yang akan dilaksanakan skrining untuk kanker payudara. Terdapat peningkatan risiko keganasan pada wanita yang keluarganya menderita kanker payudara. Pada studi genetik ditemukan bahwa kanker payudara berhubungan dengan gen tertentu. Apabila terdapat *BRCA 1*, yaitu suatu gen kerentanan terhadap kanker payudara, probabilitas untuk terjadi kanker payudara sebesar 60% pada umur 50 tahun dan sebesar 85% pada umur 70 tahun. Faktor Usia sangat berpengaruh -> sekitar 60% kanker payudara terjadi di usia 60 tahun. Resiko terbesar usia 75 tahun.

2. Faktor Genetik

Kanker payudara dapat terjadi karena adanya beberapa faktor genetik yang diturunkan dari orangtua kepada anaknya. Faktor genetik yang dimaksud adalah

adanya mutasi pada beberapa gen yang berperan penting dalam pembentukan kanker payudara gen yang dimaksud adalah beberapa gen yang bersifat onkogen dan gen yang bersifat mensupresi tumor. Gen pensupresi tumor yang berperan penting dalam pembentukan kanker payudara diantaranya adalah gen BRCA1 dan gen BRCA2. Dimana BRCA ini adalah singkatan dari *Breast Cancer Susceptibility Gen*.

2.9.3 Pengobatan Kanker Payudara

Ada beberapa pengobatan kanker payudara yang penerapannya banyak tergantung pada stadium klinik penyakit, yaitu:

1. Mastektomi: Mastektomi adalah operasi pengangkatan payudara. Ada 3 jenis mastektomi, antara lain:
 - *Modified Radical Mastectomy*, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara, jaringan payudara di tulang dada, tulang selangka dan tulang iga, serta benjolan di sekitar ketiak.
 - *Total (Simple) Mastectomy*, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara saja, tetapi bukan kelenjar di ketiak.
 - *Radical Mastectomy*, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari payudara. Biasanya disebut lumpectomy, yaitu pengangkatan hanya pada jaringan
 - Yang mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. Operasi ini selalu diikuti dengan pemberian radioterapi. Biasanya lumpectomy direkomendasikan pada pasien yang besar tumornya kurang dari 2 cm dan letaknya di pinggir payudara.

2. Radiasi

Penyinaran/radiasi adalah proses penyinaran pada daerah yang terkena kanker dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma yang bertujuan membunuh sel kanker yang masih tersisa di payudara setelah operasi. Efek pengobatan ini tubuh menjadi lemah, nafsu makan berkurang, warna kulit di sekitar payudara menjadi hitam, serta Hb dan leukosit cenderung menurun sebagai akibat dari radiasi.

3. Kemoterapi

Kemoterapi adalah proses pemberian obat-obatan anti kanker atau sitokina dalam bentuk pil cair atau kapsul atau melalui infus yang bertujuan membunuh sel kanker melalui mekanisme kemotaksis. Tidak hanya sel kanker pada payudara, tapi juga di seluruh tubuh. Efek dari kemoterapi adalah pasien mengalami mual dan muntah serta rambut rontok karena pengaruh obat-obatan yang diberikan pada saat kemoterapi.

2.10 Kualitas Berkas Radiasi/ *Half Value Layer* (HVL)

Kualitas sinar-x diidentifikasi secara numerik dengan HVL. HVL dipengaruhi oleh pengoperasian kVp dan jumlah filtrasi pada paparan yang berguna. Kualitas sinar-x demikian dipengaruhi oleh kVp dan filtrasi. Faktor ini yang mempengaruhi kualitas paparan juga mempengaruhi kontras film radiografi. Dalam radiologi kualitas sinar x ditandai dengan Half Value Layer (HVL). HVL dari sinar x adalah ketebalan dari penyerapan pada bahan yang diperlukan untuk mengurangi intensitas sinar x untuk setengah dari nilai aslinya. Oleh karena itu

HVL merupakan karakteristik dari sinar-X. Ada tiga bagian utama untuk pengaturan HVL: tabung sinar-X, detektor radiasi, dan ketebalan dinilai filter biasanya aluminium.

Tujuannya untuk mengukur HVL yaitu memastikan bahwa total filtrasi berkas sinar-X dalam syarat minimum pada standar nasional dan internasional. Frekuensi evaluasi HVL minimumnya adalah pada saat *commissioning* setiap tahun. Instrumentasi yang digunakan adalah sistem dosimeter untuk mammografi, filter aluminium, dan *plate* logam untuk melindungi detektor dari sinar-X.

Pada pesawat mammografi digunakan sinar-X berenergi rendah dengan tegangan puncak berkisar pada 25 - 35 kVp atau kualitas berkasnya disetarakan dengan nilai HVL dalam milimeter Aluminium. Untuk keperluan proteksi radiasi maka perlu adanya informasi dosis dari setiap pesawat. Pengukuran dosis menggunakan fantom "*mammae*" yang telah terakreditasi merupakan pendekatan yang cukup dapat diterima. Hal ini mengingat sulitnya pengukuran dosis langsung pada organ payudara yang akan mengganggu citraan pada film radiografi. Penentuan kualitas berkas sinar-X (HVL) digunakan untuk menentukan nilai dosis yang diterima oleh pasien (Susanti, 2014).

Beberapa hal yang mempengaruhi nilai HVL adalah filtrasi baik bawaan (*inherent*) maupun tambahan (*added filter*), tegangan tabung pesawat sinar-X, target dan frekuensi generator. Oleh karena itu sebelum pengukuran HVL perlu dilakukan uji konsistensi dan akurasi kV sehingga dalam perhitungan dosis hasilnya akan lebih akurat (Kusumawati, 2006).

2.11 Batas Toleransi Nilai HVL

Hasil pengukuran kemudian dievaluasi menurut batasan nilai HVL yang dapat diterima, mengacu pada batasan nilai yang dikeluarkan oleh *Government of Western Australia* tahun 2006.

2.11.1 Minimum Nilai HVL

Nilai-nilai HVL di mmAl dituntut untuk lebih besar dari yang berikut ini:

$$HVL = 0.01xkVp + 0.03 \quad (2.1)$$

2.11.2 Maksimum Nilai HVL

Jika HVL untuk layar film mammografi berlebihan dan kontras gambar berkurang. Untuk peralatan sinar-X mammografi dengan kombinasi anoda-filter seperti Mo / Mo, Mo / Rh dan Rh / Rh, HVL harus berada dalam nilai konstan (c) dari HVL minimum yang dapat diterima. Maksimum nilai HVL diterima yaitu mm dari Al adalah:

$$HVL = 0.01 kVp + c \quad (2.2)$$

dimana:

$c = 0,12$ untuk Molybdenum (Mo/Mo); $0,19$ untuk Molybdenum dan Rhodium (Mo/Rh); $0,22$ untuk Rhodium (Rh/Rh).

Sehingga nilai batas toleransi yang dapat diterima adalah:

$$0,01(kVp) + 0.03 \leq HVL \leq 0,01(kVp) + c \quad (2.3)$$

Dimana:

$c = 0,12$ untuk Mo / Mo; $0,19$ untuk Mo / Rh; $0,22$ untuk Rh / Rh.

Adapun rumus untuk menghasilkan nilai HVL yaitu:

$$HVL = \frac{t_b \ln(2D_a/D_0) - t_a \ln(2D_b/D_0)}{\ln(D_a/D_b)} \quad (2.4)$$

Keterangan:

HVL= Ketebalan suatu lapisan yang bisa menghasilkan intensitas $D_0/2$ (mmAl)

D_0 = Dosis mula-mula (mGy)

t_b = Ketebalan suatu lapisan lebih kecil dari $D_0/2$ (mmAl)

t_a = Ketebalan suatu lapisan lebih besar dari $D_0/2$ (mmAl)

$D_a = D_0 \leq D_0/2$ (mGy)

$D_b = D_0 \geq D_0/2$ (mGy)

2.12 Multimeter X-ray RaySafe



Gambar 2.8 Multimeter X-Ray RaySafe

(Sumber: <http://www.raysafe.com/Products/Equipment/RaySafe%20X2>)

Kemudahan penggunaan berarti kemudahan untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan dalam satu eksposur, dengan satu sensor - secara otomatis. *RaySafe X2* menggunakan sensor pengukuran sinar-X untuk aplikasi Radiografi/Fluoroskopi, Mammografi, CT-scan, Survey. Pilih sensor yang dibutuhkan dan

menambahkan apa yang dibutuhkan pada tahap selanjutnya. Sensor *X-ray X2* dibuat tanpa perlu memilih rentang atau mode khusus. Sebagian besar sensor juga mengukur bentuk gelombang yang dapat dianalisis secara langsung pada unit dasar. Sensor yang terdapat pada RaySafe X2 X-ray secara khusus dirancang untuk memudahkan penggunaannya. (Anonim, 2017)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu : Juli – September 2017

Tempat : Di ruang Radiologi RSUD Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan.

3.2 Alat dan Bahan


Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pesawat Sinar-X Mammografi Tipe Analog Merek *Lilyum*.
- b. Multimeter *X-RaRaySafe*.
- c. *Waterpass*.
- d. Filter Aluminium dengan kemurnian 99,9% serta luas 4×4 cm dengan ketebalan 0,106 mm dan 0,055 mm.

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter Aluminium.
 1. Meletakkan *waterpass* diatas meja kompresi untuk mengetahui bahwa peletakkan detektor nantinya akan seimbang.
 2. Menyiapkan alat ukur multimeter *X-ray*.
 3. Memastikan bahwa setiap tabung *X-ray* yang digunakan dipanaskan.
 4. Meletakkan posisi detektor sesuai dengan gambar 3.1 berikut ini:

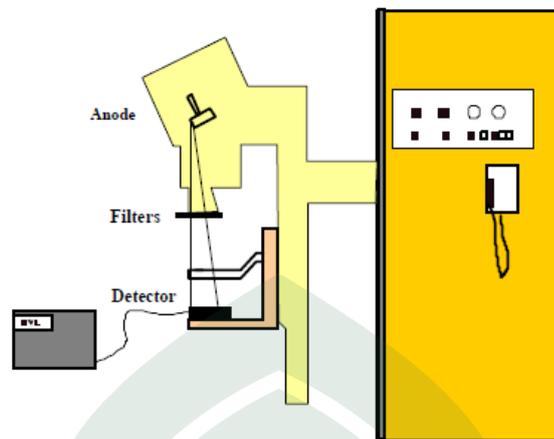

Gambar 3.1 Pengukuran HVL menggunakan *non-invasif beam analyzer* (Government of Western Australia.,1975)

5. Memilih secara manual arus tabung yaitu 50 mAs.
6. Memilih secara manual tegangan tabung (kVp) yaitu 23 kV.
7. Melakukan penyinaran tanpa menggunakan filter untuk mendapatkan dosis mula-mula.
8. Menentukan $D_{0/2}$ kemudian melakukan penyinaran sesuai faktor ekspose diatas yaitu tahap 5 dan 6.
9. Menambahkan filter di bawah kolimator sehingga menghasilkan dosis di bawah $D_{0/2}$ kemudian mencatat ketebalan filter yang digunakan.
10. Kemudian mengurangi filter sehingga menghasilkan dosis di atas $D_{0/2}$ kemudian mencatat ketebalan filter yang digunakan.
11. Melakukan penyinaran yang sama dengan kV yang berbeda yaitu 25, 27, 29 dan 31.
12. Melakukan perhitungan HVL dengan menggunakan persamaan 2.4
13. Melakukan perhitungan toleransi dengan persamaan 2.3

- b. Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran multimeter *X-ray*.
1. Menyiapkan alat ukur multimeter *X-ray*.
 2. Memilih secara manual arus tabung yaitu 50 mAs.
 3. Memilih secara manual tegangan kVp yaitu 23 kV.
 4. Mencatat nilai HVL yang terbaca pada multimeter *X-ray*.
 5. Melakukan penyinaran yang sama dengan kV yang berbeda yaitu 25, 27, 29 dan 31.
 6. Mencatat kembali nilai HVL yang terbaca pada multimeter *X-ray* pada kV yang berbeda.

3.4 Tabel Pengamatan

Tabel 3.1 Pengukuran dosis sebanyak 3x untuk mendapatkan dosis setengah dari dosis mula-mula:

No.	Pengaturan		D ₀ (mGy)			Rata-rata	$\frac{D_0}{2}$
	kVp	mAs	1	2	3		
1	23	50
2	25	
3	27	
4	29	
5	31	

Tabel. 3.2 Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter Aluminium:

No.	Setting		$\frac{D_0}{2}$	t_a	Da	t_b	Db	HVL	Toleransi
	kVp	mAs							
1	23	50	0,01(kVp)
2	25		+ 0.03
3	27		$\leq HVL$
4	29		$\leq 0,01(kV$
5	31		+ c

Tabel 3.3 Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran multimeter X-ray

No.	Setting		HVL(mmAl)			Rata-rata	Toleransi
	KVp	mAs	1	2	3		
1	23	50	$0,01(kVp) + 0.03 \leq HVL$ $\leq 0,01(kVp) + c$
2	25		
3	27		
4	29		
5	31		

Tabel 3.4 Perbandingan nilai HVL pada pengukuran dengan menggunakan filter aluminium dan nilai HVL dengan menggunakan multimeter X-ray.

No.	Tegangan Tabung (kV)	Nilai HVL dengan filter Al (mmAl)	Nilai HVL dengan multimeter X-ray (mmAl)
1	23
2	25
3	27
4	29
5	31

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data pada pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium menggunakan beberapa rumus antara lain sebagai berikut:

1. Mencari toleransi atau batasan nilai kualitas berkas

$$0,01(kVp) + 0,03 \leq HVL \leq 0,01(kVp) + c$$


$$c = 0,12 \text{ untuk Mo / Mo; } 0,19 \text{ untuk Mo / Rh; } 0,22 \text{ untuk Rh / Rh.}$$

2. Mencari nilai HVL atau kualitas berkas sinar-X

$$HVL = \frac{t_b \ln(2 D_a / D_0) - t_a \ln(2 D_b / D_0)}{\ln(D_a / D_b)}$$

Untuk teknik analisis pada pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran multimeter X-ray hanya menggunakan rumus toleransi dan untuk nilai HVLnya sendiri diambil pada keluaran yang ada pada multimeter X-ray.

3.6 Bagan Alir Penelitian

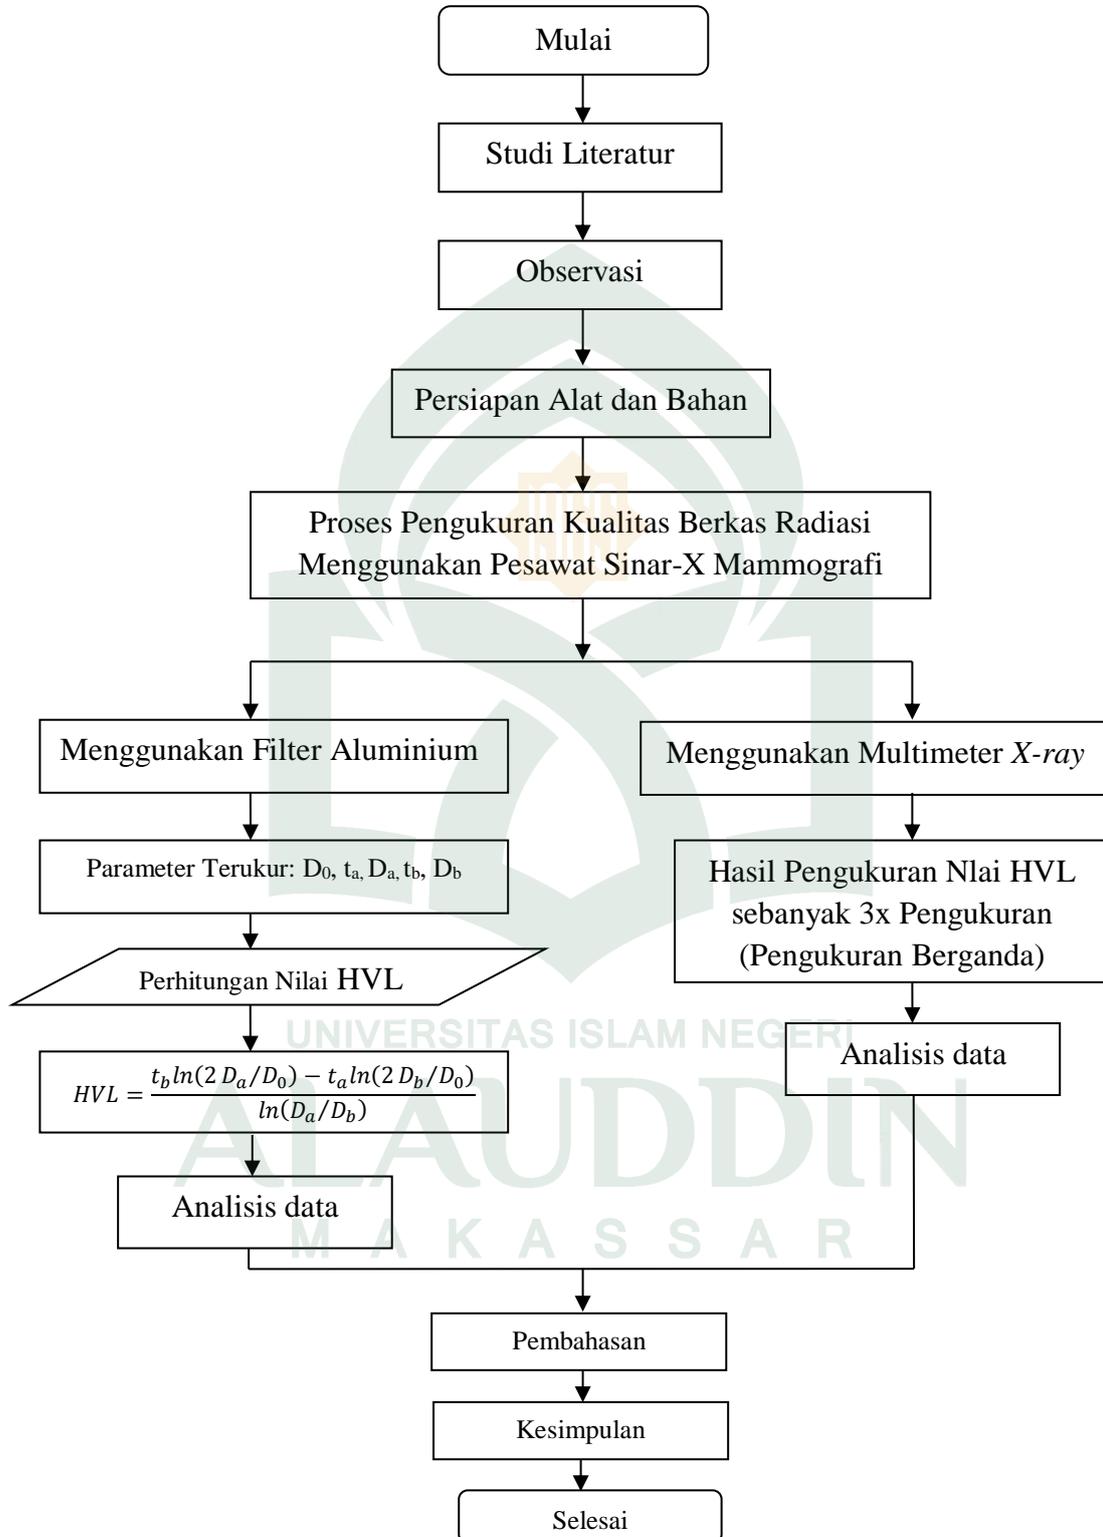


Gambar 3.2. Bagan Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengukuran Kualitas Berkas Radiasi dengan Menggunakan Filter Aluminium

Telah dilakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai HVL dengan menggunakan filter aluminium pada pesawat mammografi dengan merek Lylum. Yang sebelumnya dilakukan tahap pemanasan pada pesawat sinar-X mammografi sesuai dengan prosedur yang benar. Berbagai parameter yang dilakukan untuk mendapatkan nilai HVL. Selain itu, peneliti juga melakukan pengaturan posisi detektor dengan menggunakan *waterpass* yang ditunjukkan pada gambar 4.1(a), dan (b). Pengaturan posisi tersebut bertujuan untuk mengatur kelurusan atau ketegaklurusan unit mammografi, detektor, dan *paddle* kompresi.

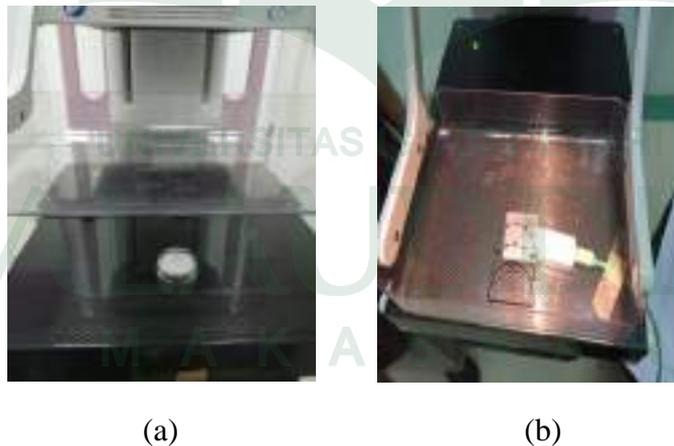

Gambar 4.1 (a). pengaturan posisi detektor dengan menggunakan *waterpass*), dan (b). Pengaturan posisi tersebut bertujuan untuk mengatur kelurusan atau ketegaklurusan unit mammografi, detektor, dan *paddle* kompresi.

Evaluasi HVL dilakukan dengan meletakkan detektor pada sandaran payudara dan dikompresi (Gambar 4.2). Kemudian detektor dipapar dengan pengaturan 50 mAs dan rentang 23-31 kV dan dengan filter aluminium dengan ketebalan yang berbeda-beda.



Gambar 4.2 Pengukuran HVL dengan menggunakan detektor

Mammografi adalah salah satu pesawat sinar-X yang terkhusus digunakan pada payudara manusia. Yang berfungsi sebagai pendeteksi kanker pada payudara. Untuk pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium yaitu dimana nilai HVL yang dihasilkan masih dalam batas toleransi. Dosis yang dihasilkan pada penyinaran mula-mula digunakanlah setengah dari dosis mula-mula tersebut.

Begitupula dengan pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray*, nilai HVL yang ditunjukkan pada alat multimeter *X-ray* juga memenuhi atau tidak melebihi nilai batas

toleransi yang telah ditentukan. Dimana nilai dari batas toleransi tersebut bergantung dari nilai kV dan filter tabung yang digunakan.

Tabel 4.1 Pengukuran dosis sebanyak 3x untuk mendapatkan dosis setengah dari dosis mula-mula dengan pengaturan 50 mAs.

No.	Pengaturan		D ₀ (mGy)			Rata-rata	$\frac{D_0}{2}$
	kVp	mAs	1	2	3		
1	23	50	3,550	3,548	3,546	3,548	1,774
2	25		4,698	4,699	4,697	4,698	2,349
3	27		5,963	5,964	5,965	5,964	2,982
4	29		7,361	7,363	7,365	7,363	3,6815
5	31		8,911	8,910	8,912	8,911	4,4555

Tabel 4.2 Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium.

No	Pengaturan		$\frac{D_0}{2}$	t _a (mm)	D _a (mGy)	t _b (mm)	D _b (mGy)	HVL (mmAl)	Toleransi
	kVp	mAs							
1	23	50	1,774	0,212	1,998	0,318	1,547	0,26	$0,26 \leq HVL \leq 0,35$
2	25		2,349	0,267	2,427	0,318	2,196	0,28	$0,28 \leq HVL \leq 0,37$
3	27		2,982	0,267	3,239	0,318	2,954	0,31	$0,30 \leq HVL \leq 0,39$
4	29		3,6815	0,318	3,849	0,373	3,463	0,34	$0,32 \leq HVL \leq 0,41$
5	31		4,4555	0,318	4,803	0,373	4,322	0,35	$0,34 \leq HVL \leq 0,43$

Catatan: Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium sesuai dengan nilai toleransi yang telah ditentukan oleh Bapeten yaitu $0,01(kVp) + 0,03 \leq HVL \leq 0,01(kVp) + c$ dimana nilai c yang digunakan yaitu 0,12 karena filter tabung yang digunakan yaitu Mo/Mo.

Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium nilai HVL-nya semuanya memenuhi toleransi yang ada. Antara lain; untuk 23 kV nilai HVL-nya yaitu 0.26 mmAl dengan toleransi $0,26 \leq HVL \leq 0,35$, kV 25 nilai HVL yaitu 0.28 mmAl dengan toleransi $0,28 \leq HVL \leq 0,37$, kV 27 nilai HVL yaitu 0.31 mmAl dengan toleransi $0,30 \leq HVL \leq 0,39$, kV 29 nilai HVL yaitu 0.34 mmAl dengan toleransi $0,32 \leq HVL \leq 0,41$ dan dengan kV 31 nilai HVL yang didapatkan yaitu 0.35 mmAl dengan toleransi $0,34 \leq HVL \leq 0,43$.

4.2 Pengukuran Kualitas Berkas Radiasi dengan Pengukuran Langsung dengan Menggunakan Multimeter X-ray

Pada pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* dengan detektor yang khusus digunakan pada pesawat mammografi yaitu multimeter *X-ray RaySafe*. Pengukuran ini dilakukan tanpa menggunakan filter aluminium. Dan nilai HVL terbaca pada alat multimeter *X-ray*.

Tabel 4.3 Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray*.

No.	Pengaturan		HVL (mmAl)			Rata-rata	Toleransi
	kVp	mAs	1	2	3		
1	23	50	0,273	0,275	0,271	0,27	$0,26 \leq HVL \leq 0,35$
2	25		0,300	0,302	0,304	0,30	$0,28 \leq HVL \leq 0,37$
3	27		0,326	0,327	0,328	0,33	$0,30 \leq HVL \leq 0,39$
4	29		0,347	0,352	0,351	0,35	$0,32 \leq HVL \leq 0,41$
5	31		0,366	0,365	0,361	0,36	$0,34 \leq HVL \leq 0,43$

Catatan: Pengukuran kualitas berkas radiasi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* sesuai dengan nilai toleransi yang telah ditentukan oleh Bapeten yaitu $kVp/100 + 0.03 \leq HVL \leq (kVp/100) + c$ dimana nilai c yang digunakan yaitu 0,12 karena filter tabung yang digunakan yaitu Mo/Mo.

Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* nilai HVL yang terbaca pada alat ukur juga semuanya memenuhi toleransi yang ada. Adapun nilai HVL yang terbaca antara lain; untuk 23 kV nilai HVL yaitu 0.27 mmAl dengan toleransi $0.26 \leq HVL \leq 0.35$, kV 25 nilai HVL yaitu 0.30 mmAl dengan toleransi yaitu $0.28 \leq HVL \leq 0.37$, kV, kV 28 nilai HVL yaitu 0.33 mmAl dengan toleransi $0.30 \leq HVL \leq 0.39$, kV 29 nilai HVL yaitu 0.35 mmAl dengan toleransi $0.32 \leq HVL \leq$

0,41 serta pada kV 31 nilai HVL yaitu 0.36 mmAl dengan toleransi $0.34 \leq \text{HVL} \leq 0.43$.

4.3 Perbandingan antara Kualitas Berkas Pesawat Sinar-X Mammografi dengan Menggunakan Filter Aluminium dan Kualitas Berkas Radiasi dengan Pengukuran Langsung Menggunakan Multimeter X-ray


Hasil perbandingan nilai HVL sebagai kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dari dua perkakuan yang berbeda yaitu ada yang menggunakan filter aluminium dan dengan menggunakan multimeter X-ray.

Tabel 4.4 Perbandingan nilai HVL pada pengukuran dengan menggunakan filter aluminium dan nilai HVL dengan menggunakan multimeter X-ray.

No.	Tegangan Tabung (kV)	Nilai HVL dengan filter Al (mmAl)	Nilai HVL dengan multimeter X-ray (mmAl)
1	23	0,26	0,27
2	25	0,28	0,30
3	27	0,31	0,33
4	29	0,34	0,35
5	31	0,35	0,36

Perbandingan antara kedua nilai HVL di atas diperoleh nilai yang tidak jauh berbeda, baik dengan menggunakan filter aluminium ataupun dengan menggunakan multimeter X-ray. Kedua nilai HVL di atas dapat digunakan untuk pengukuran nilai HVL sebagai nilai kualitas berkas radiasi itu sendiri. Nilai HVL dengan menggunakan filter aluminium mendekati nilai batas toleransi minimum yang telah ditentukan yaitu $0,26 \leq \text{HVL} \leq 0,35$ untuk tegangan tabung 23 kV, 0,28

$\leq \text{HVL} \leq 0,37$ untuk tegangan tabung 25 kV, $0,30 \leq \text{HVL} \leq 0,39$ untuk tegangan tabung 27 kV, $0,32 \leq \text{HVL} \leq 0,41$ untuk tegangan tabung 29 kV dan $0,34 \leq \text{HVL} \leq 0,43$ untuk tegangan tabung 31 kV. Sedangkan untuk nilai HVL dengan menggunakan multimeter X-ray cukup jauh melewati nilai batas toleransi minimum atau berada ditengah-tengah (seperti pada grafik 4.1). Tetapi untuk pengukuran kualitas berkas radiasi (HVL) yang baik digunakan yaitu dengan pengukuran multimeter X-ray karena nilai HVL yang didapatkan berada ditengah-tengah antara nilai batas toleransi minimum dan maksimum dan cara untuk mendapatkannya saja sangatlah mudah yaitu dengan membaca nilai HVL di alat ukur. Sedangkan untuk pengukuran dengan menggunakan filter aluminium untuk mendapatkan nilai HVL-nya sangatlah rumit karena harus menyesuaikan ketebalan filter terhadap dosis yang telah ditentukan. Dan jika terjadi kesalahan sedikit saja pada pengukuran dengan menggunakan filter aluminium bisa jadi nilai HVL yang akan kita dapatkan tidak sesuai dengan nilai batas toleransi yang telah ditentukan.

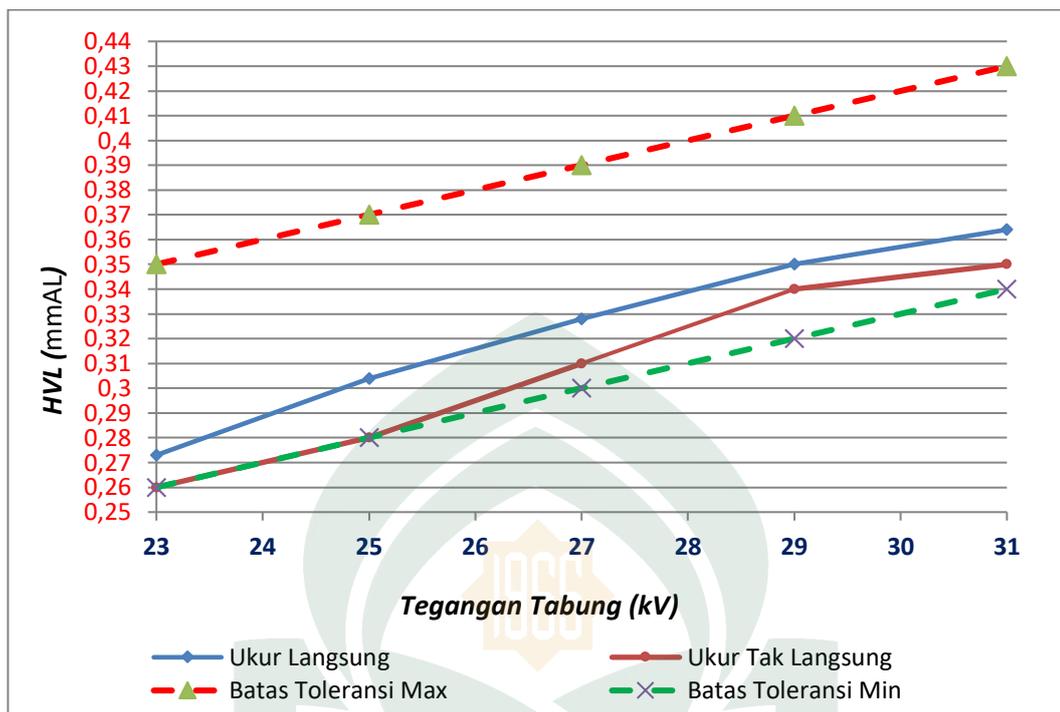

Grafik 4.1 Grafik hubungan antara nilai batas toleransi minimum dan maksimum serta nilai HVL dengan menggunakan filter aluminium dan dengan menggunakan multimeter *X-ray*

Pada grafik di atas menggambarkan bahwa pada pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium ataupun dengan pengukuran langsung menggunakan multimeter *X-ray* semuanya memenuhi nilai batas toleransi yang ada. Sesuai data pertama dimana pada tegangan tabung (kVp) 23 kV diperoleh nilai HVL 0,26 mmAl pada pengukuran menggunakan filter aluminium yang berada pada batas toleransi minimum sedangkan pada pengukuran langsung menggunakan multimeter *X-ray* didapatkanlah 0,27 mmAl yang melewati nilai batas minimum tetapi masih memenuhi nilai batas toleransi. Tetapi jika terjadi kesalahan sedikit saja nilai HVL yang dihasilkan akan keluar dari nilai batas toleransi pada tegangan tabung 23 kV.

Pada data kedua tidak jauh berbeda dengan data pertama dilihat dari segi pembacaan grafik di atas menggambarkan bahwa pada pengukuran kualitas berkas radiasi dengan menggunakan filter aluminium maupun dengan menggunakan pengukuran langsung yaitu dengan menggunakan multimeter *X-ray* semuanya juga memasuki atau memenuhi nilai batas toleransi yang ada. Dimana pada tegangan tabung (kVp) 25 kV didapatkan nilai HVL 0,28 mmAl pada pengukuran menggunakan filter aluminium yang berada pada garis batas toleransi minimum sedangkan pada pengukuran langsung menggunakan multimeter *X-ray* didapatkanlah 0,30 mmAl yang melewati nilai batas minimum tetapi masih memenuhi nilai batas toleransi. Tetapi jika terjadi kesalahan sedikit saja nilai HVL yang dihasilkan pada pengukuran dengan menggunakan filter aluminium akan keluar dari nilai batas toleransi pada tegangan tabung 25 kV.

Kemudian pada data ketiga agak sedikit berbeda dengan data pertama dan kedua. Dimana yang menjadi pembeda yaitu kedua nilai HVL yang dihasilkan tidak ada satupun yang menginjak atau berada pada garis batas toleransi. Dimana pada tegangan tabung (kVp) 27 kV didapatkan nilai HVL 0,31 mmAl pada pengukuran menggunakan filter aluminium yang melewati garis batas toleransi minimum sedangkan pada pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* diperoleh 0,33 mmAl yang melewati nilai batas minimum dan tidak melewati garis batas toleransi maksimum.

Selanjutnya, pada data ke empat yaitu dengan tegangan tabung 29 kV. Seperti yang tergambar pada grafik di atas baik pengukuran menggunakan filter aluminium maupun dengan pengukuran langsung dengan menggunakan

multimeter *X-ray* keduanya memenuhi batas nilai toleransi. Dimana yang menjadi batas toleransi minimumnya adalah 0,32 mmAl sedangkan pada pengukuran menggunakan filter Al yang dihasilkan yaitu 0,34 mmAl dan pada pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* yang terbaca yaitu 0,35 mmAl.

Kemudian pada terakhir dengan tegangan tabung 31 kV. Pada grafik menggambarkan bahwa kedua nilai HVL yang dihasilkan memenuhi nilai batas toleransi yang ada. Baik pada pengukuran kualitas berkas dengan menggunakan filter aluminium maupun dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray*. Nilai HVL 0.35 mmAl merupakan hasil dari pengukuran menggunakan filter aluminium sedangkan untuk nilai HVL yang terbaca pada multimeter *X-ray* adalah 0,36 mmAl.

Untuk pengukuran dengan menggunakan multimeter *X-ray* diperoleh nilai HVL dengan menggunakan multimeter *X-ray RaySafe* karena multimeter *X-ray RaySafe* ini dilengkapi untuk mengukur nilai HVL serta detektor yang digunakan khusus digunakan pada pesawat mammografi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kualitas berkas sinar-X merupakan daya tembus sinar-X. Daya tembus sinar-X ditunjukkan dengan nilai energi efektif berkas sinar-X itu sendiri. Berkas sinar-X yang memiliki energi tinggi memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan dengan berkas sinar-X berenergi lebih rendah. Kemampuan untuk menembus itulah atau daya tembus berkas sinar-X dikenal dengan kualitas berkas sinar-X. Pada penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa:

1. Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan menggunakan filter aluminium diperoleh masing-masing nilai HVL setiap tegangan tabung yaitu 23 kV, 0,28 mmAl; 25 kV, 0,28 mmAl; 27 kV, 0,31 mmAl; 29 kV, 0,34 mmAl; dan 31 kV, 0,35 mmAl. Hal ini telah sesuai dengan nilai batas toleransi kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X yang telah ditentukan.
2. Kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X mammografi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* diperoleh masing-masing nilai HVL setiap tegangan tabung yaitu 23 kV, 0,27 mmAl; 25 kV, 0,30 mmAl; 27 kV, 0,33 mmAl; 29 kV, 0,35 mmAl; dan 31 kV, 0,36 mmAl. Hal ini telah sesuai dengan nilai batas toleransi kualitas berkas radiasi pesawat sinar-X yang telah ditentukan.
3. Nilai kualitas berkas radiasi (HVL) yang baik digunakan yaitu dengan pengukuran multimeter *X-ray* karena nilai HVL yang didapatkan berada

ditengah-tengah antara nilai batas toleransi minimum dan maksimum dan cara untuk mendapatkannya saja sangatlah mudah yaitu dengan membaca nilai HVL di alat ukur. Sedangkan untuk pengukuran dengan menggunakan filter aluminium untuk mendapatkan nilai HVL-nya sangatlah rumit karena harus menyesuaikan ketebalan filter terhadap dosis yang telah ditentukan. Dan jika terjadi kesalahan sedikit saja pada pengukuran dengan menggunakan filter aluminium bisa jadi nilai HVL yang akan kita dapatkan tidak sesuai dengan nilai batas toleransi yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diambil adalah sebaiknya pihak Bapeten menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian kualitas berkas khususnya pada pesawat mammografi yaitu dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter *X-ray* tidak lagi menggunakan pengukuran dengan menggunakan filter aluminium atau dengan rumus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A.B. Sugiratu M.A. Tasa. *Analisis Dosis Radiasi untuk Aplikasi Ruang Icu*.
Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

Akhadi, Mukhlis. 2000."*Dasar-dasar Proteksi Radiasi*". Jakarta. Rineka Cipta

Anonim. IT Garbet, Mamografi-Physical Principles and Instrumentation
(<http://golum.riv.csu.edu.au/>, diakses 21 September 2017)

Anonim. Bagian-bagian Mammografi. <https://kumpulsore.blogspot.co.id/2014/02/teknik-pemeriksaan-mammografi.html>. Tanggal akses 13 Februari 2017.

Anonim. Multimeter X-ray RaySafe. <http://www.flukebiomedical.com/biomedical/usen/diagnostic-imaging-qa/x-ray-qa-instruments/raysafe-x2-x-ray-measurement-system.htm?pid=79064>. Tanggal akses 8 September 2017.

Anonim. Pesawat Mammografi. <http://ilmuradiologi.blogspot.co.id/2011/08/pesawat-sinar-x.html>. Tanggal akses 5 Februari 2017.

Anonim. Multimeter X-ray RaySafe. <http://www.flukebiomedical.com/biomedical/usen/diagnostic-imaging-qa/x-ray-qa-instruments/raysafe-x2-x-ray-measurement-system.htm?pid=79064>. Tanggal akses 19 September 2017.

Arif Jauhari, 2008, "*Berkas Sinar-X dan Pembentukan gambar pada Pesawat sinar-X*", Puskaradim, Jakarta.

Batan. 2013. *Dasar Proteksi Radiasi Medik, Pusdiklat*. Batan: Jakarta 2013

Bambang, Sw. 1986."Fisika Atom". Karunika: Jakarta

- DEPKES RI, 1999, *Pedoman Peningkatan Quality Assurance. Fasilitas Pelayanan Radiologi*, Jakarta.
- Government of Western Australia. 2006. “*Diagnostic X-Ray Equipment Compliance Testing*”. Australia: Radiological Council of Western Australia.
- Hiswara, Eri dkk. 2010. “*Dosis Pasien Pada Pemeriksaan Sinar-X Medik Radiografi*”. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi-BATAN. 21-34.
- Juliana Ichram, dkk. 2016. “*Uji Kaesesuaian Kualitas Citra dan Infoermasi Dosis Pasien pada Pesawat Mammografi*”. Universitas Hasanuddin.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya edisi 2007*”, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Jakarta: Indonesia, 2007.
- Kristiyanti, dkk. 2013. “*Kajian Keselamatan Radiasi Dalam Perancangan Pesawat Sinar-X Mammografi*”. PRPN- BATAN. 180-190.
- Kusumawati, Dyah Dwi. 2008. “*Pengukuran Kualitas Berkas Radiasi Pesawat Sinar-X Mamografi untuk Jaminan Kualitas*”. PTKMR-BATAN. 42- 49.
- R Aryawijayanti. *Analisis Dampak Radiasi Sinar-x Pada Mencit Melalui Pemetaan Dosis Radiasi di Laboratorium Fisika Medik*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Rasad Esjahriar. *Buku Radiologi Diagnostik*. Jakarta; 2005: (15-7)- (25-9).
- Rudi, Pratiwi, Susilo. *Pengukuran Paparan Radiasi Perawat Sinar-X Di Instalasi Radiodiagnostik Untuk Proteksi Radiasi*. *J. Unnes Physis*; 2012: 19-24.
- Shihab, M, Quraish. 2009. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lantera Hati

Susanti, dkk. 2014. “*Penentuan Entrance Skin Exposure (ESE) Pada Pesawat Mammografi Mammomat 1000 Dengan Filter Molybdenum (Mo) Dan Rhodium (Rh)*”. Semarang. Vol. 22 (1) 20-24

Suyatno Ferry. *Aplikasi Radiasi Sinar-X Di Bidang Kedokteran Untuk Menunjang Kesehatan Masyarakat. Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir*;2008:503-509.

Sepryana, dkk. 2016. “*Optimalisasi Pengukuran Multimeter Sinar-X Dengan Range Tegangan Tabung Dalam Proses Kalibrasi Pesawat Sinar-X*”. Universitas Hasanuddin.

Wiriyosimin, S. 1995. *Mengenal Asas Proteksi Radiasi*. Bandung: ITB



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Watampone Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Oktober 1994, sebagai anak ke lima dari enam bersaudara yaitu dari pasangan Bapak Annas Sanusi dan Ibu Hj. Kartini M. Penulis mengawali pendidikannya dari SD inpres 5/81 Tibojong dan menyelesaikannya pada tahun 2006. Kemudian melanjutkannya pada tahun yang sama di SMP Negeri 7 Watampone dan mendapatkan ijazah pada tahun 2009. Kemudian, kembali melanjutkan pendidikannya ke bangku sekolah menengah atas di tahun yang sama yaitu pada tahun 2009. Dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2012 di SMA Negeri 5 Watampone.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan dan tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran I. Hasil Data Pengukuran



Untuk Pengukuran dengan menggunakan multimeter X-ray. Mula-mula dengan mengukur dosis mula-mula (D_0).

No.	Pengaturan		D_0 (mGy)		
	kVp	mAs	1	2	3
1	23	50	3.550	3.548	3.546
2	25		4.698	4.699	4.697
3	27		5.963	5.964	5.965
4	29		7.361	7.363	7.365
5	31		8.911	8.910	8.912

No.	Pengaturan		$\frac{D_0}{2}$	t_a (mm)	D_a (mGy)	t_b (mm)	D_b (mGy)
	kVp	mAs					
1	23	50	1.774	0.212	1.998	0.318	1.547
2	25		2.349	0.267	2.427	0.318	2.196
3	27		2.982	0.267	3.239	0.318	2.954
4	29		3.6815	0.318	3.849	0.373	3.463
5	31		4.4555	0.318	4.803	0.373	4.322

Pengukuran kualitas Berkas radiasi dengan pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter x-ray sebanyak 3x.

No.	Pengaturan		HVL (mmAl)		
	kVp	mAs	1	2	3
1	23	50	0.273	0.275	0.271
2	25		0.300	0.302	0.304
3	27		0.326	0.327	0.328
4	29		0.347	0.352	0.351
5	31		0.366	0.365	0.361

*



Lampiran II. Nilai Batas Toleransi dan
Nilai HVL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Nilai Batas Toleransi

No.	Tegangan Tabung (kVp)	Nilai Toleransi
1	23	$0.26 \leq HVL \leq 0,35$
2	25	$0.28 \leq HVL \leq 0,37$
3	27	$0.30 \leq HVL \leq 0,39$
4	29	$0.32 \leq HVL \leq 0,41$
5	31	$0.34 \leq HVL \leq 0,43$

Dimana untuk menghitung nilai batas toleransi menggunakan rumus yaitu:

$$kVp/100 + 0.03 \leq HVL \leq (kVp/100) + c$$

Dimana nilai c yang digunakan adalah Mo/Mo dengan nilai 0.12

Jadi: $\frac{23}{100} + 0.03 = 0,26$ (untuk Nilai HVL minimum)

$(\frac{23}{100}) + 0,12 = 0,35$ (untuk nilai HVL maksimum)

Jadi batas nilai toleransi yang dapat diterima untuk tegangan tabung 23 kV adalah:

$$0.26 \leq HVL \leq 0,35$$

2. Nilai HVL

No	Pengaturan		$\frac{D_0}{2}$	t_a (mm)	D_a (mGy)	t_b (mm)	D_b (mGy)	HVL (mmAl)	Toleransi
	kVp	mAs							
1	23	50	1,774	0,212	1,998	0,318	1,547	0,26	$0,26 \leq HVL \leq 0,35$
2	25		2,349	0,267	2,427	0,318	2,196	0,28	$0,28 \leq HVL \leq 0,37$

3	27		2,982	0,267	3,239	0,318	2,954	0,31	$0,30 \leq \text{HVL} \leq 0,39$
4	29		3,6815	0,318	3,849	0,373	3,463	0,34	$0,32 \leq \text{HVL} \leq 0,41$
5	31		4,4555	0,318	4,803	0,373	4,322	0,35	$0,34 \leq \text{HVL} \leq 0,43$

Dimana untuk menghitung nilai HVL dengan menggunakan rumus untuk tegangan tabung 23 kV yaitu:

$$\text{HVL} = \frac{t_b \ln(2 D_a / D_0) - t_a \ln(2 D_b / D_0)}{\ln(D_a / D_b)}$$

$$\text{HVL} = \frac{0,318 \ln(2(1,998/3,548)) - 0,212 \ln(2(1,547/3,548))}{\ln(1,998/1,547)}$$

$$\text{HVL} = \frac{0,318 \ln(1,12626832) - 0,212 \ln(0,872040586)}{\ln(1,291532)}$$

$$\text{HVL} = \frac{0,318 (0,118909796) - 0,212 (-0,136919313)}{(0,255829111)}$$

$$\text{HVL} = \frac{0,0378133151 + 0,0290268944}{0,255829111}$$

$$\text{HVL} = 0,261268975 \text{ atau dibulatkan } 0,26$$


UNIVERSITAS
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran III. Dokumentasi Penelitian





Menyiapkan multimeter X-ray RaySafe

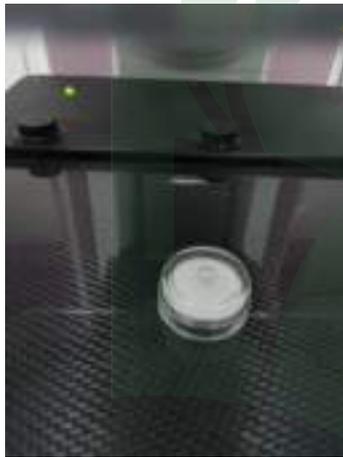

Meletakkan waterpass diatas papan kompresi untuk mengetahui letak keseimbangan detektor nantinya



Meletakkan detektor diatas papan kompresi



Menyiapkan pesawat mammografi dengan memanaskan tabung dengan menekan tombol tombol on pada pesawat dan mendiarkannya selama 10 menit



Memperbaiki posisi detektor agar berada ditengah-tengah dan tidak mudah untuk bergeser



Memasukkan nilai kV dan mAs pada panel kontrol yang ada di pesawat mammografi kemudian melakukan penyinaran.



Didapatkan dosis mula-mula tanpa filter dan kemudian menentukan nilai dosis setengah dari dosis mula-mula



Memasang filter Al di atas detektor sehingga didapatkanlah nilai t_a , D_a , t_b , dan D_b



Mengganti ketebalan filter untuk mendapatkan nilai tb, dan Db sesuai dengan dosis yang telah ditentukan



Mengganti tegangan tabung dan arus tabung pada panel kontrol



Mencatat hasil yang terbaca pada Multimeter X-ray



Terima Kasih atas bantuan dari pegawai BPFK